


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	三井精機	年式	1996	管理番号	P008769
型式	HU63	測定者	武藤	アシスタント	

Z軸方向の平行度

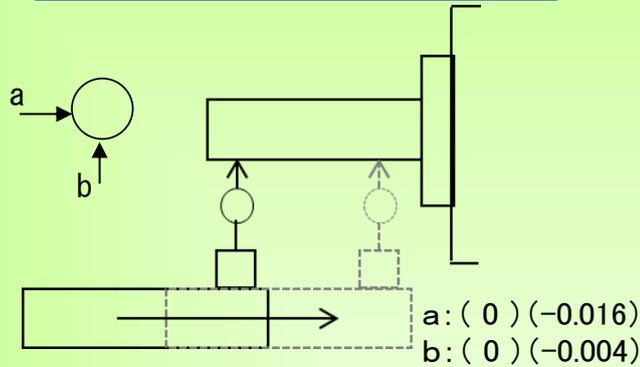

主軸振れ


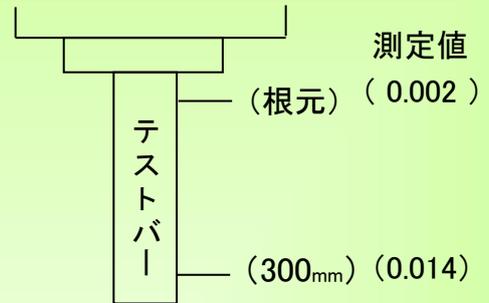


直角度

【XY】測定値 (0.008)


【ZY】測定値 (0.050)

【ZX】測定値 (0.006)

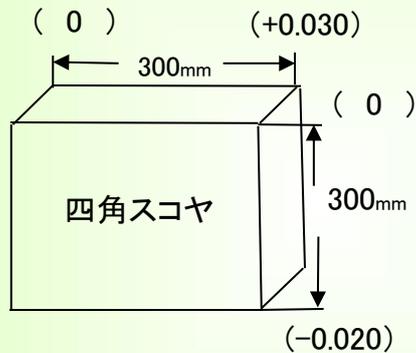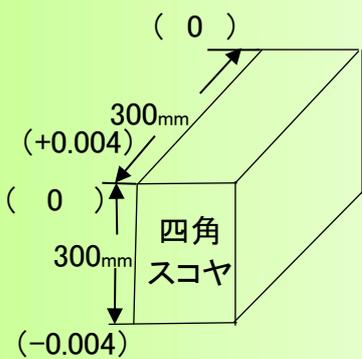

上面精度

テーブルサイズ: 630角
()パレット1
[—]パレット2

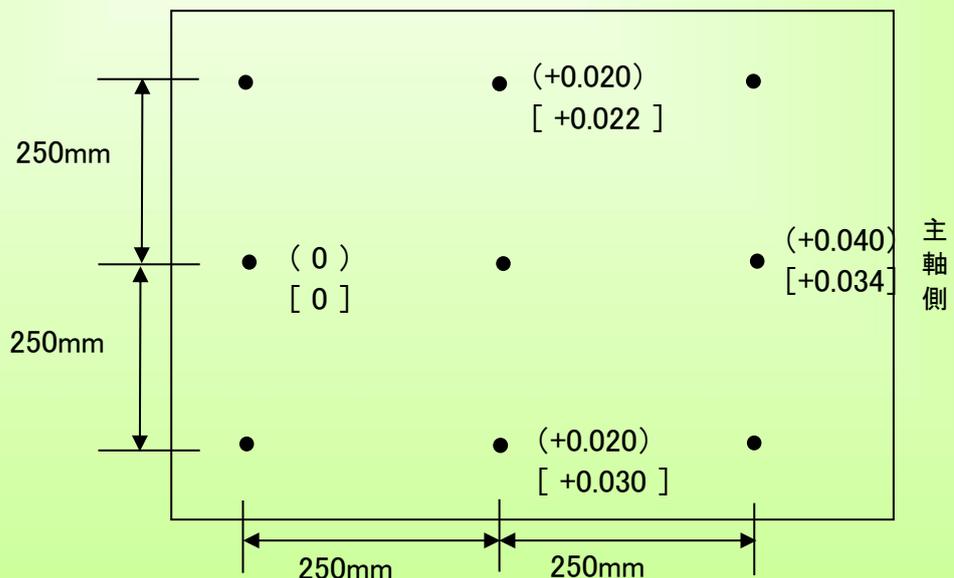

2025/5/29