


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	牧野フライス製作所	年式	2010	管理番号	P008836
型式	a51	測定者	近藤	アシスタント	

Z軸方向の平行度

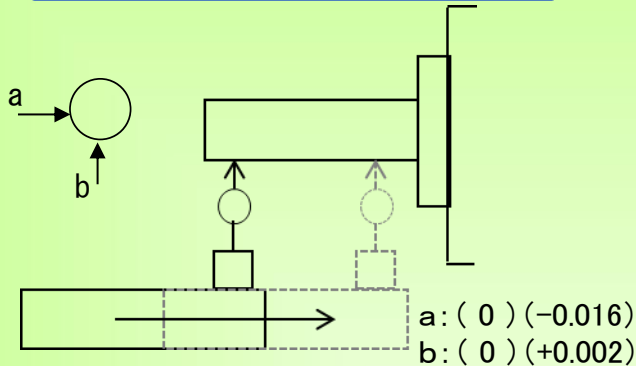

主軸振れ


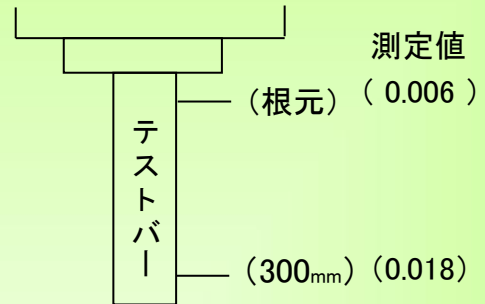


直角度

【XY】測定値 (0.002)


【ZY】測定値 (0.006)

【ZX】測定値 (0.002)

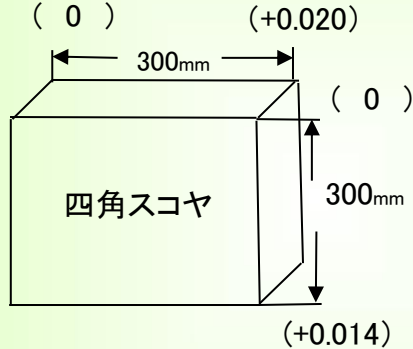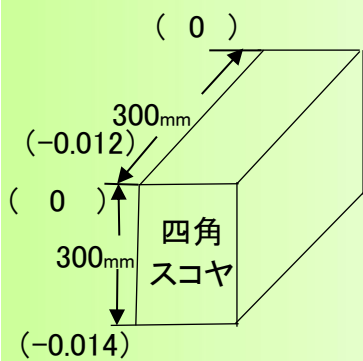

上面精度

テーブルサイズ: 400角
()パレット1
[—]パレット2

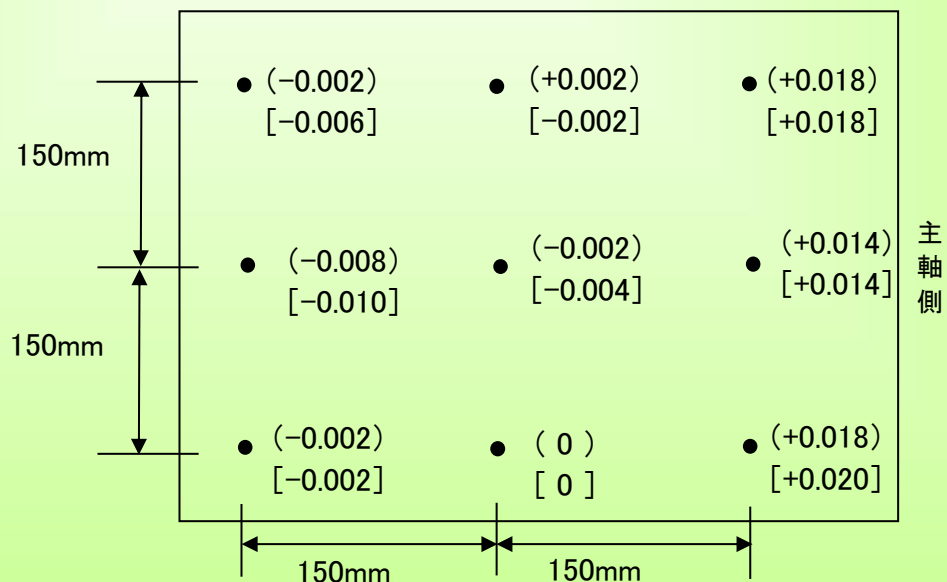

2025/5/29