



精度測定検査表

Examination for precision list

メーカー	ファナック	年式	2001年製	管理番号	P006726
型式	α -T14iBL	測定者	平野	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

主軸振れ


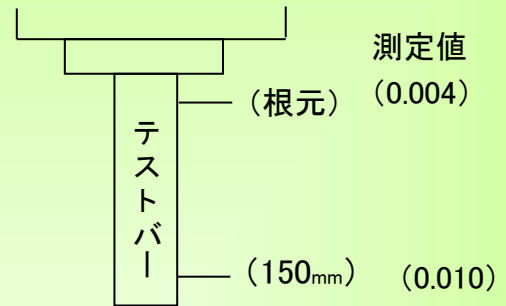
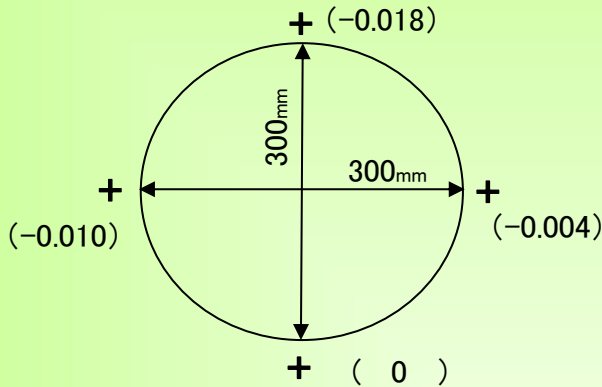


直角度

【Y Z】測定値 (0.014)

【X Z】測定値 (0.012)

【X Y】測定値 (0.010)

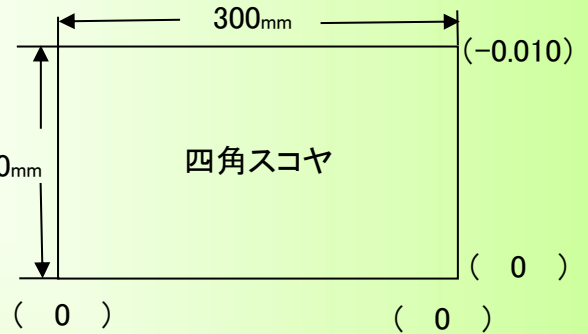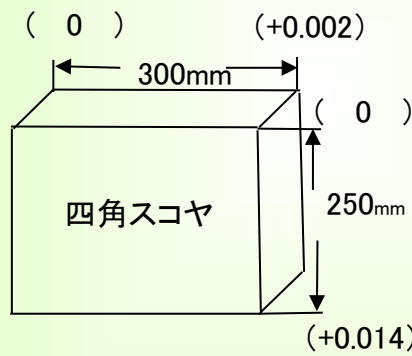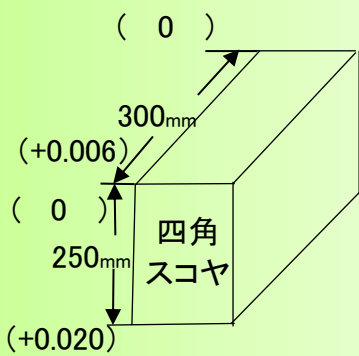

上面精度

※テーブルサイズ 850 × 410

