


# 精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	オークマ	年式	2020	管理番号	P008887
型式	MILLAC-611V II	測定者	金子	アシスタント	

## 振り回し(300ピッチ)

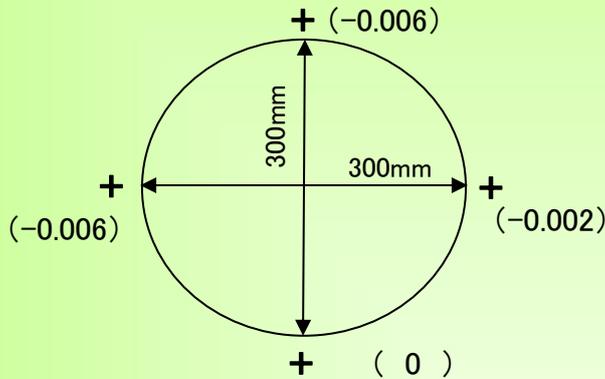

## 主軸振れ



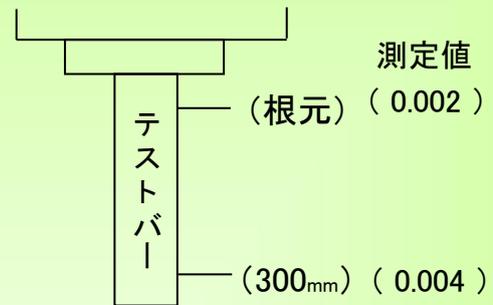


## 直角度

【YZ】測定値 (0.010)


【XZ】測定値 (0.006)

【XY】測定値 (0.002)

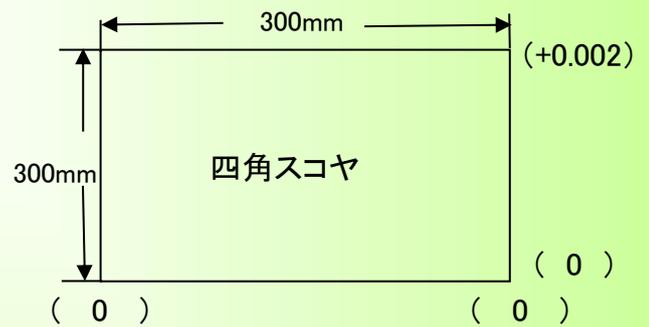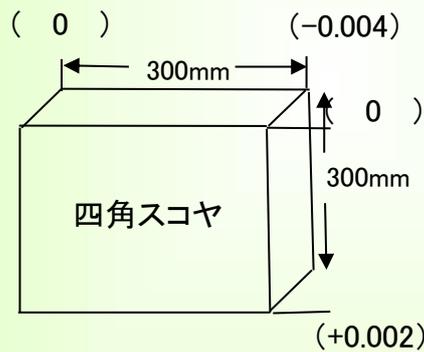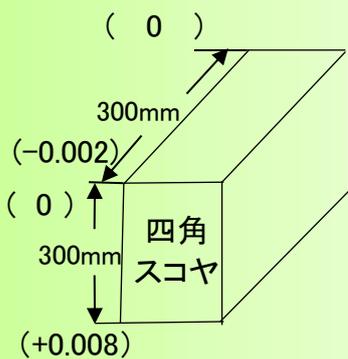

## 上面精度

※テーブルサイズ 1600 × 610

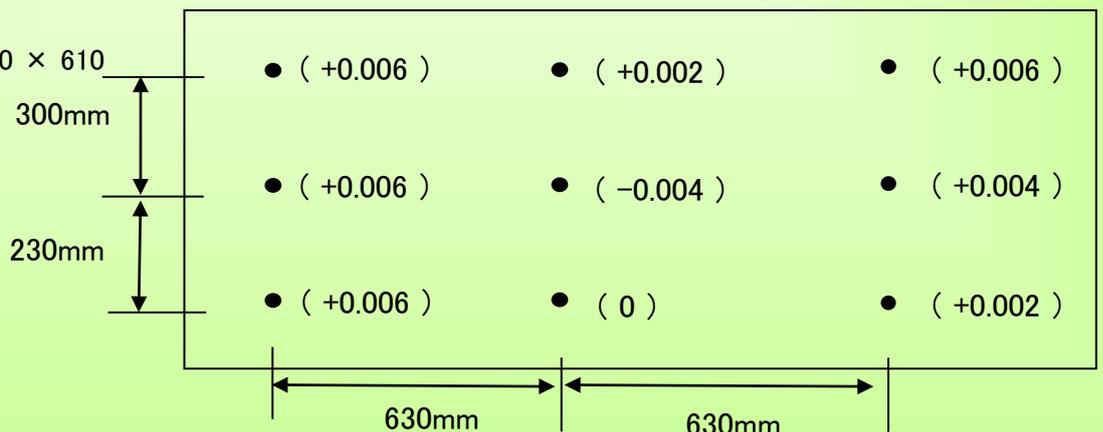

2025/6/24