


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	ファナック	年式	2012	管理番号	P008875
型式	α -D14MiA5	測定者	金子	アシスタント	長谷川

振り回し(200ピッチ)

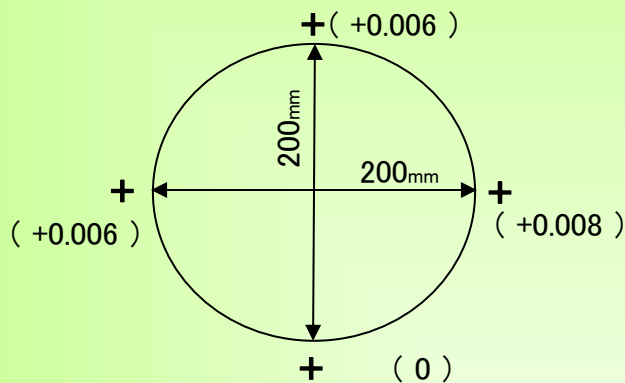

主軸振れ



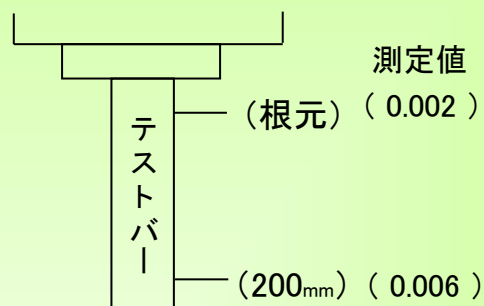


直角度

【YZ】測定値 (0.002)


【XZ】測定値 (0.004)

【X Y】測定値 (0.004)

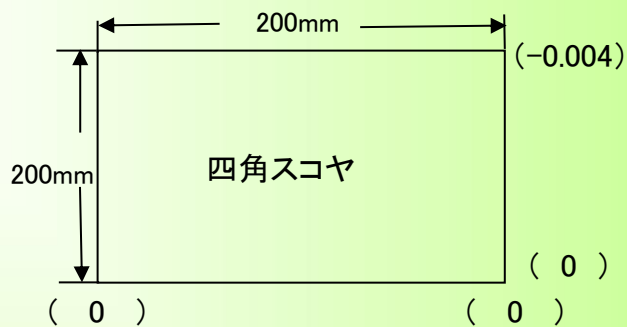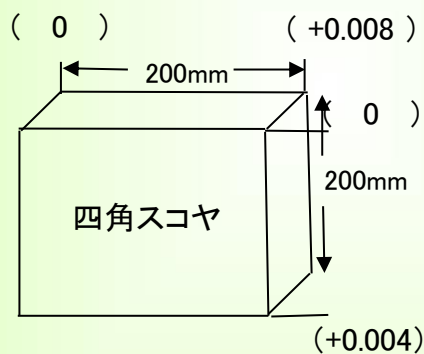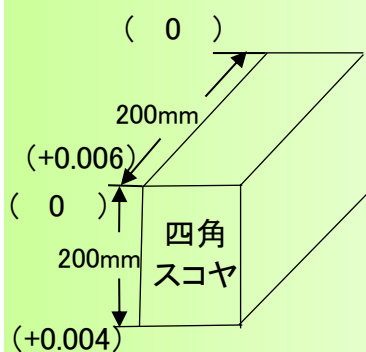

上面精度

※テーブルサイズ 650 × 400

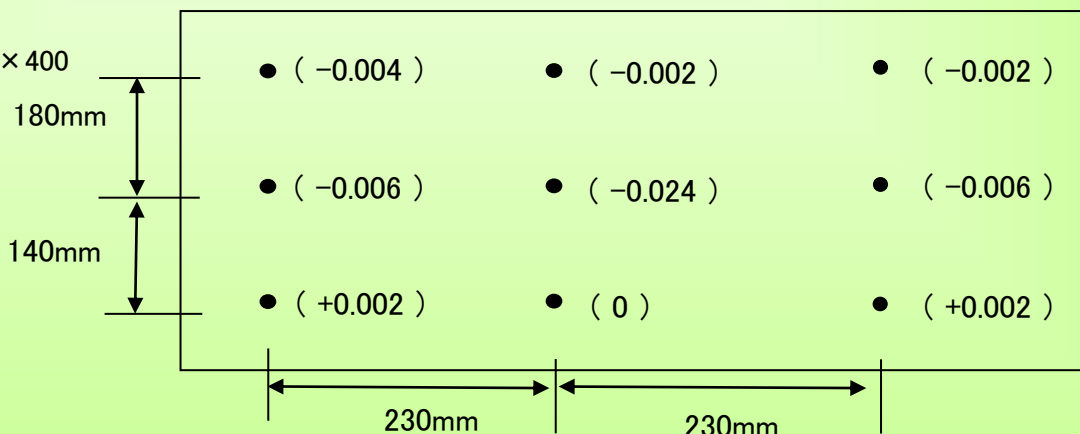

2025/5/17