


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	OKK	年式	2005	管理番号	P008743
型式	MCV-660	測定者	武藤	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

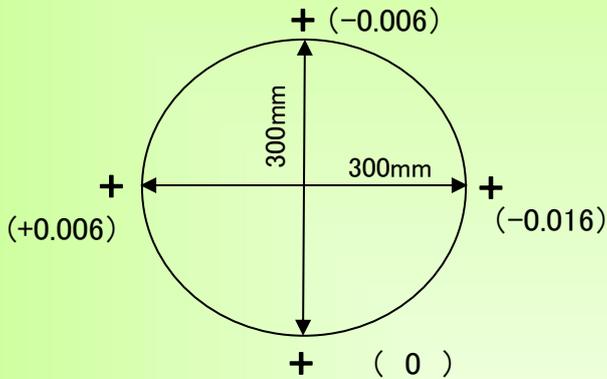

主軸振れ



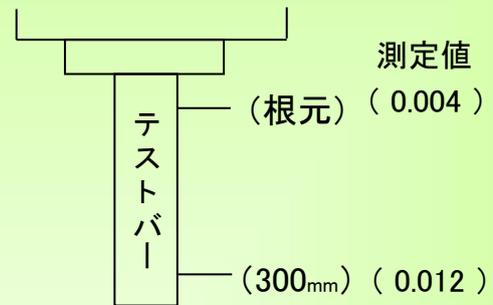


直角度

【YZ】測定値 (0.004)


【XZ】測定値 (0.010)

【XY】測定値 (0.006)

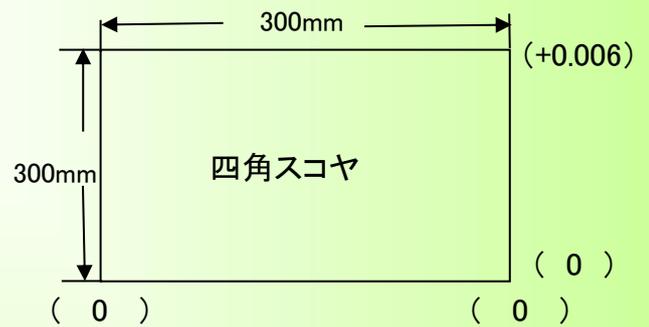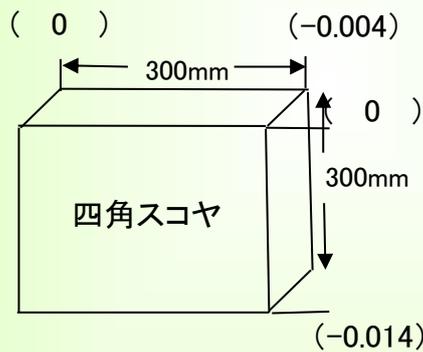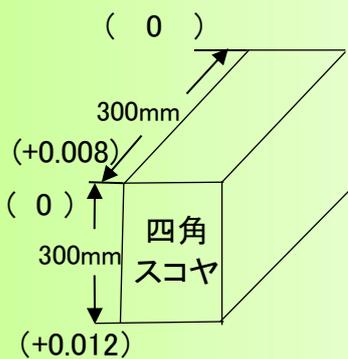

上面精度

※テーブルサイズ 750 × 450

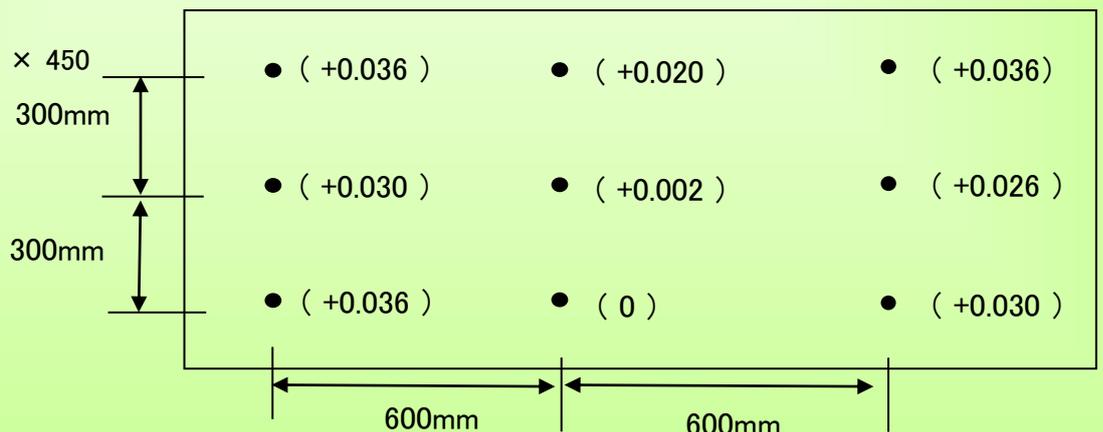

2025/6/27