


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	大隈豊和	年式	2000.11	管理番号	H018975
型式	FMR-40	測定者	蔵内	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

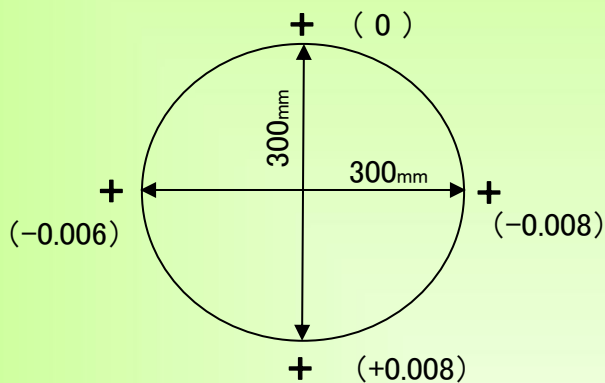

主軸振れ



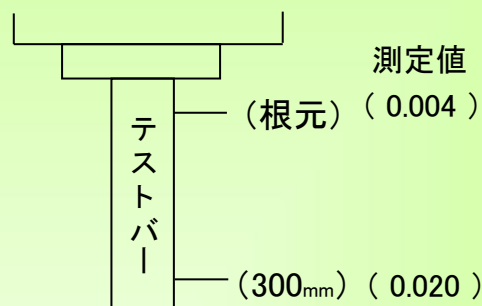


直角度

【YZ】測定値 (0.012)


【XZ】測定値 (0.010)

【X Y】測定値 (0.012)

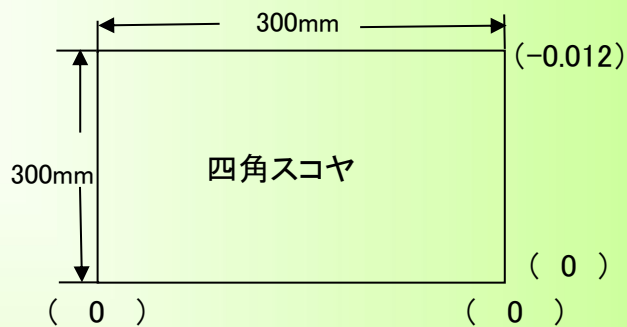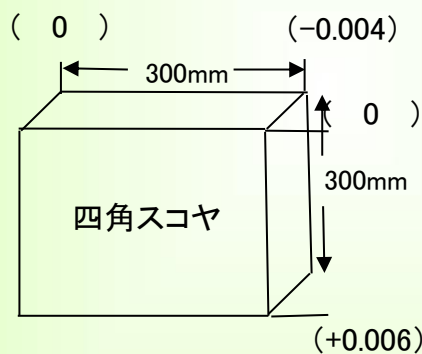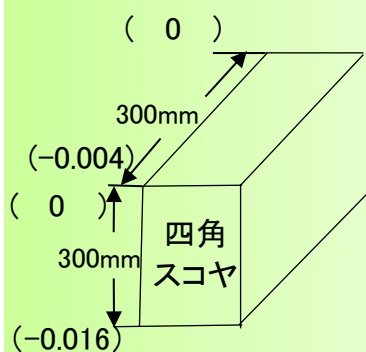

上面精度

※テーブルサイズ 800×410

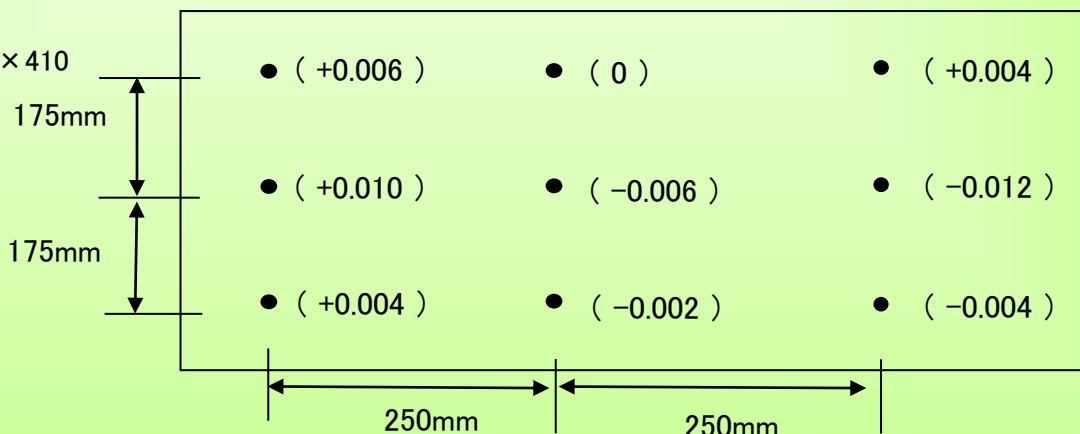

2025/3/19