


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	森精機	年式	2007	管理番号	P008927
型式	NH6300DCG	測定者	金子	アシスタント	

Z軸方向の平行度

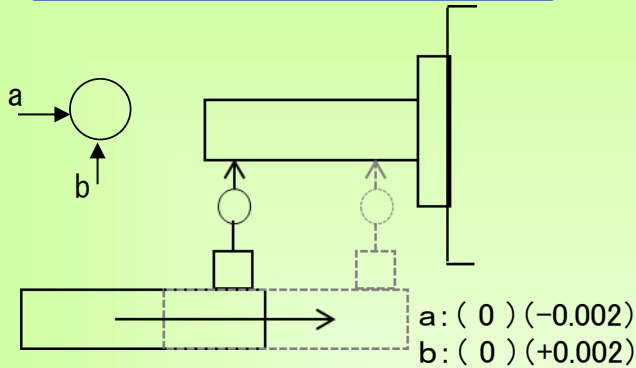

主軸振れ


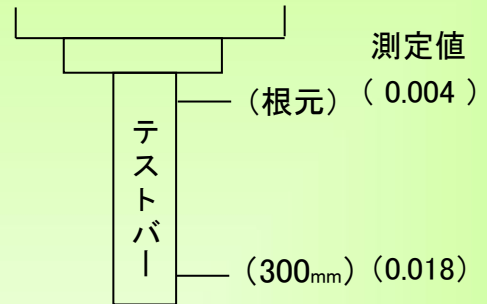


直角度

【XY】測定値 (0.008)


【ZY】測定値 (0.004)

【ZX】測定値 (0.002)

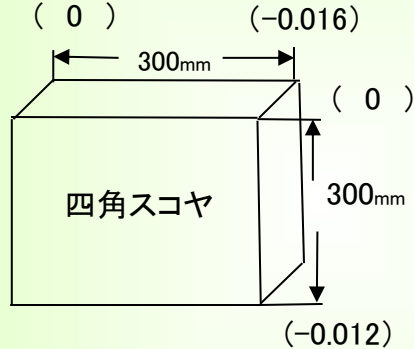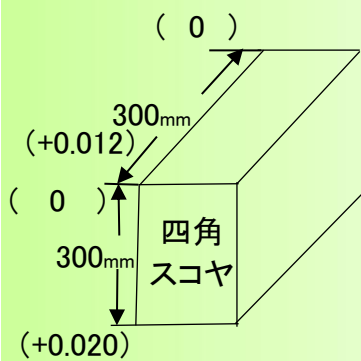

上面精度

テーブルサイズ: 630角
()パレット1
[—]パレット2

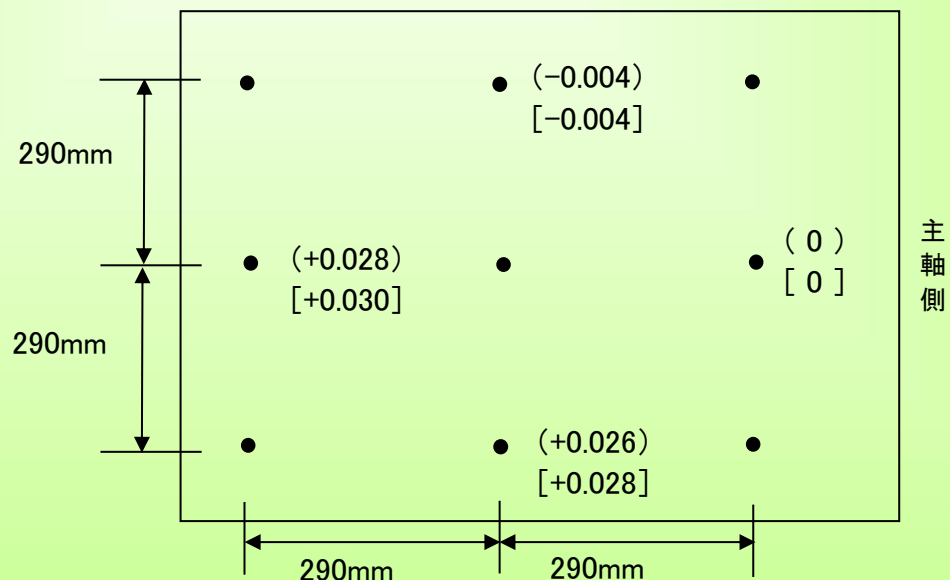

2025/6/30