


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	OKK	年式	2008	管理番号	H019307
型式	RRM-2V	測定者	仙田	アシスタント	長島

振り回し(150ピッチ)

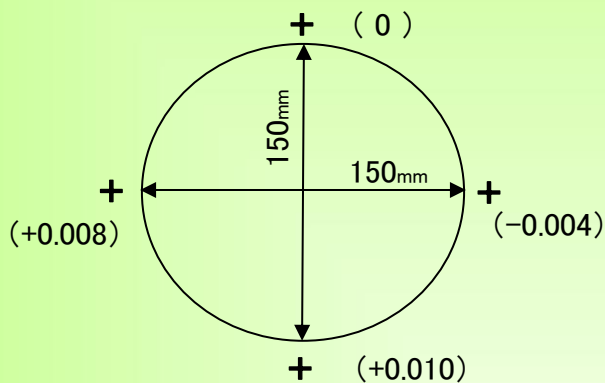

主軸振れ



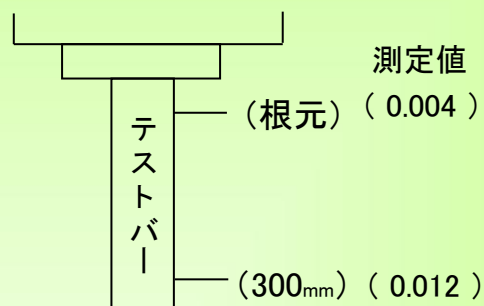


直角度

【YZ】測定値 (0.008)


【XZ】測定値 (0.010)

【X Y】測定値 (0.004)

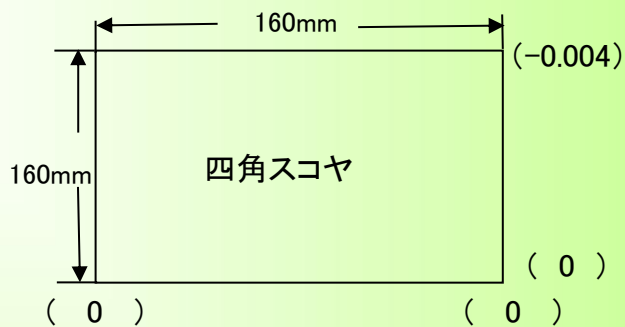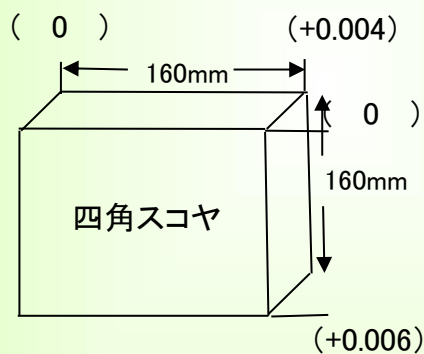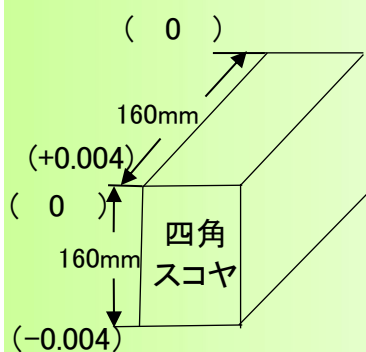

上面精度

※テーブルサイズ 1310×300

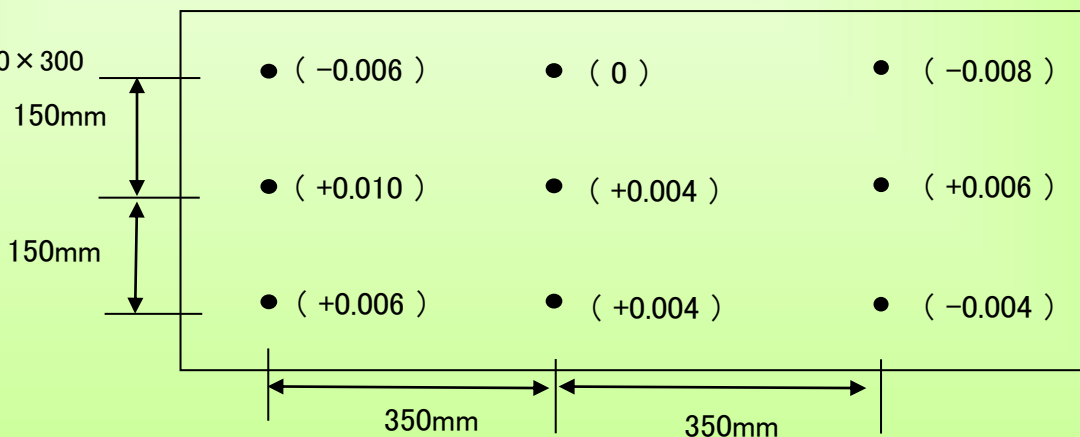

2025/7/1