


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	森精機	年式	2004	管理番号	P008946
型式	NH4000	測定者	野辺沼	アシスタント	

Z軸方向の平行度

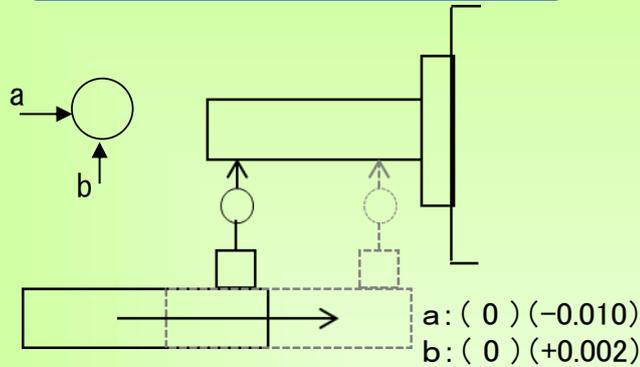

主軸振れ


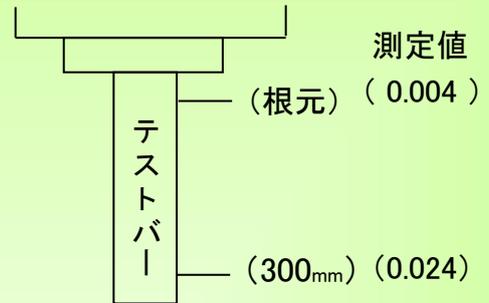


直角度

【XY】測定値 (0.006)


【ZY】測定値 (0.004)

【ZX】測定値 (0.004)

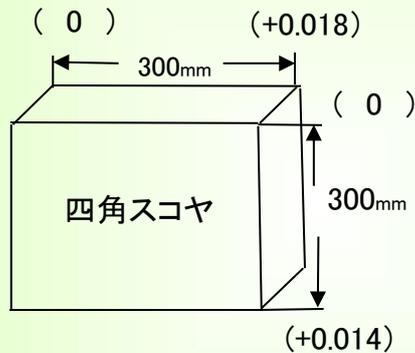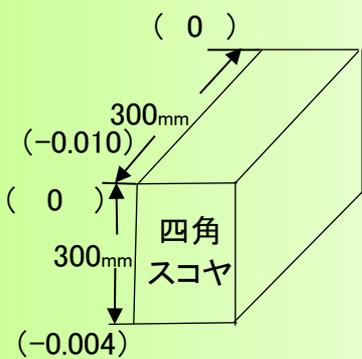

上面精度

テーブルサイズ: 400角
 ()パレット1
 [—]パレット2

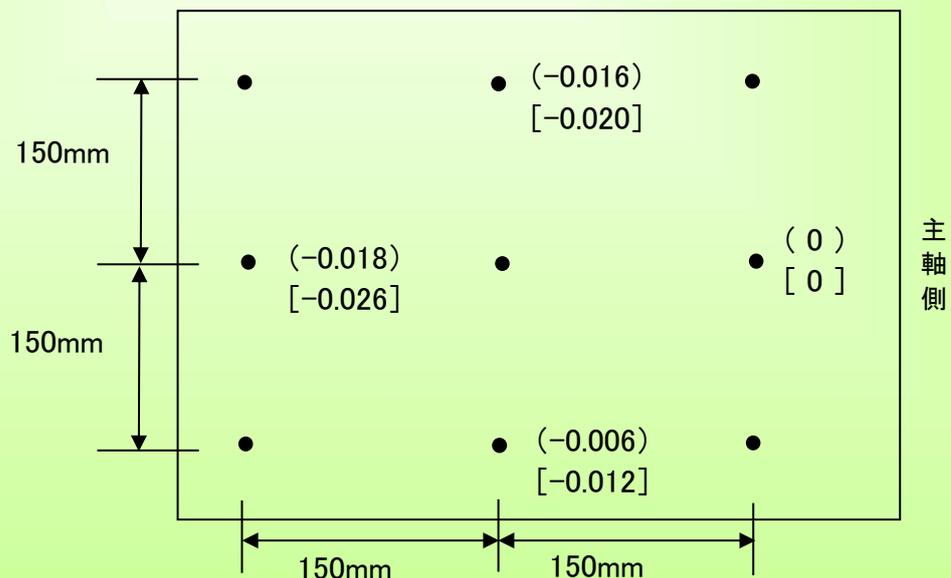

2025/6/17