


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	森精機	年式	2008	管理番号	P008594
型式	NH4000DCG	測定者	金子	アシスタント	

Z軸方向の平行度

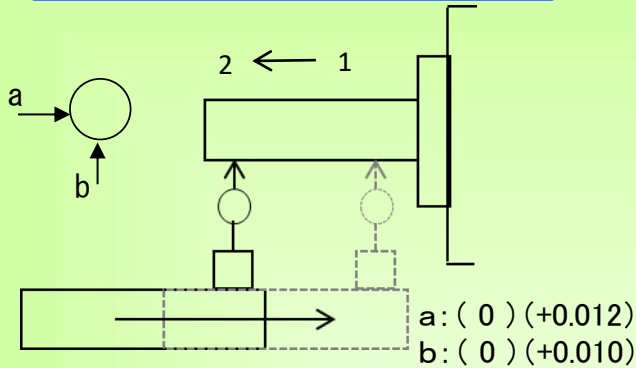

主軸振れ


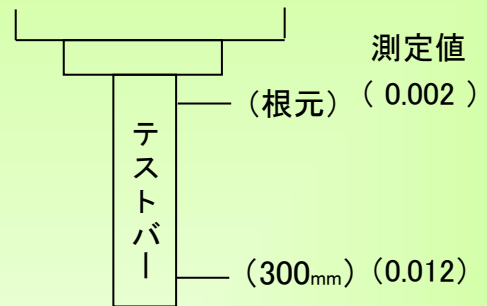


直角度

【XY】測定値 (0.010)

【ZY】測定値 (0.006)

【ZX】測定値 (0.004)

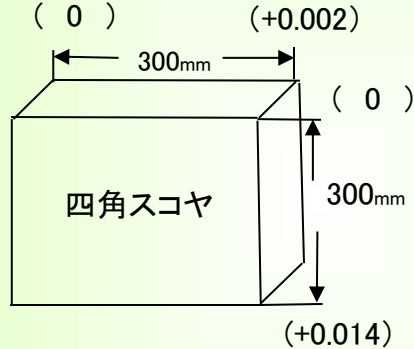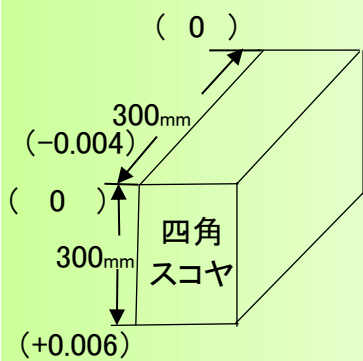


上面精度

テーブルサイズ: 400角

()パレット1

[—]パレット2

[]パレット3

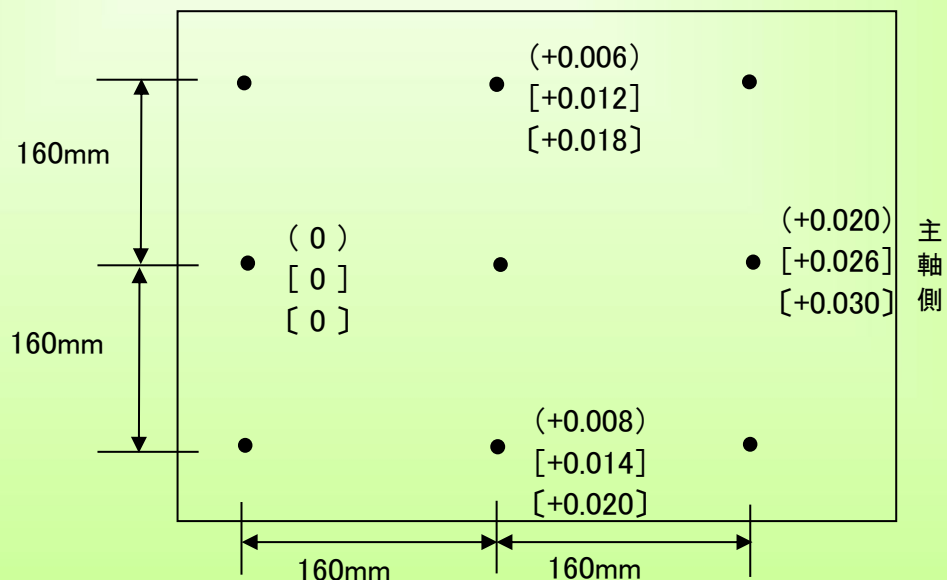

2025/6/30