


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	ブラザー	年式	2019	管理番号	P008925
型式	S500X1	測定者	金子	アシスタント	

振り回し(200ピッチ)

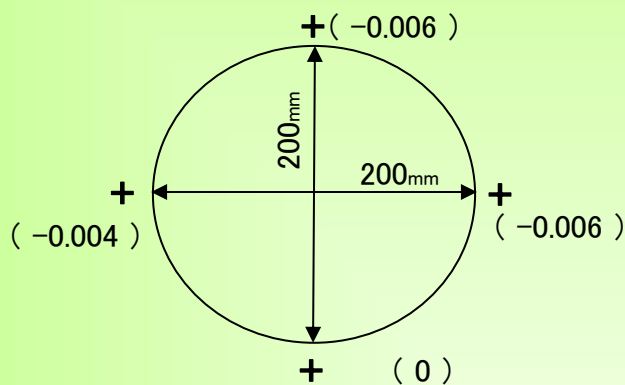

主軸振れ



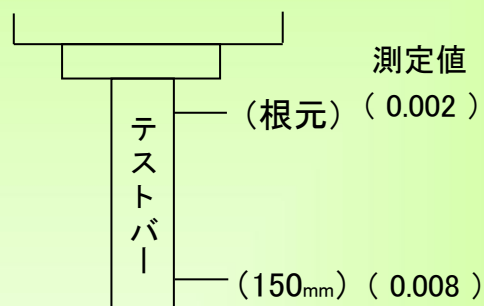


直角度

【YZ】 測定値 (0.004)


【XZ】 測定値 (0.002)

【X Y】 測定値 (0.006)

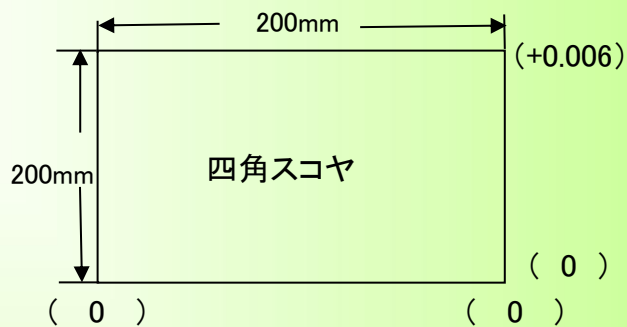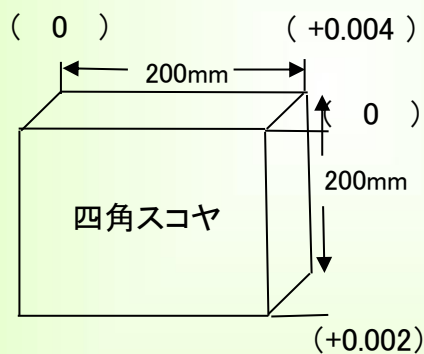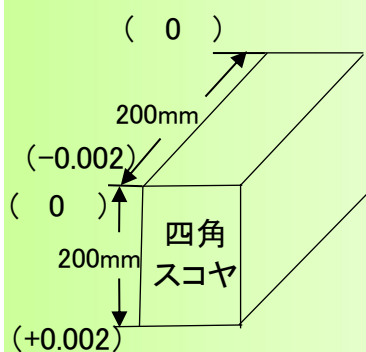

上面精度

※テーブルサイズ 600×400

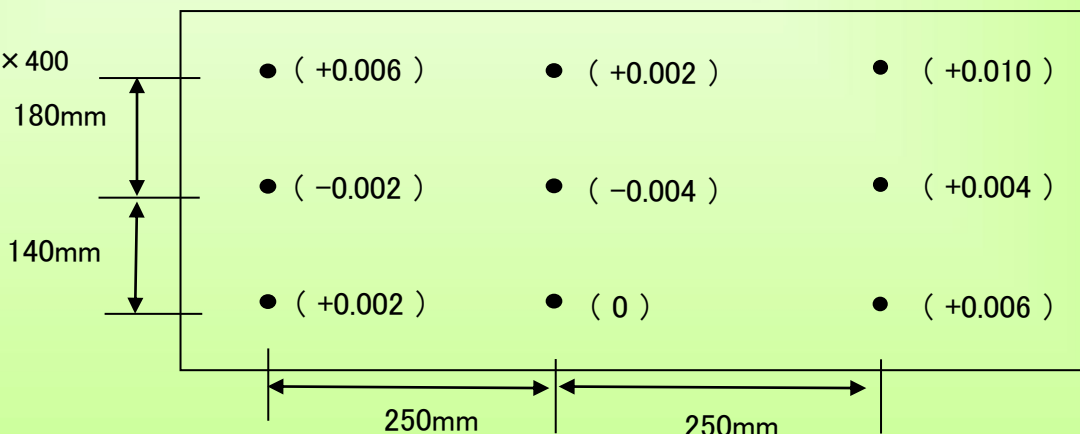

2025/7/3