


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	オークマ	年式	2007	管理番号	P008949
型式	MB-56VA	測定者	金子	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

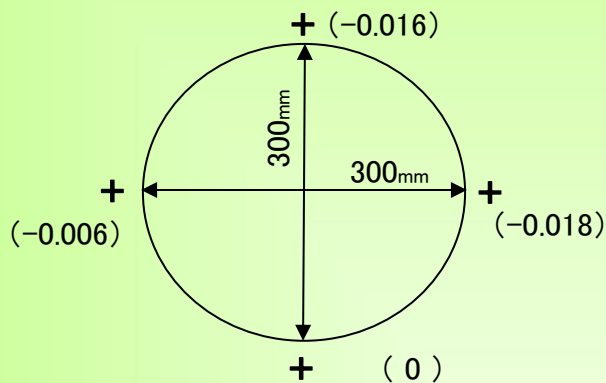

主軸振れ



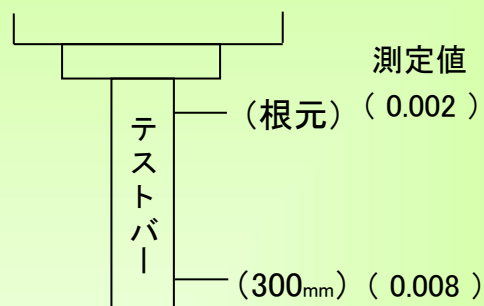


直角度

【YZ】測定値 (0.020)


【XZ】測定値 (0.016)

【X Y】測定値 (0.002)

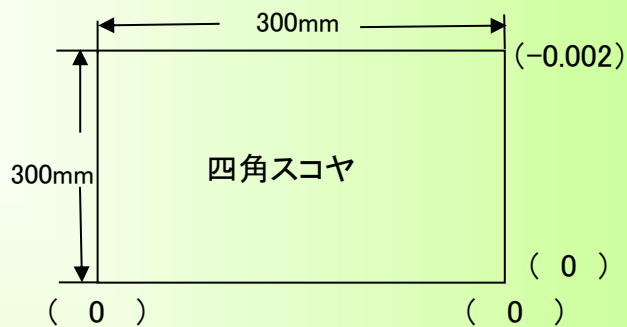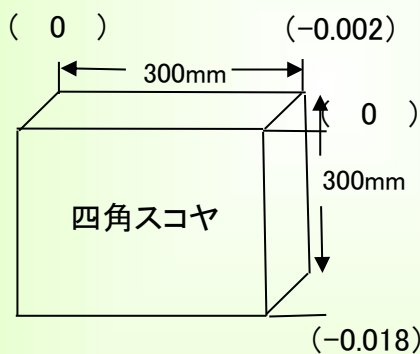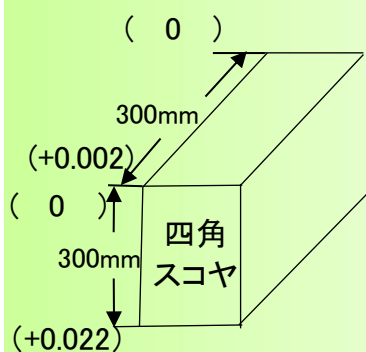

上面精度

※テーブルサイズ 1350×560

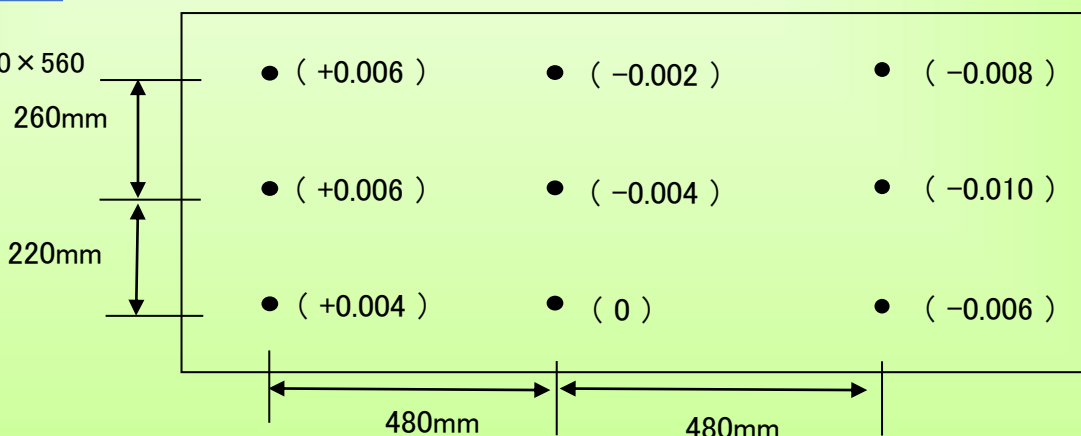

2025/7/14