


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	大隈豊和	年式	2004.12	管理番号	P008714
型式	MILLAC-468V	測定者	野辺 沼	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

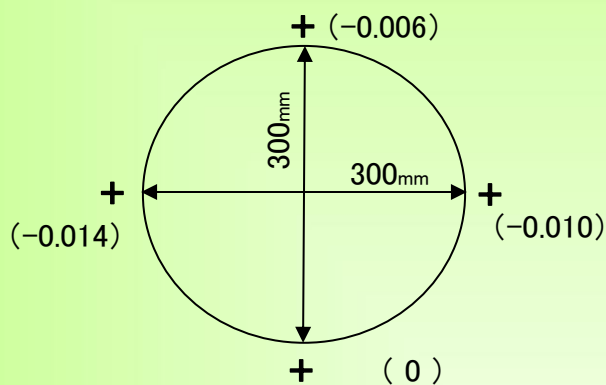

主軸振れ



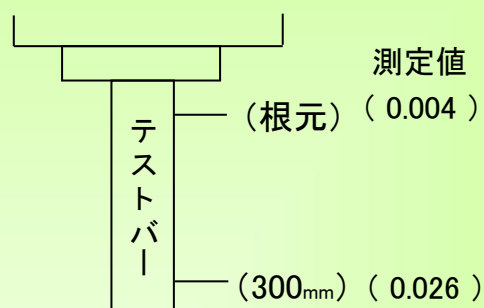


直角度

【YZ】測定値 (0.012)


【XZ】測定値 (0.004)

【X Y】測定値 (0.004)

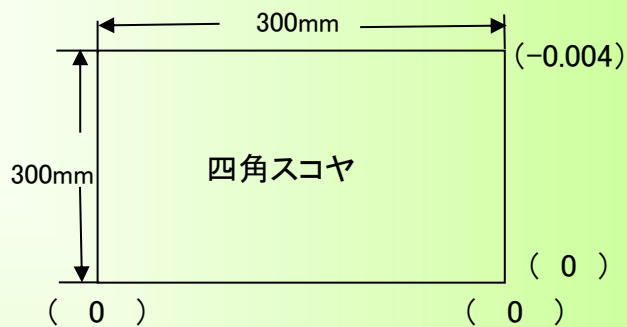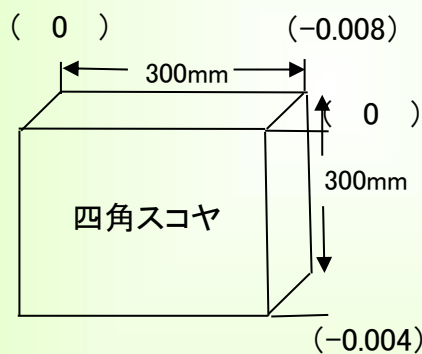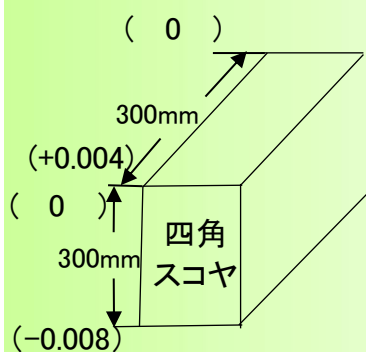

上面精度

※テーブルサイズ 1050×460

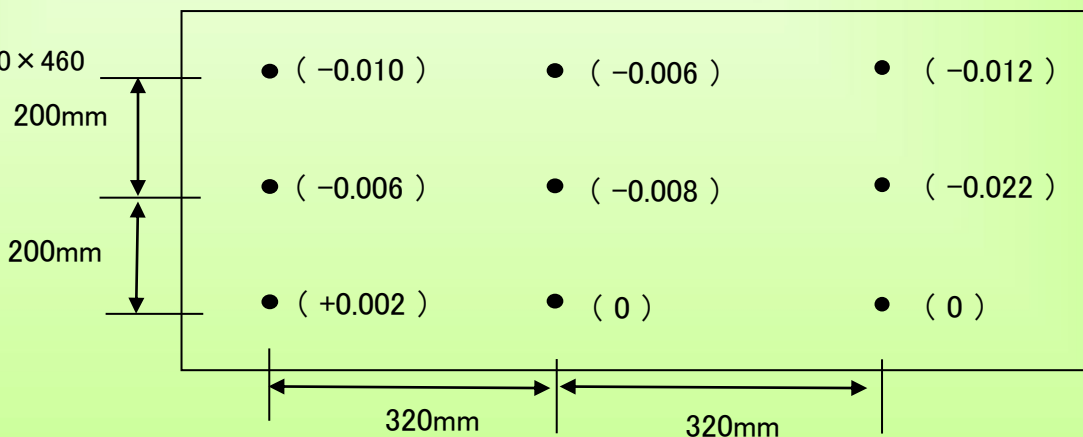

2025/7/23