


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	オークマ	年式	2016	管理番号	P008908
型式	MILLAC-468V II	測定者	金子	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

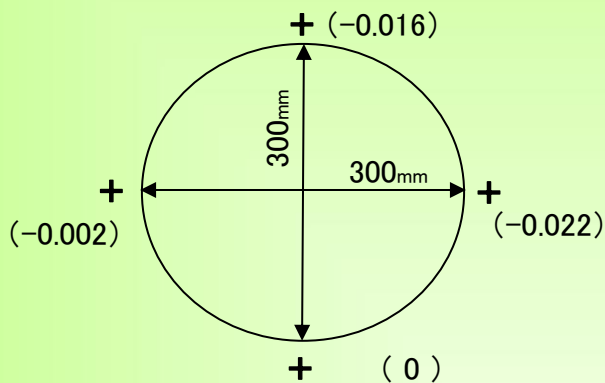

主軸振れ



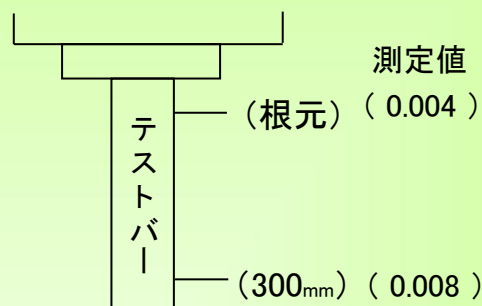


直角度

【YZ】 測定値 (0.014)


【XZ】 測定値 (0.004)

【X Y】 測定値 (0.004)

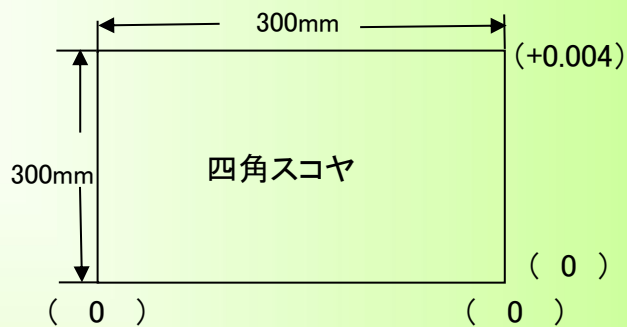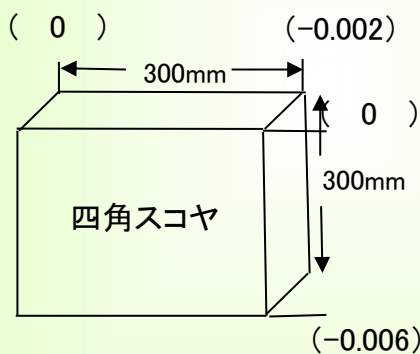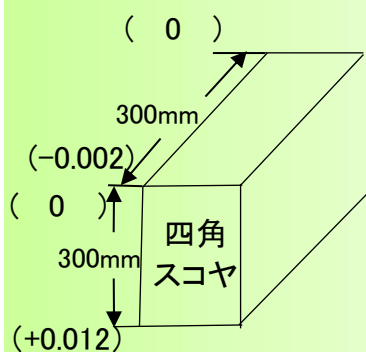

上面精度

※テーブルサイズ 1050 × 460

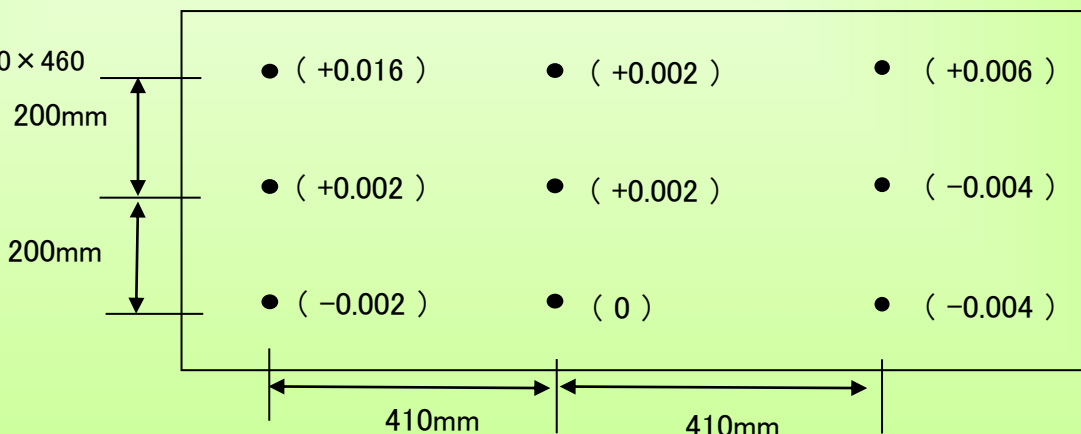

2025/7/17