


精度測定検査表

Examination for precision list


メーカー	ファナック	年式	2014.11	管理番号	P008994
型式	α -D14LiA5	測定者	野辺 沼	アシスタント	

切削時間 8652H

振り回し(200ピッチ)

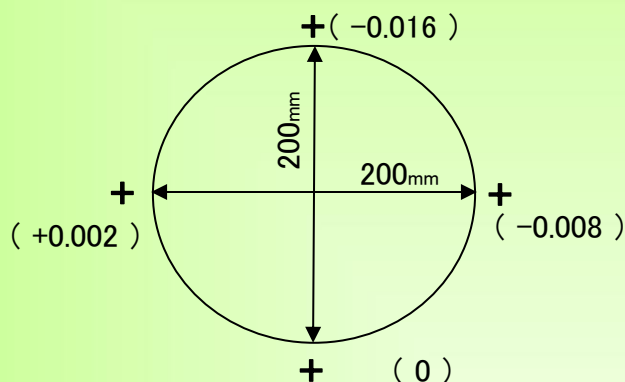

主軸振れ



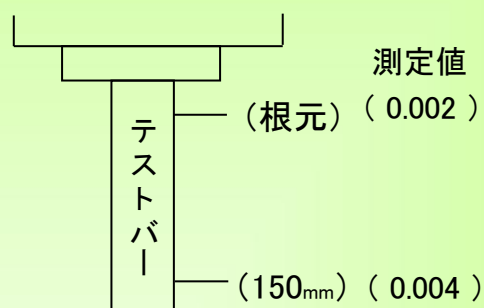


直角度

【YZ】測定値 (0.002)


【XZ】測定値 (0.012)

【X Y】測定値 (0.008)

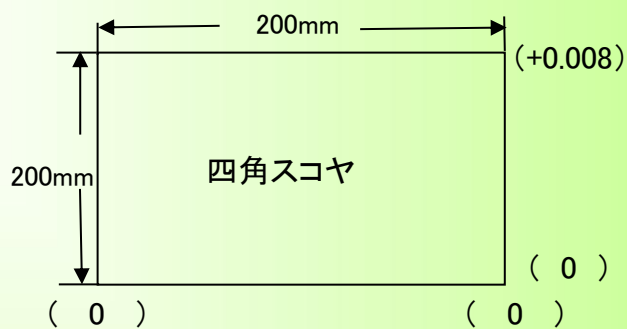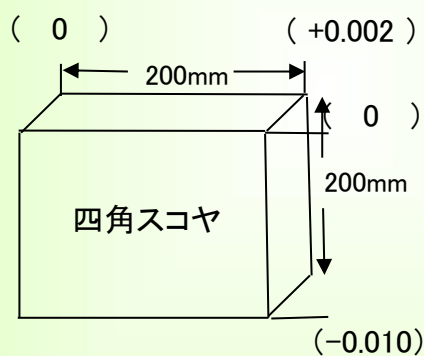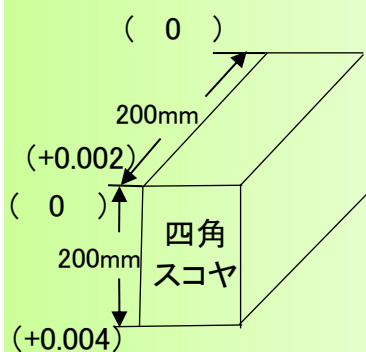

上面精度

※テーブルサイズ 850×410

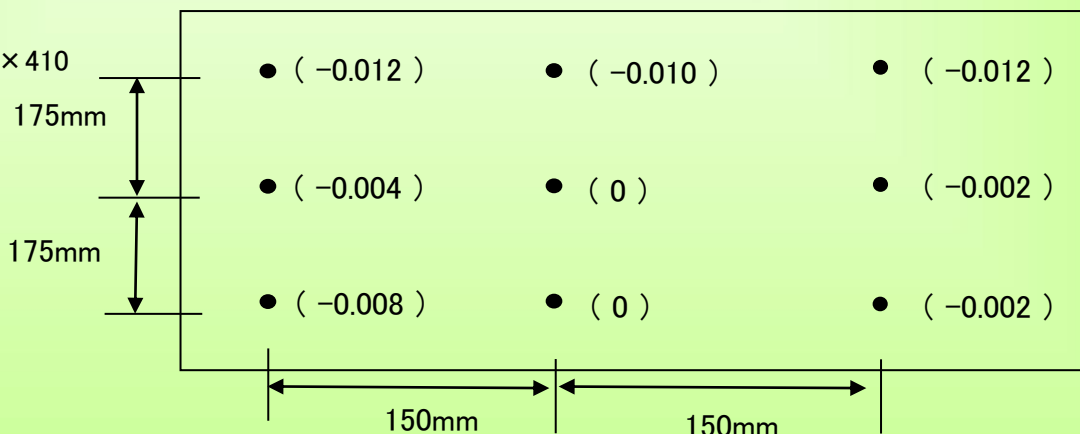

2025/8/7