


精度測定検査表

Examination for precision list


メーカー	ファナック	年式	2014.11	管理番号	P008995
型式	α -D14LiA5	測定者	立川	アシスタント	

切削時間 6307H

振り回し(200ピッチ)

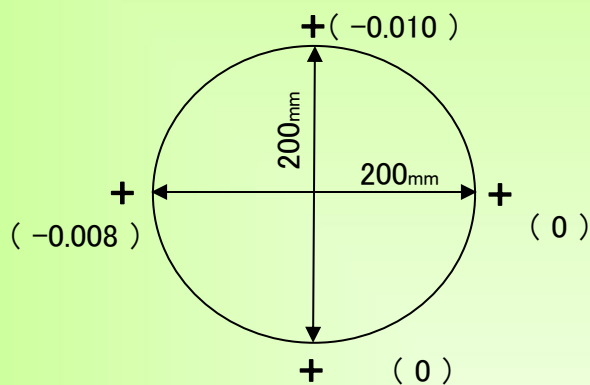

主軸振れ



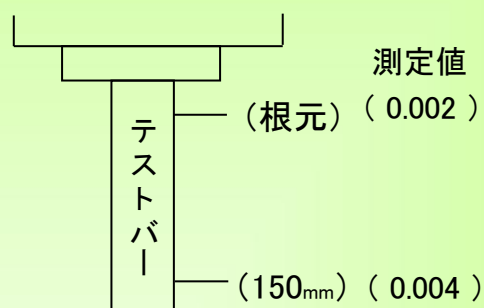


直角度

【YZ】 測定値 (0.010)


【XZ】 測定値 (0.004)

【X Y】 測定値 (0.002)

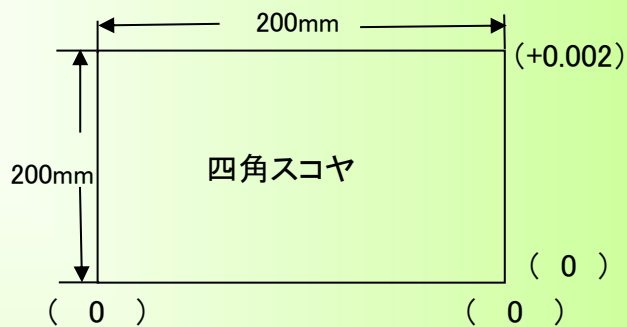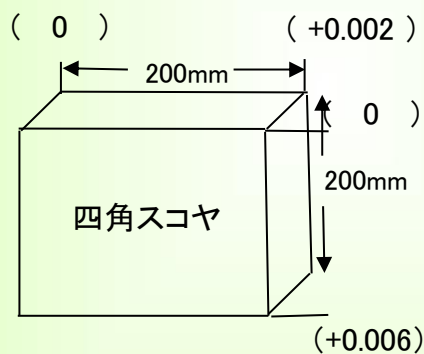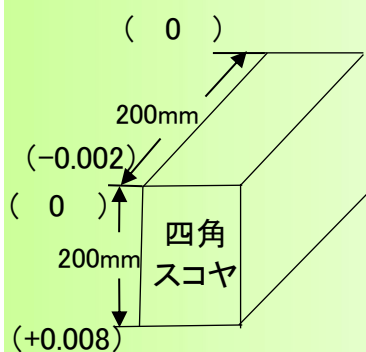

上面精度

※テーブルサイズ 850×410

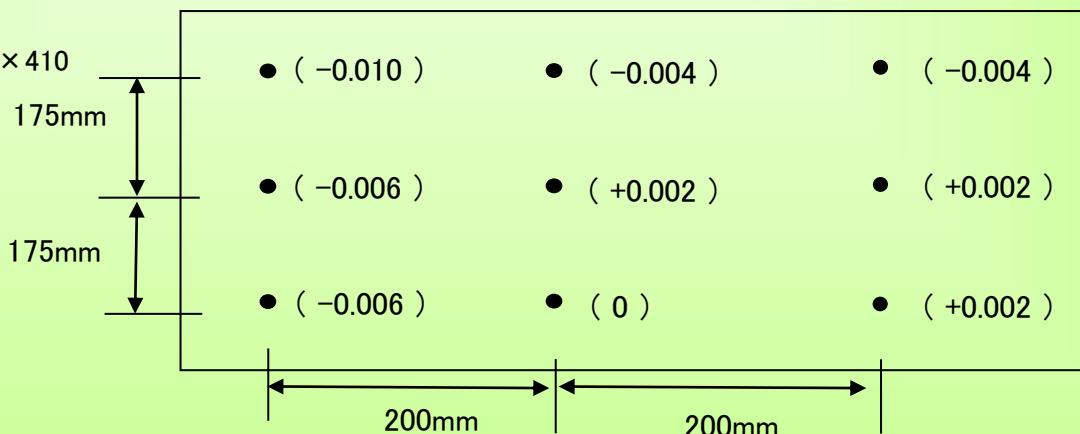

2025/8/7