


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	三井精機	年式	2000年製	管理番号	P006779
型式	HU50A	測定者	平野	アシスタント	

Z軸方向の平行度

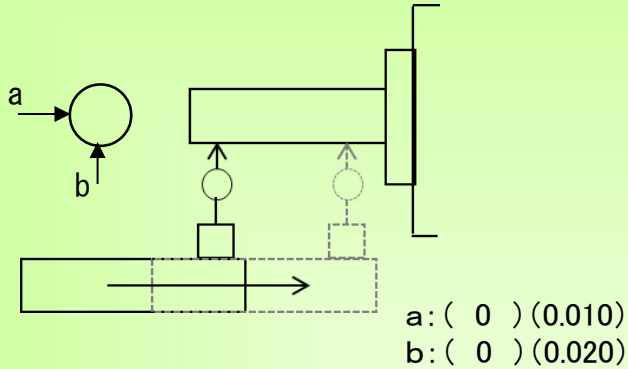

主軸振れ



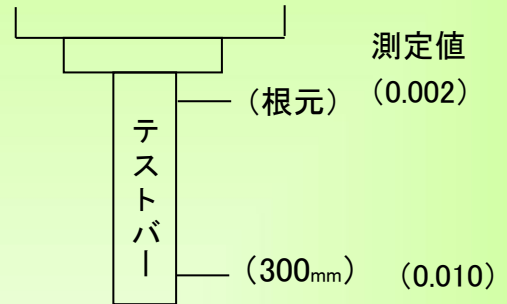


直角度

【XY】 測定値 (0.008)

【ZY】 測定値 (0.022)

【ZX】 測定値 (0.016)

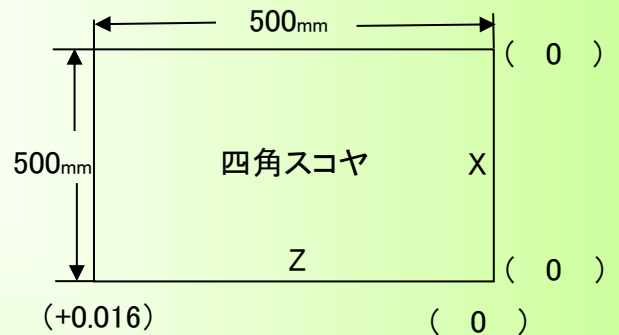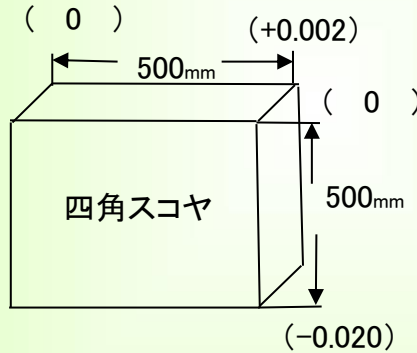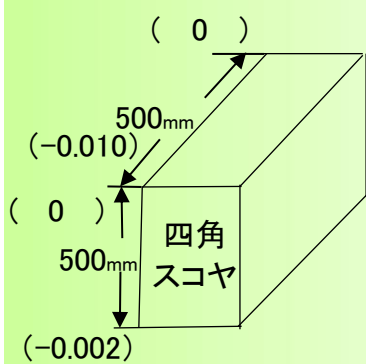

上面精度

テーブルサイズ: 500角

() → パレット1

