


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	キタムラ機械	年式	2006	管理番号	P008894
型式	Mycenter-0iF	測定者	野辺 沼	アシスタント	

振り回し(200ピッチ)

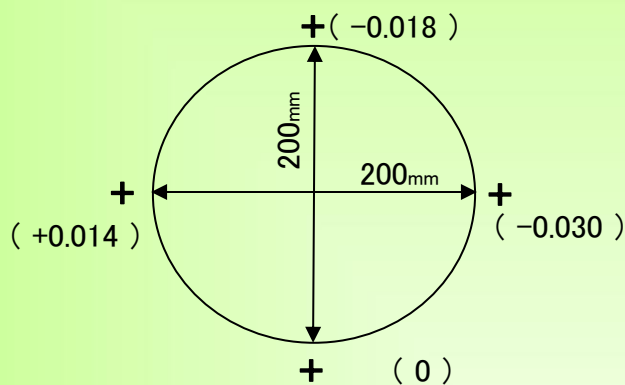

主軸振れ



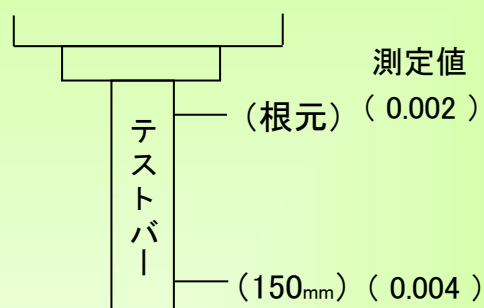


直角度

【YZ】測定値 (0.012)


【XZ】測定値 (0.042)

【X Y】測定値 (0.024)

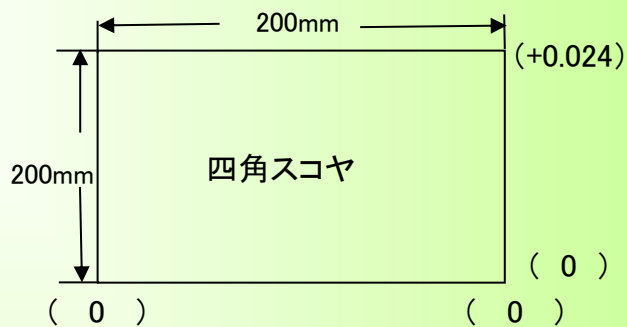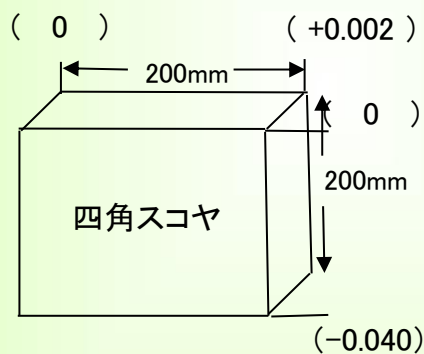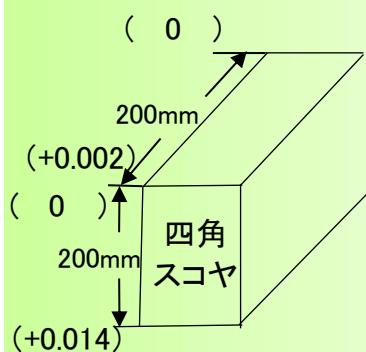

上面精度

※テーブルサイズ 610×310

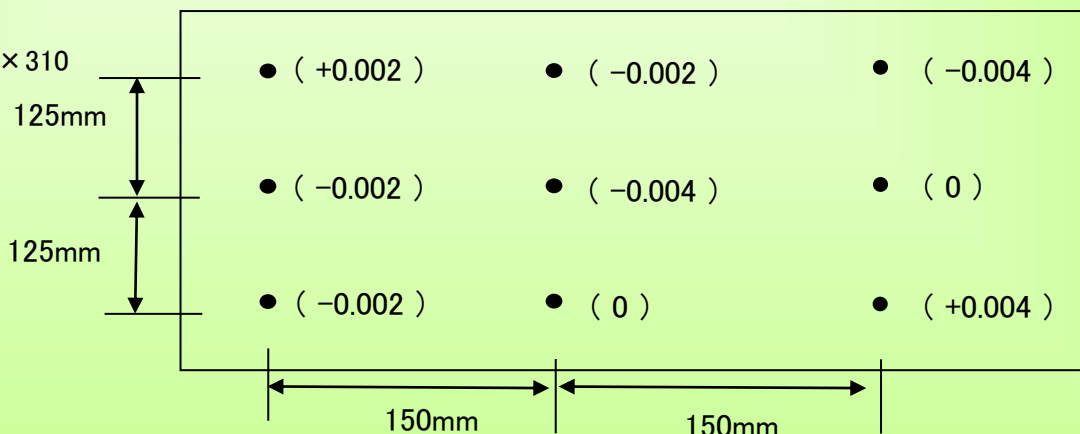

2025/8/20