


# 精度測定検査表


*Examination for precision list*

|      |                  |     |         |        |         |
|------|------------------|-----|---------|--------|---------|
| メーカー | ファナック            | 年式  | 2007.10 | 管理番号   | P008987 |
| 型式   | $\alpha$ -T14iFL | 測定者 | 金子      | アシスタント |         |

## 振り回し(200ピッチ)

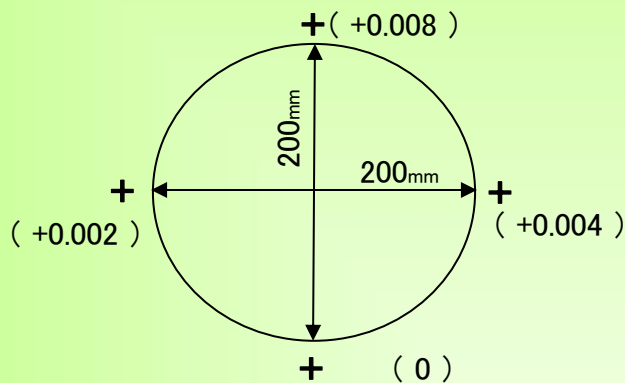

## 主軸振れ



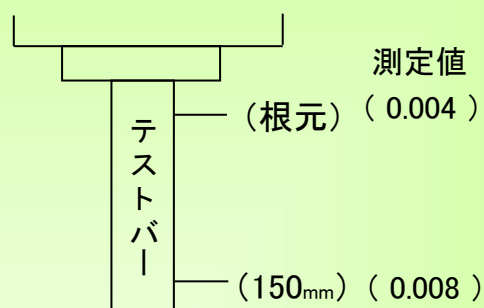


## 直角度

【YZ】測定値 (0.016)


【XZ】測定値 (0.012)

【X Y】測定値 (0.008)

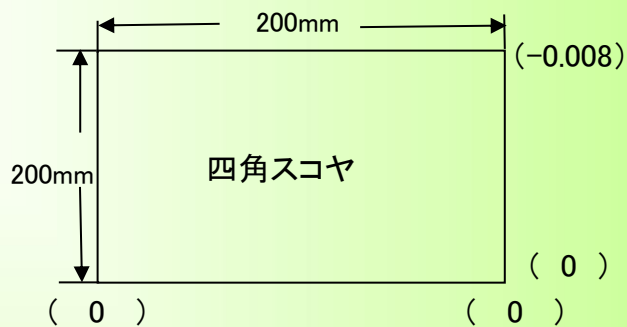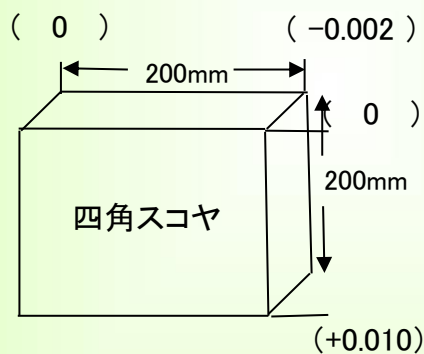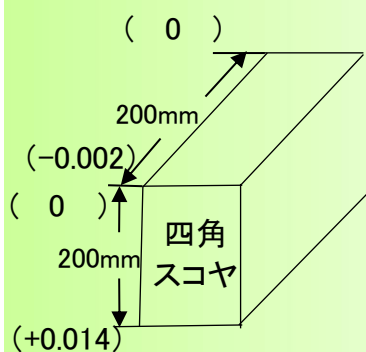

## 上面精度

※テーブルサイズ 850  $\times$  410

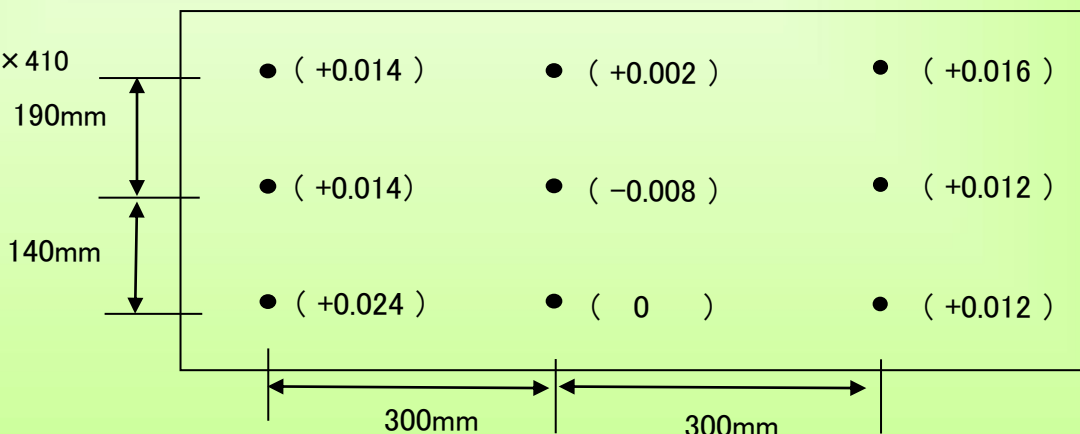

2025/8/25