


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	碌々産業	年式	2006	管理番号	P008457
型式	NANO-21	測定者	金子	アシスタント	

振り回し(100ピッチ)

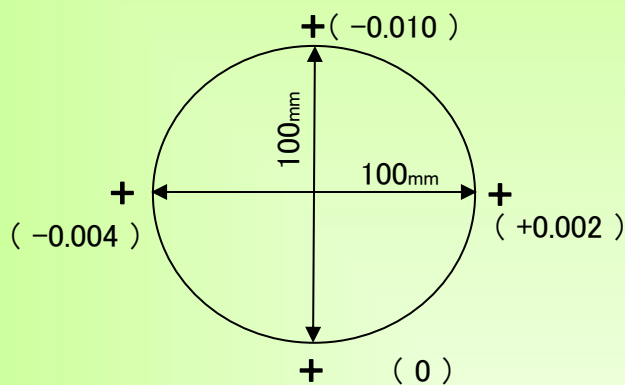

主軸振れ



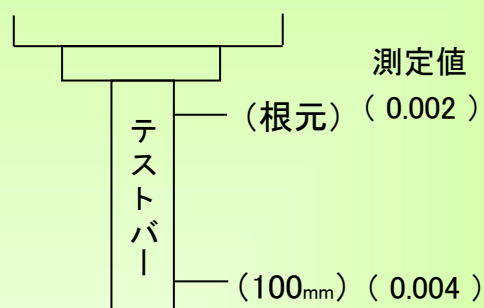


直角度

【YZ】測定値 (0.008)


【XZ】測定値 (0.004)

【X Y】測定値 (0.002)

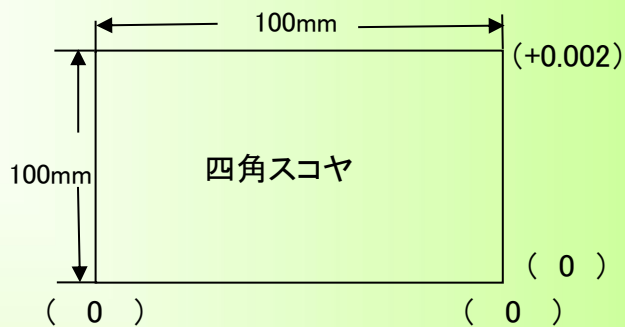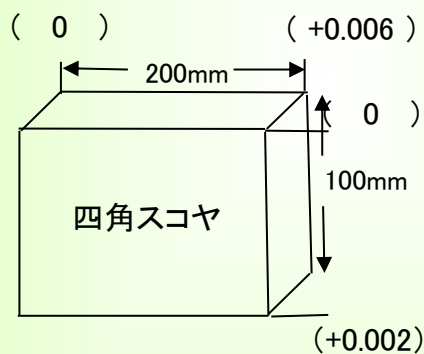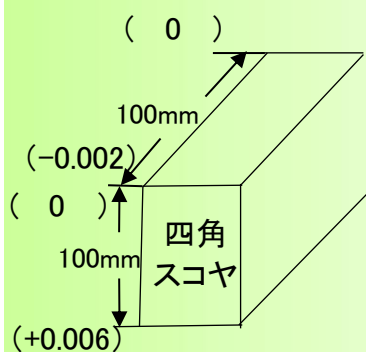

上面精度

※テーブルサイズ

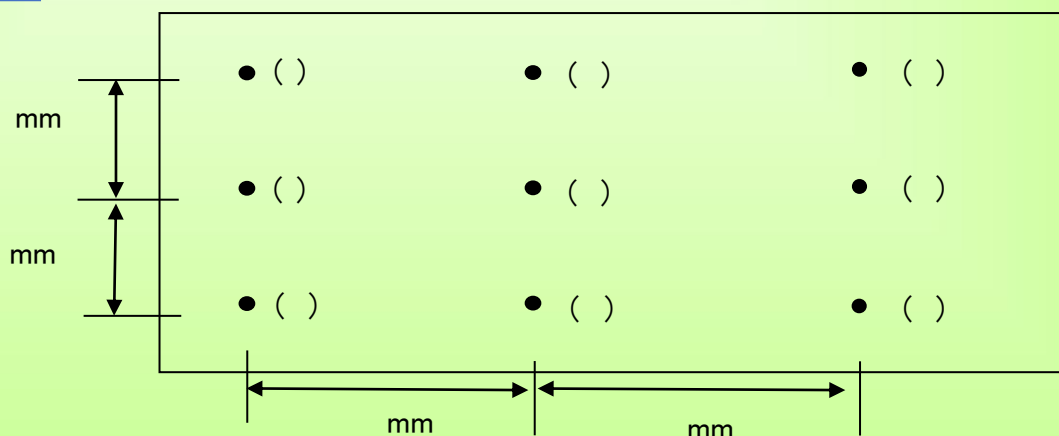

2025/8/25