


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	森精機	年式	2003.10	管理番号	P008734
型式	NV5000A/40	測定者	野辺 沼	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

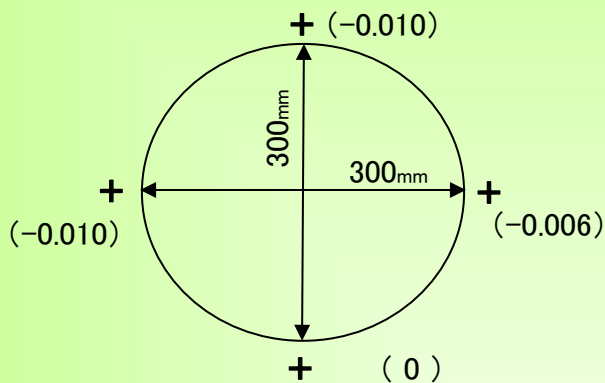

主軸振れ



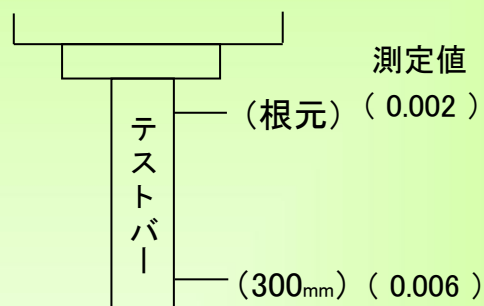


直角度

【YZ】測定値 (0.010)


【XZ】測定値 (0.024)

【X Y】測定値 (0.014)

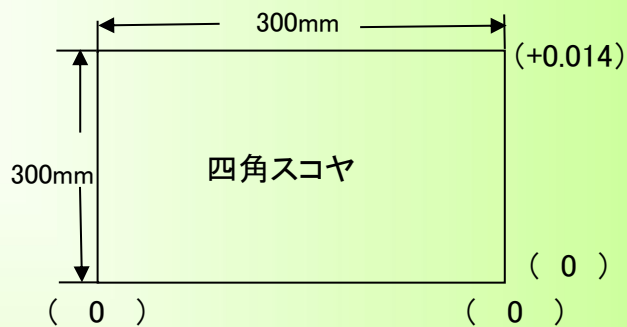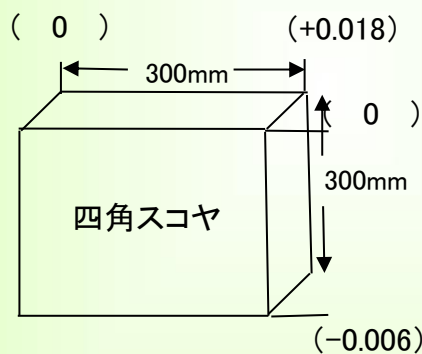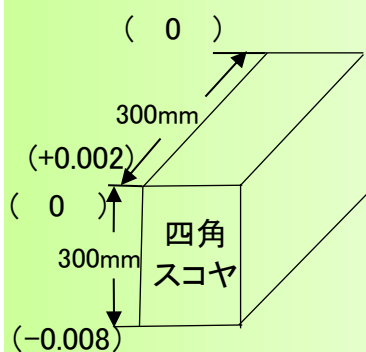

上面精度

※テーブルサイズ 1100×600

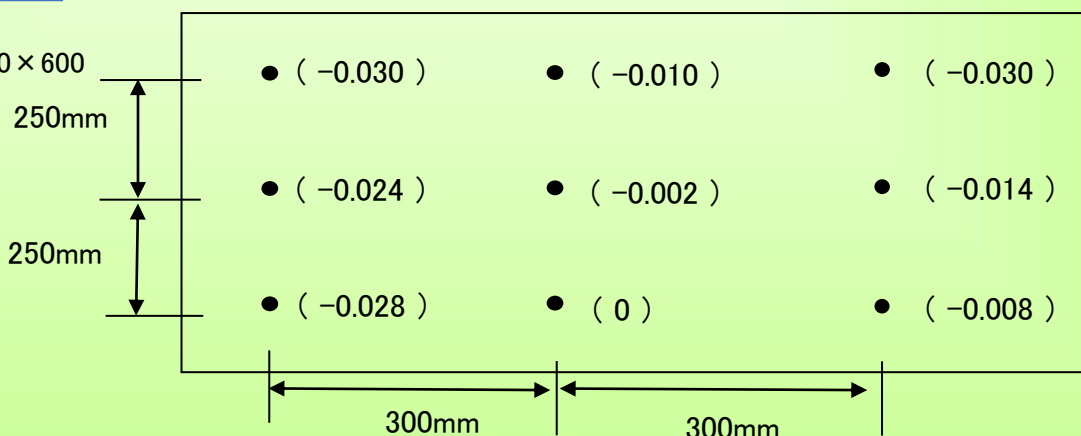

2025/1/30