


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	ファナック	年式	2013	管理番号	P009022
型式	α -D21MiA5	測定者	金子	アシスタント	

振り回し(200ピッチ)

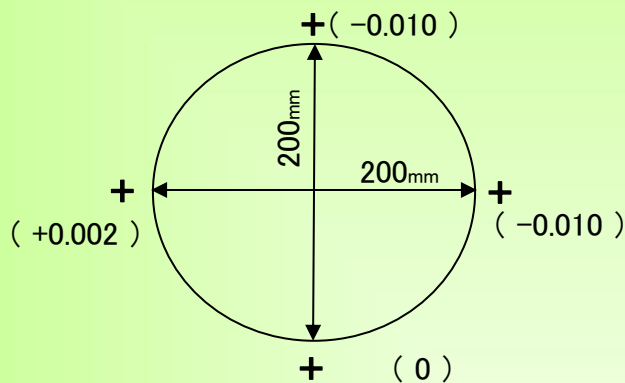

主軸振れ



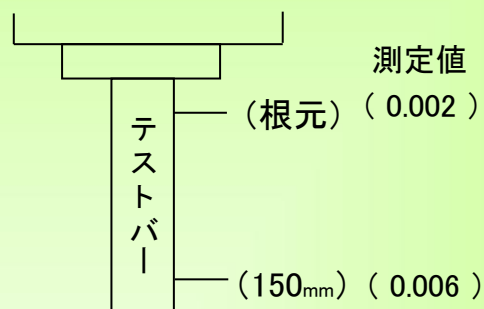


直角度

【YZ】 測定値 (0.006)


【XZ】 測定値 (0.002)

【X Y】 測定値 (0.002)

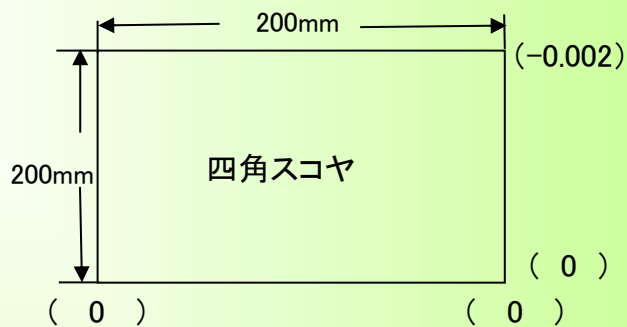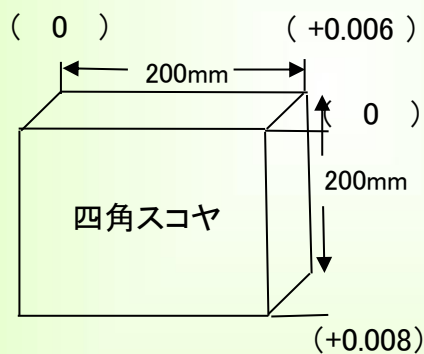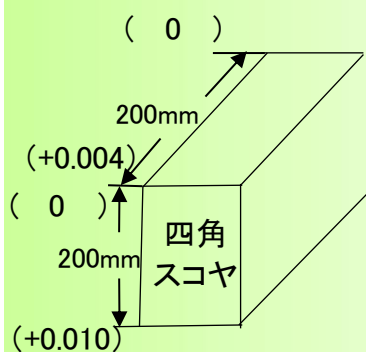

上面精度

※テーブルサイズ 650 × 400

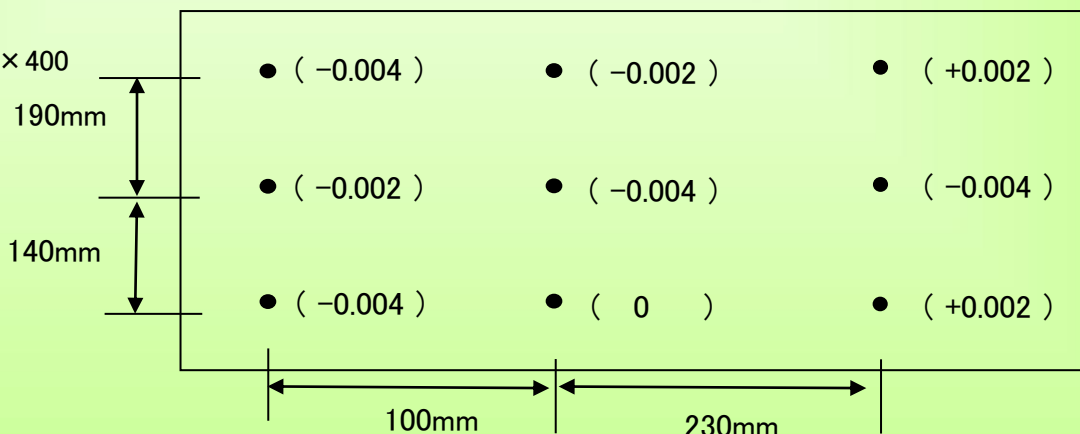

2025/8/29