


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	ファナック	年式	2003.10	管理番号	P009032
型式	α -T21iDL	測定者	金子	アシスタント	

振り回し(200ピッチ)

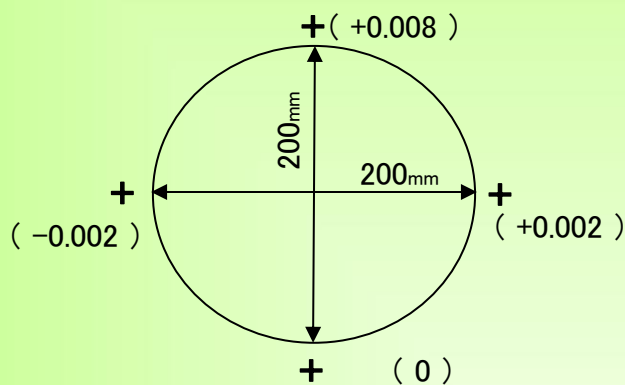

主軸振れ



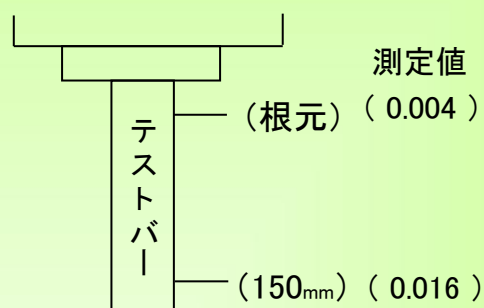


直角度

【YZ】 測定値 (0.004)


【XZ】 測定値 (0.004)

【X Y】 測定値 (0.002)

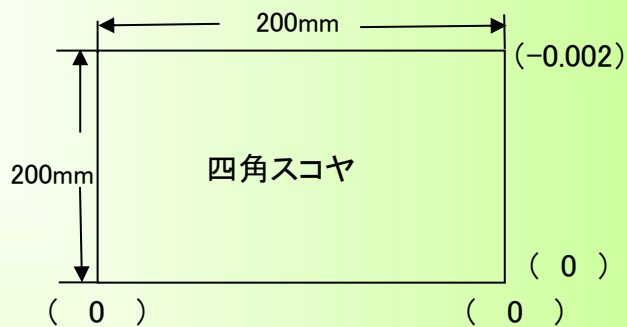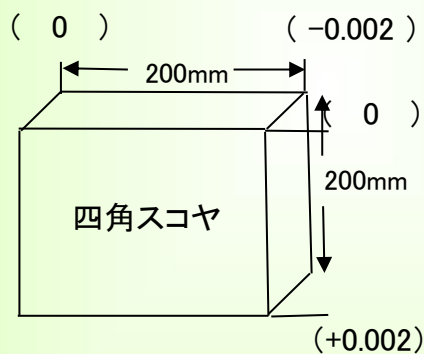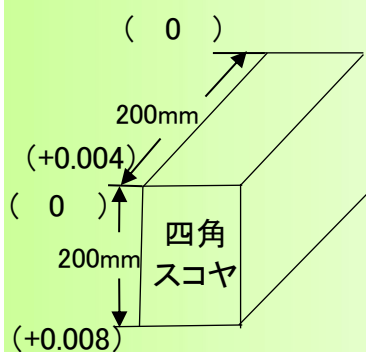

上面精度

※テーブルサイズ 850×410

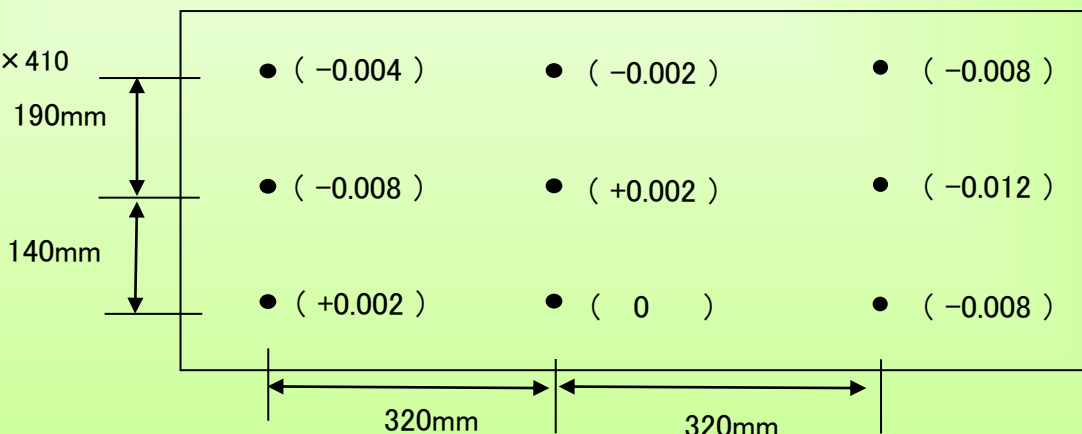

2025/9/3