


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	ブラザー	年式	2013.10	管理番号	P008654
型式	TC-S2DN-0	測定者	金子	アシスタント	

振り回し(200ピッチ)

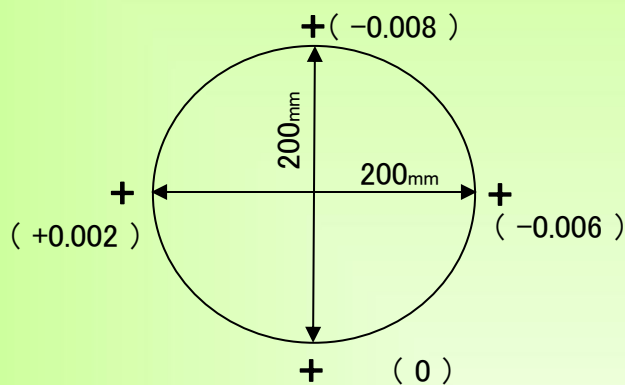

主軸振れ



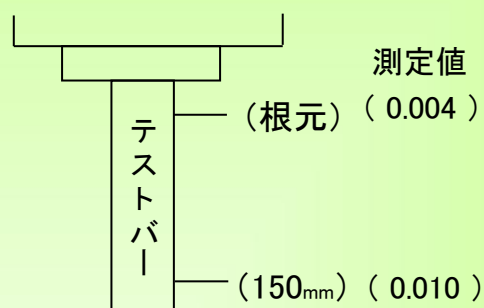


直角度

【YZ】測定値 (0.008)


【XZ】測定値 (0.014)

【X Y】測定値 (0.004)

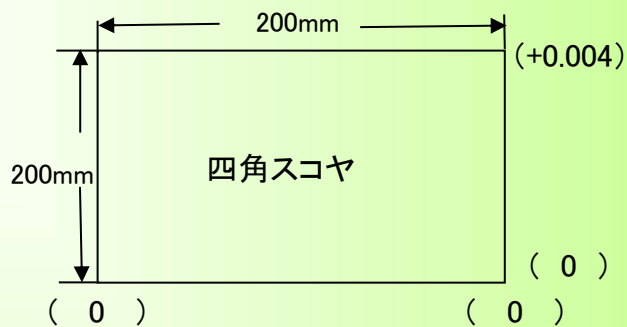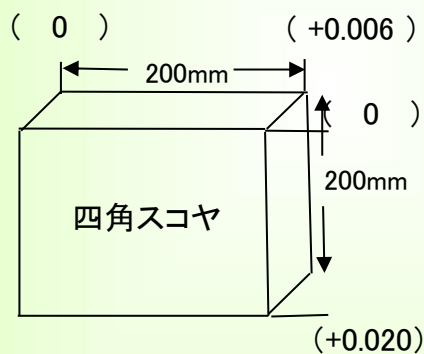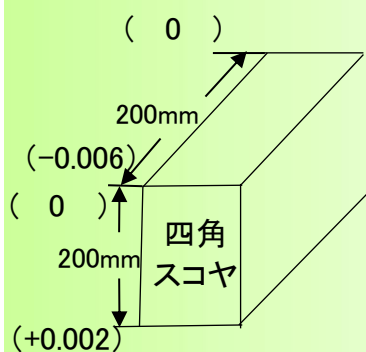

上面精度

※テーブルサイズ 800×400

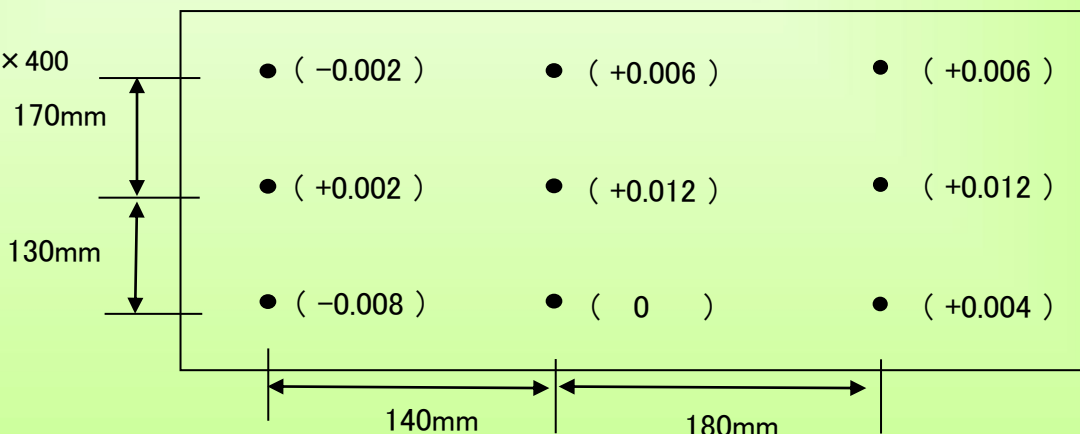

2025/9/1