


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	ファナック	年式	2000.10	管理番号	P008962
型式	α -T14iB	測定者	野辺沼	アシスタント	

振り回し(200ピッチ)

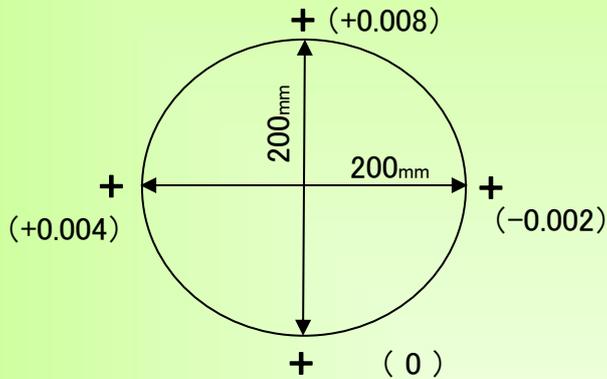

主軸振れ



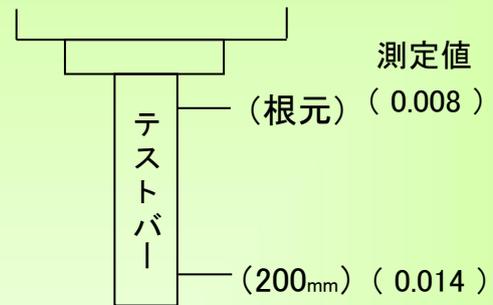


直角度

【YZ】測定値 (0.004)


【XZ】測定値 (0.008)

【XY】測定値 (0.008)

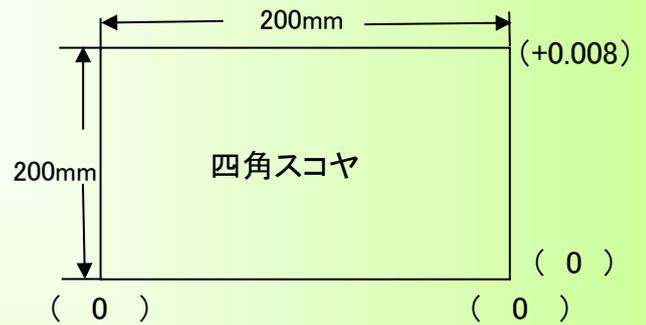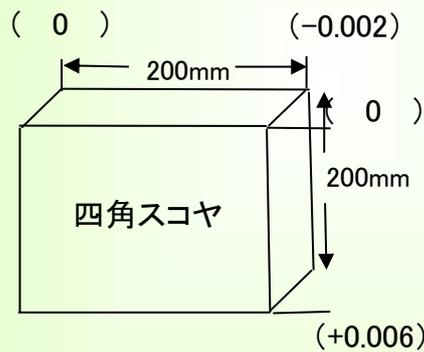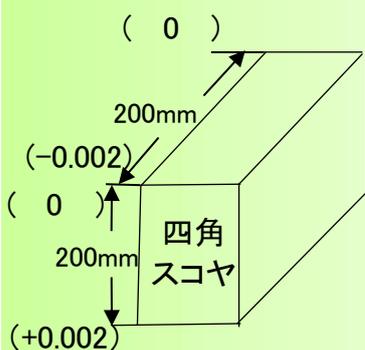

上面精度

※テーブルサイズ 650×400

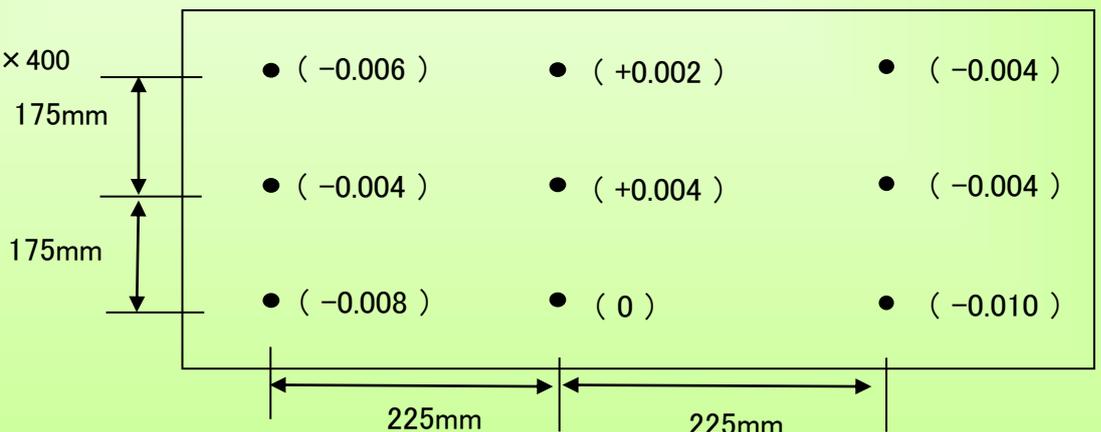

2025/9/6