


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	オークマ	年式	2016	管理番号	P009040
型式	MILLAC-468V II	測定者	立川	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

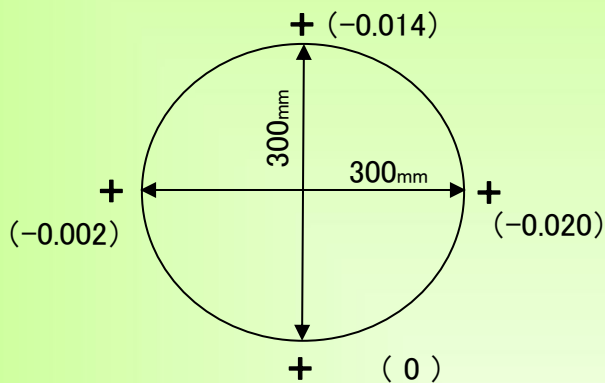

主軸振れ



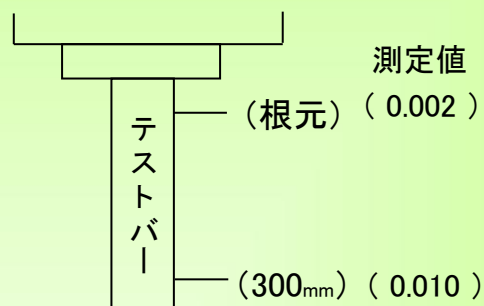


直角度

【YZ】 測定値 (0.016)

【XZ】 測定値 (0.008)

【X Y】 測定値 (0.002)

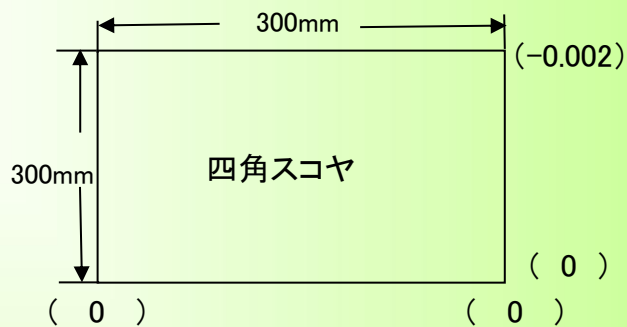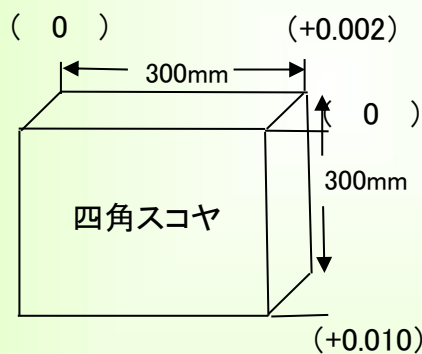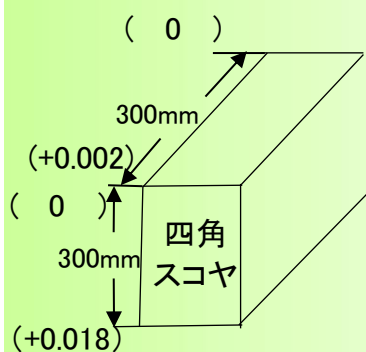


上面精度

※テーブルサイズ 820×460

A→ ()

B→ < >

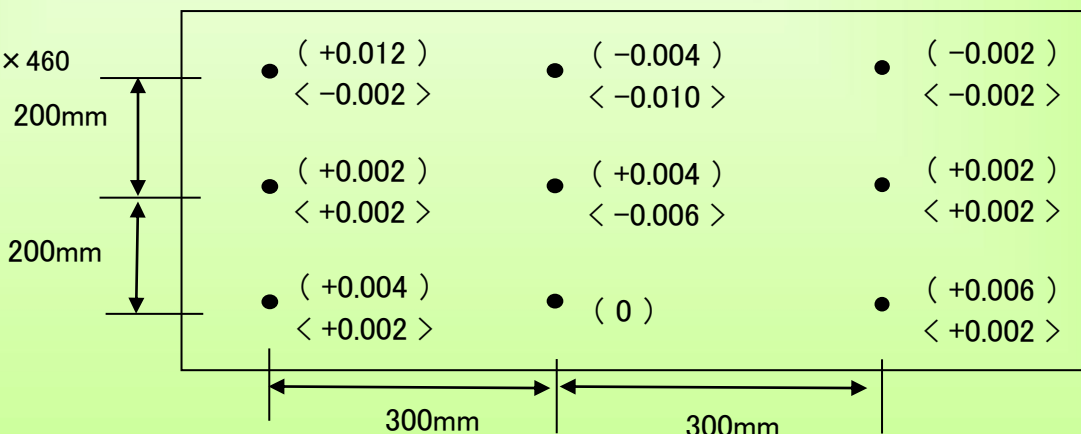

2025/9/6