


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	OKK	年式	2005	管理番号	P008960
型式	HP400	測定者	野辺 沼	アシスタント	平沢

Z軸方向の平行度

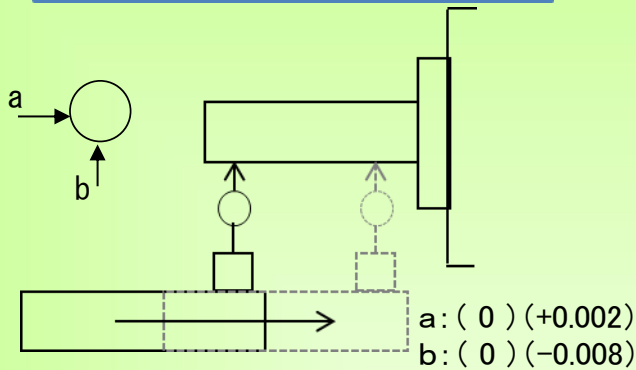


主軸振れ

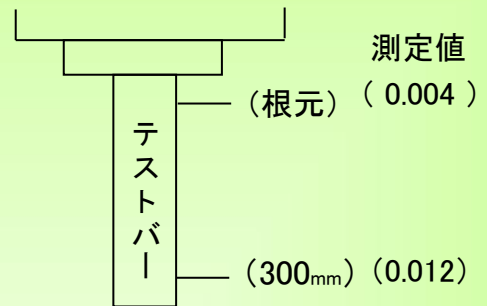


直角度

【XY】測定値 (0.004)

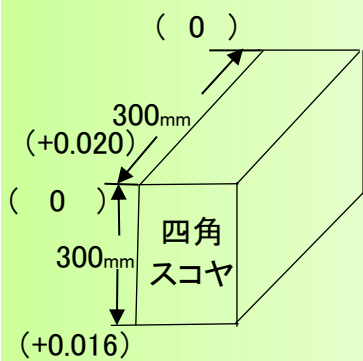

【ZY】測定値 (0.004)

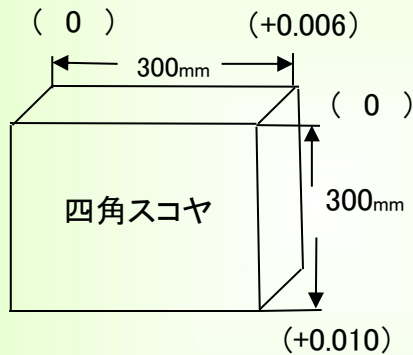


【ZX】測定値 (0.006)



上面精度

テーブルサイズ: 400角
()パレット1
[]パレット2

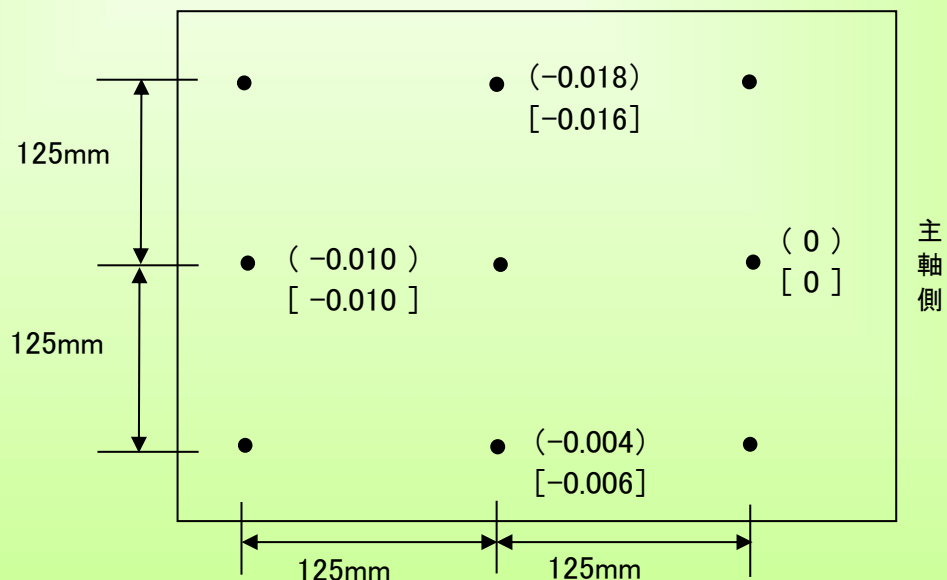

2025/9/11