


# 精度測定検査表


*Examination for precision list*

|      |              |     |      |        |         |
|------|--------------|-----|------|--------|---------|
| メーカー | 森精機          | 年式  | 2006 | 管理番号   | P009004 |
| 型式   | NV5000a1B/50 | 測定者 | 金子   | アシスタント |         |

## 振り回し(300ピッチ)

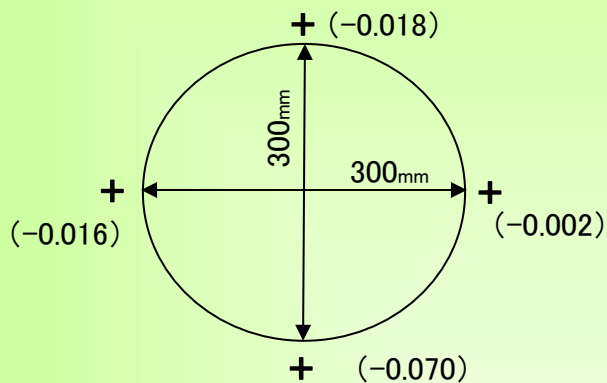

## 主軸振れ



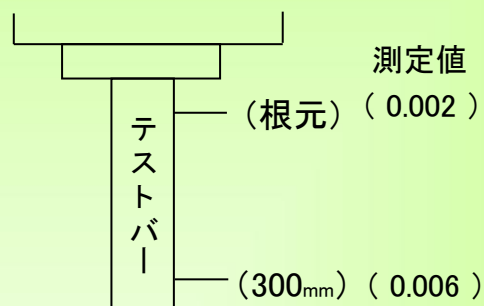


## 直角度

【YZ】測定値 (0.012)


【XZ】測定値 (0.014)

【X Y】測定値 (0.004)

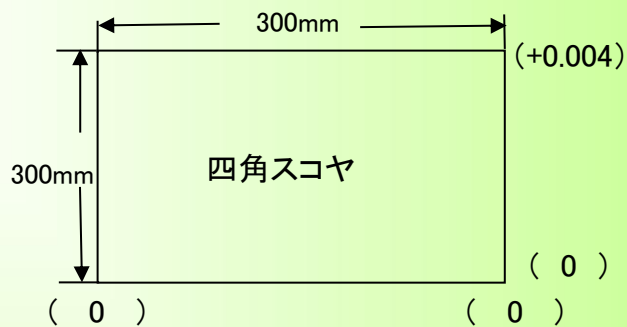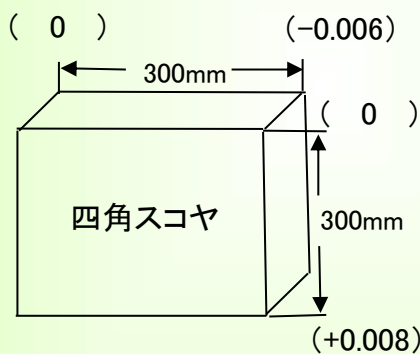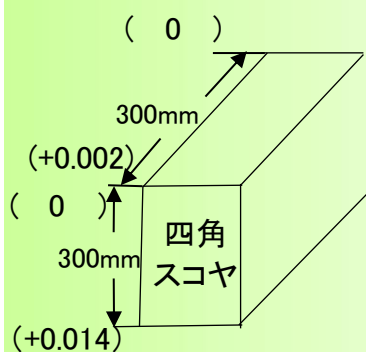

## 上面精度

※テーブルサイズ 1320×600

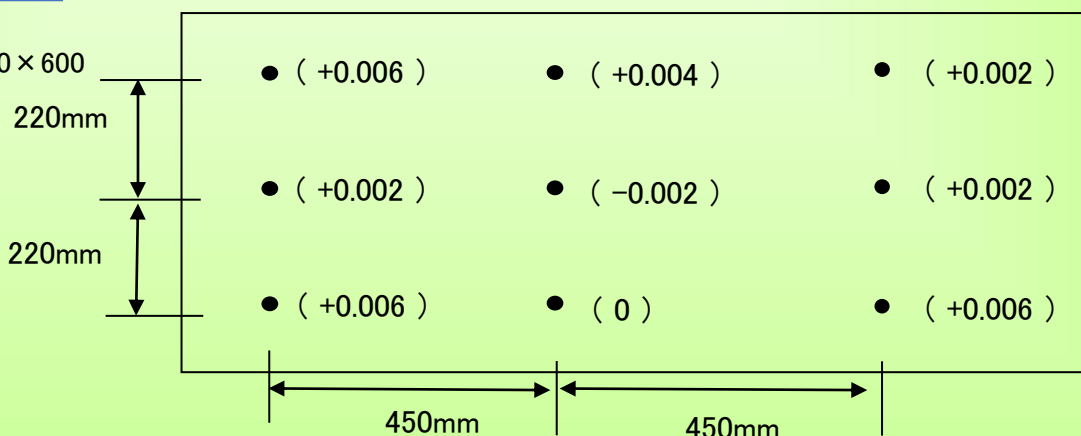

2025/9/16