



精度測定検査表

Examination for precision list

メーカー	ファナック	年式	2003年製	管理番号	P006710
型式	α -T14iD	測定者	野辺沼	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

主軸振れ


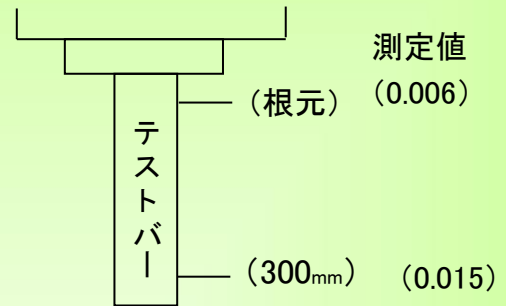
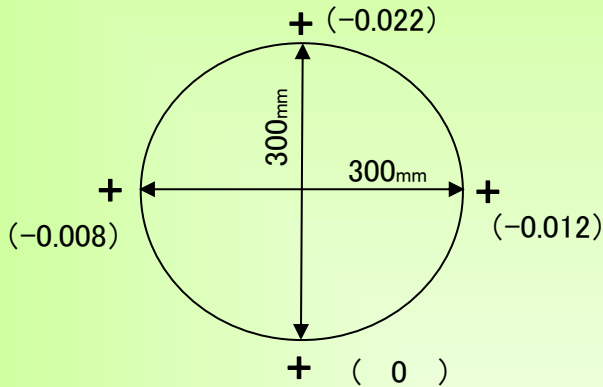


直角度

【Y Z】測定値 (0.012)

【X Z】測定値 (0.006)

【X Y】測定値 (0.010)

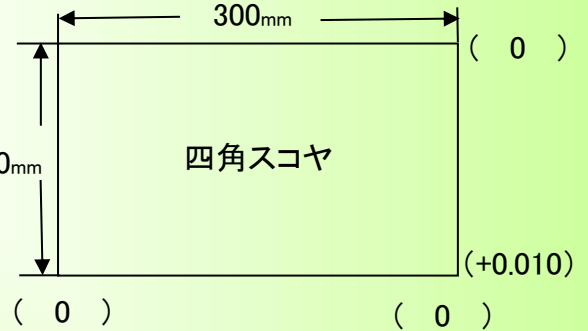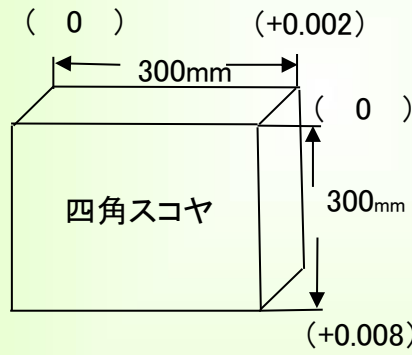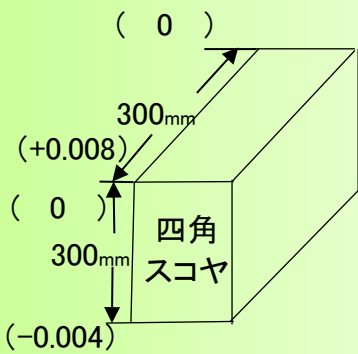

上面精度

※テーブルサイズ 650 × 400

