


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	山崎技研	年式	2009	管理番号	H019225
型式	YZ-400NCR	測定者	仙田	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

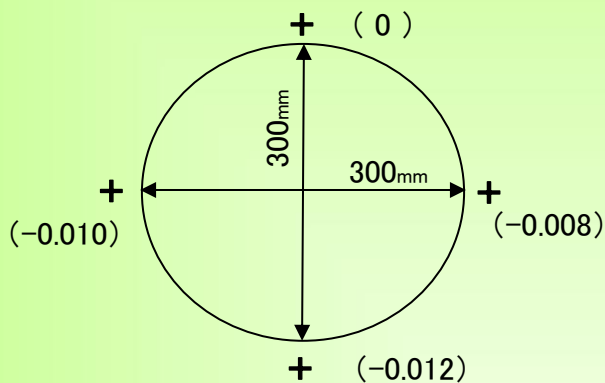

主軸振れ



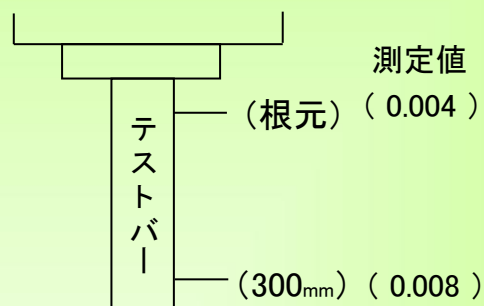


直角度

【YZ】測定値 (0.002)


【XZ】測定値 (0.022)

【X Y】測定値 (0.002)

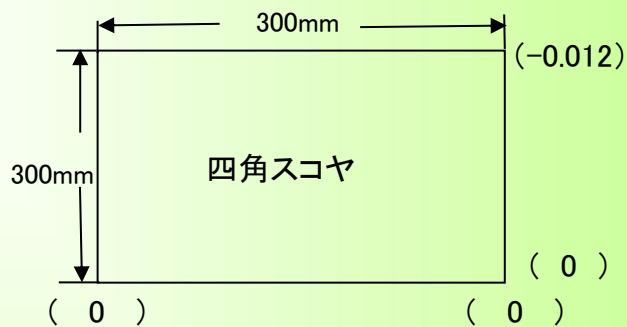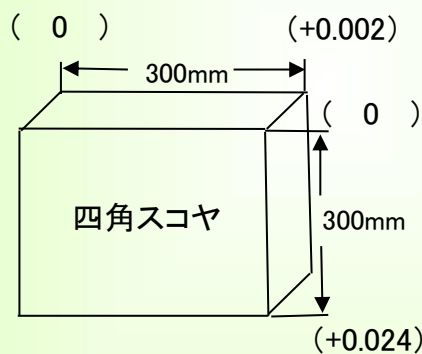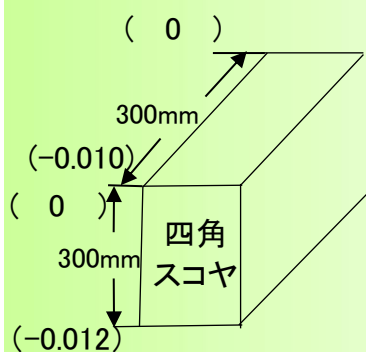

上面精度

※テーブルサイズ 400×1400

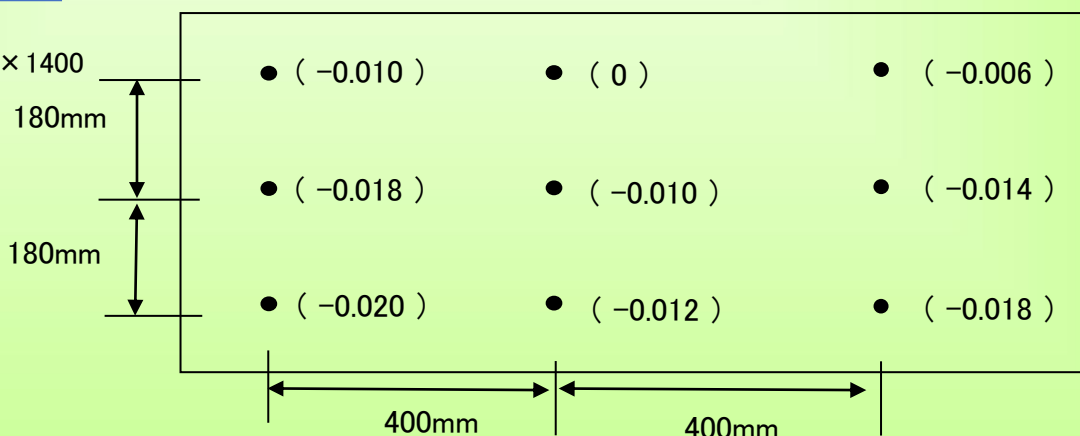

2025/6/6