


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	ヤマザキマザック	年式	2023	管理番号	P008948
型式	VARIAXIS J-500	測定者	金子	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

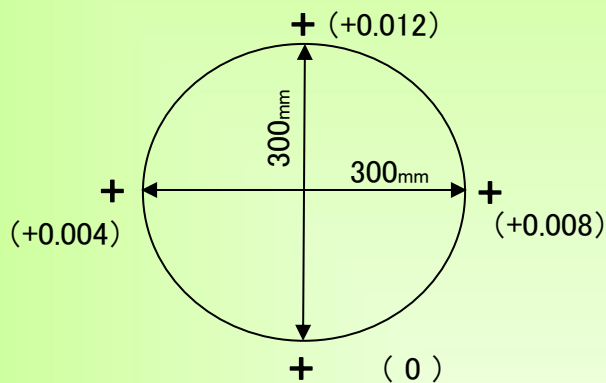

主軸振れ



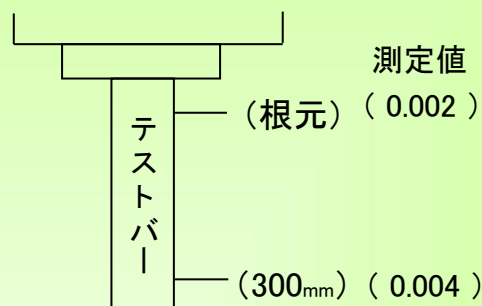


直角度

【YZ】測定値 (0.012)

【XZ】測定値 (0.006)

【X Y】測定値 (0.006)

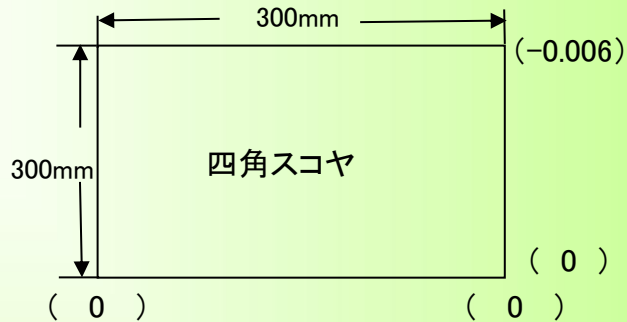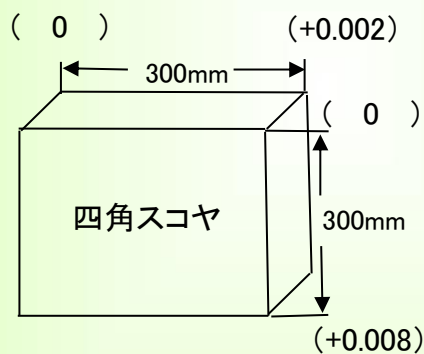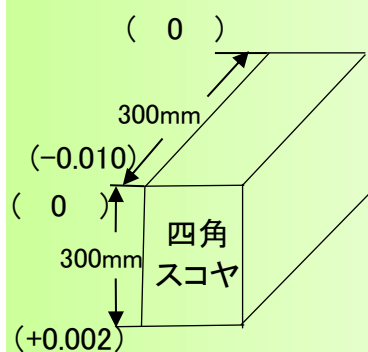


上面精度

※テーブルサイズ Φ500

[] → A軸-90°

の位置

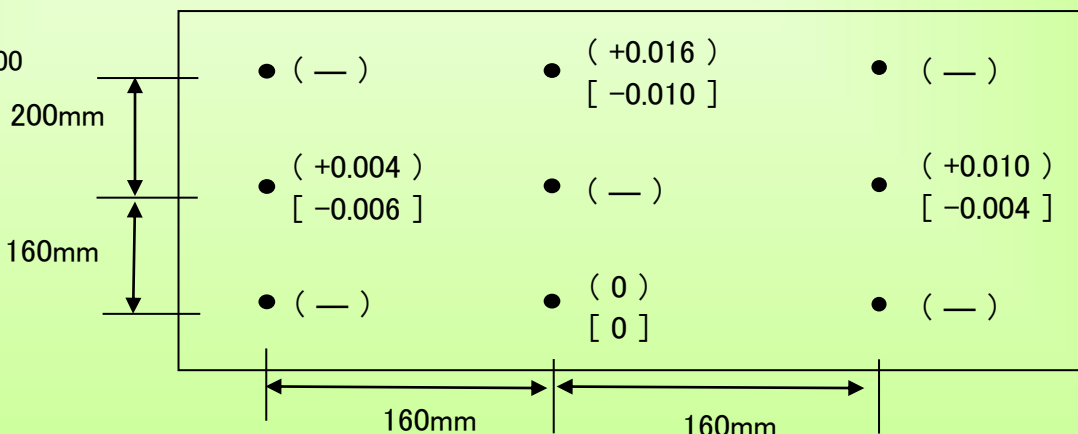

2025/9/22