

精度測定検査表

Examination for precision list


測定日

2013. 2. 7


メーカー	森精機	バーコード	P1886
型式	NH4000DCG		

精度評価		コメント
A	0 ~ 0.02mm	精度良好です
B	0 ~ 0.03mm	
C	0 ~ 0.04mm	
D	0 ~ 0.05mm	

振り回し(300ピッチ)

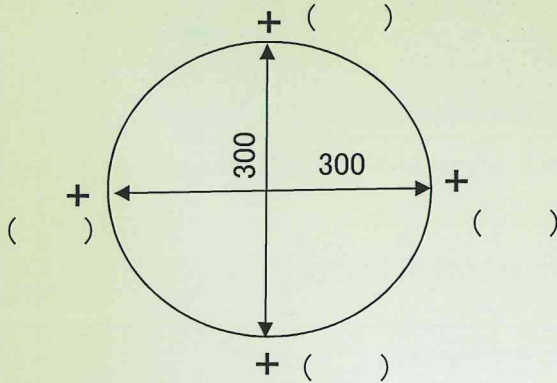


主軸振れ

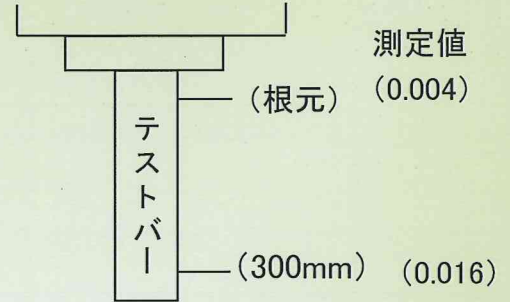

直角度


(1パレット)[2パレット]

【Y Z】

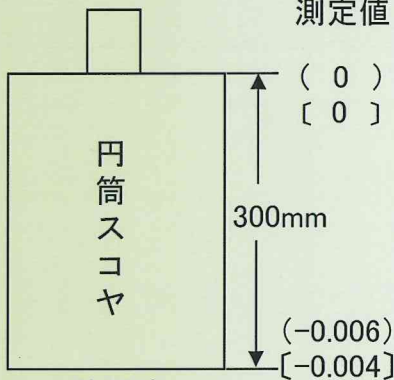


前倒れ

【X Z】

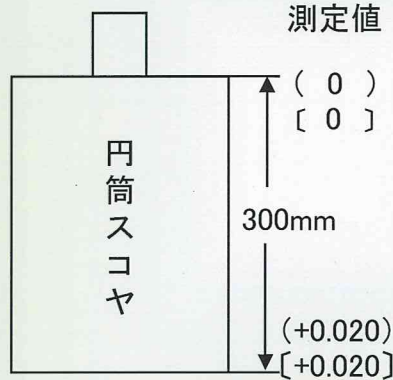

【X Y】

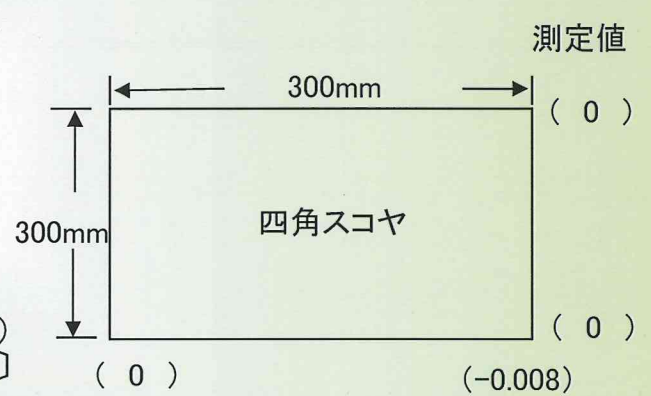

上面精度

