


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	OKK	年式	2008	管理番号	P008700
型式	VM5III	測定者	金子	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

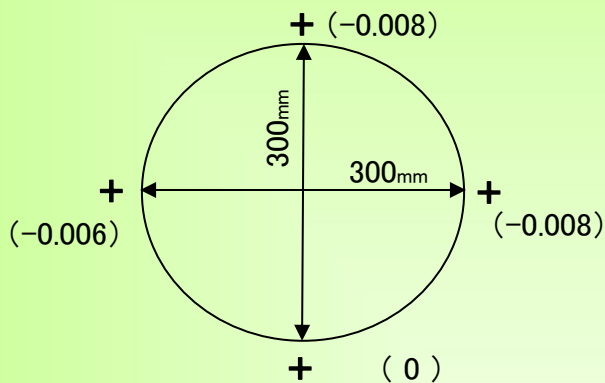

主軸振れ



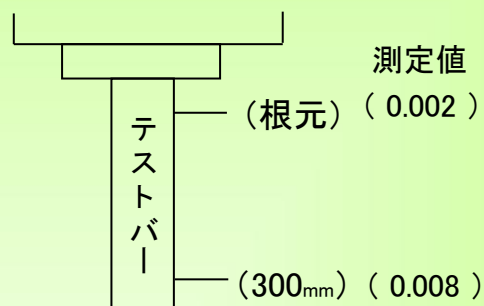


直角度

【YZ】測定値 (0.014)


【XZ】測定値 (0.010)

【X Y】測定値 (0.014)

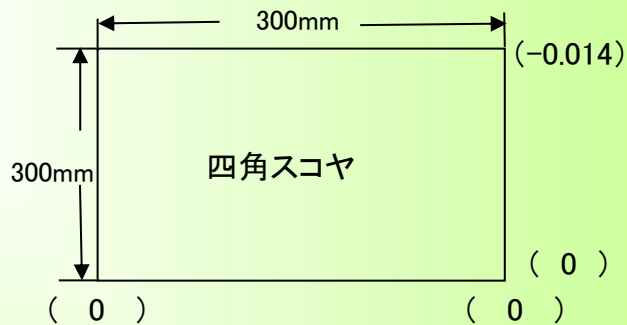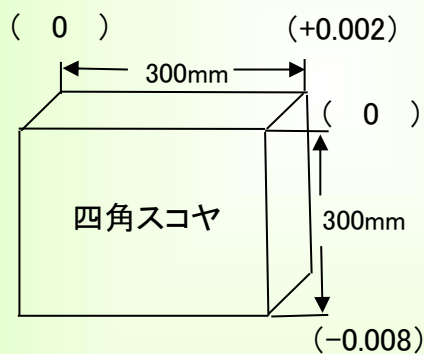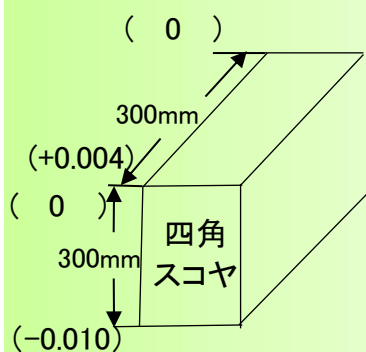

上面精度

※テーブルサイズ 560 × 1050

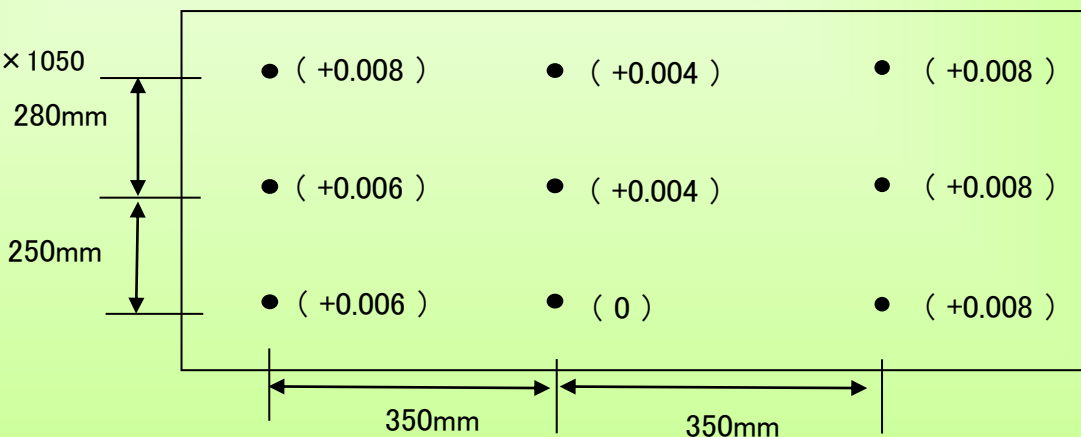

2025/9/27