


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	森精機	年式	2018	管理番号	P009047
型式	CMX-600V	測定者	金子	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

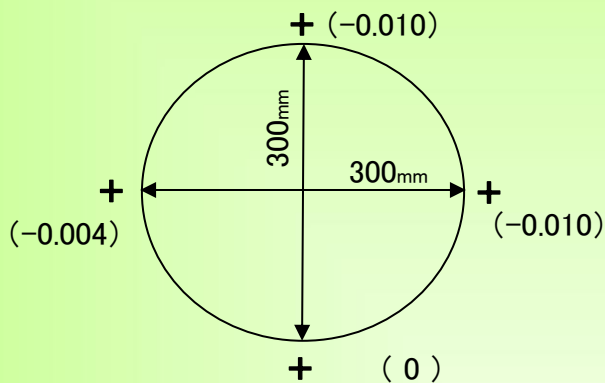

主軸振れ



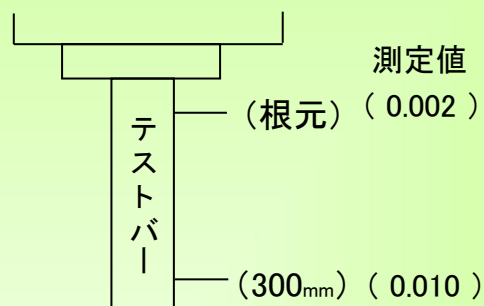


直角度

【YZ】測定値 (0.022)


【XZ】測定値 (0.012)

【X Y】測定値 (0.004)

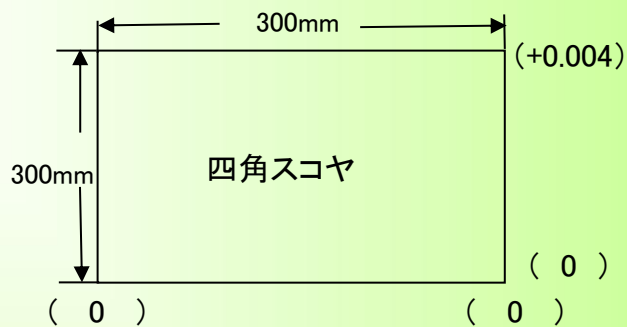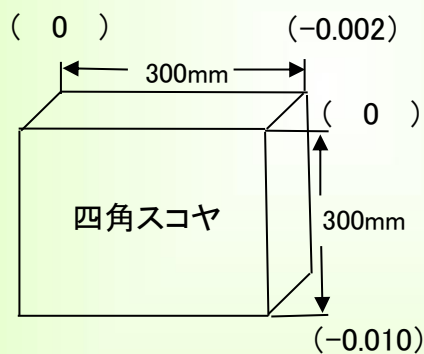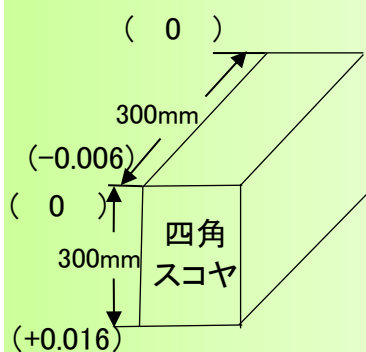

上面精度

※テーブルサイズ 900×560

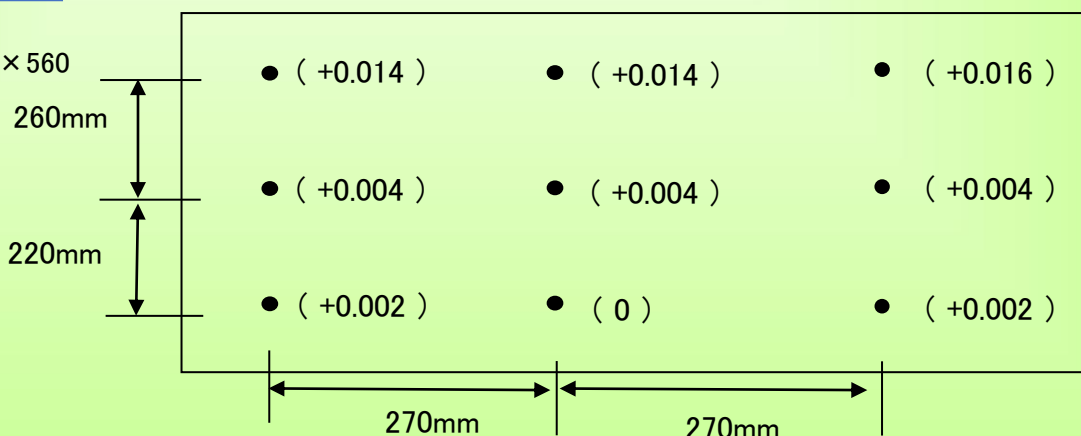

2025/9/30