


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	牧野フライス製作所	年式	2016.11	管理番号	P008880
型式	a40	測定者	金子	アシスタント	

Z軸方向の平行度

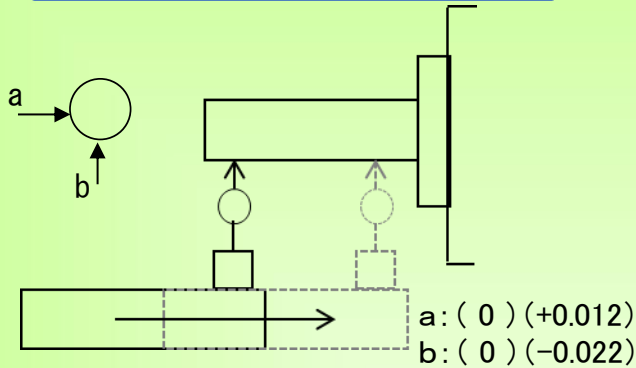

主軸振れ



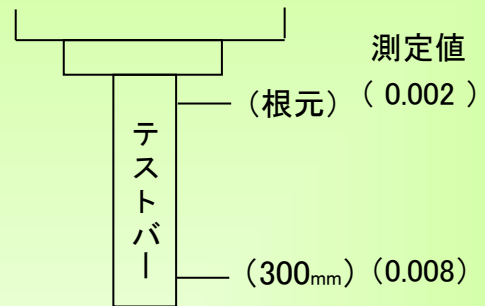


直角度

【XY】 測定値 (0.004)


【ZY】 測定値 (0.002)

【ZX】 測定値 (0.012)

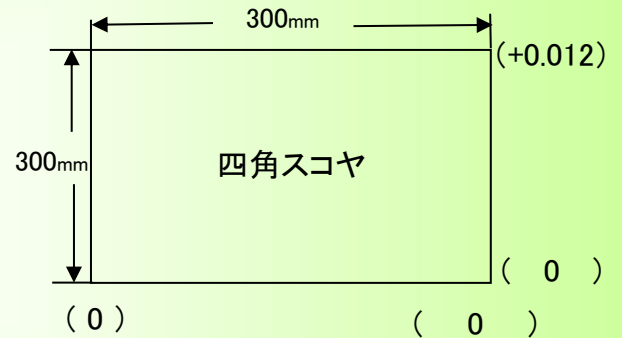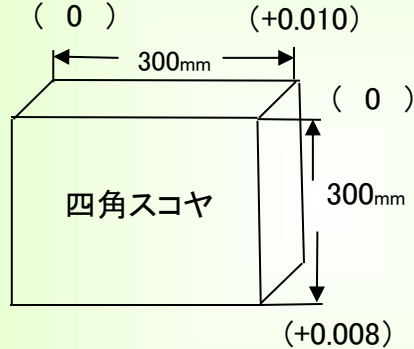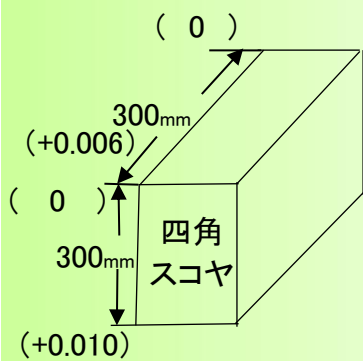

上面精度

テーブルサイズ: 400角
()パレット1
[]パレット2

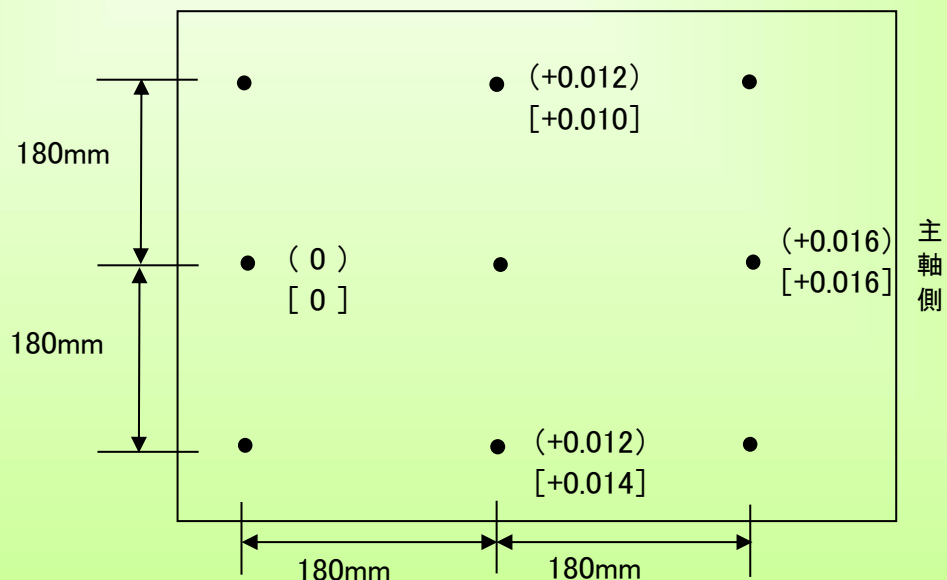

2025/10/6