


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	森精機	年式	2005	管理番号	P009052
型式	NV5000 α 1B/40	測定者	金子	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

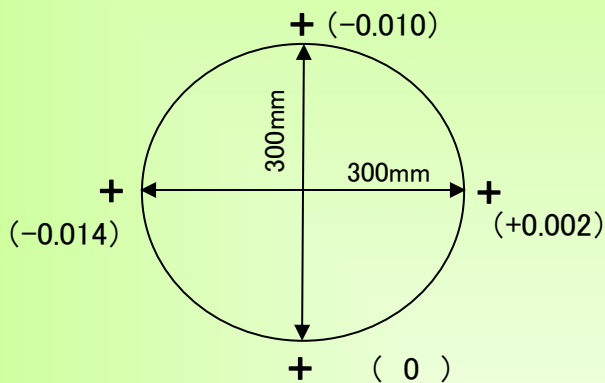

主軸振れ



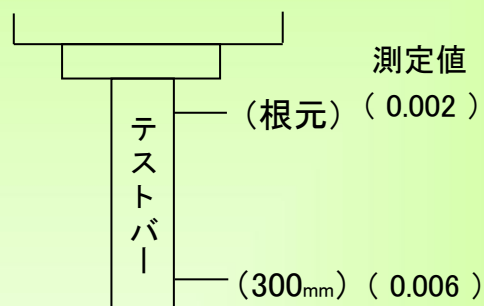


直角度

【YZ】測定値 (0.006)

【XZ】測定値 (0.006)

【X Y】測定値 (0.004)

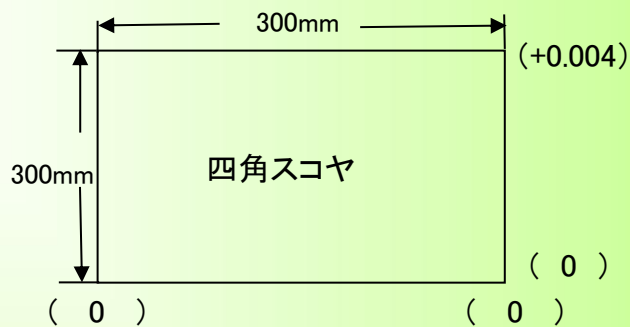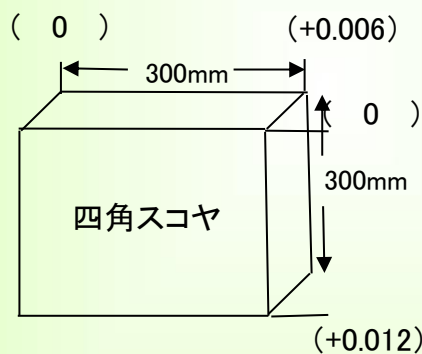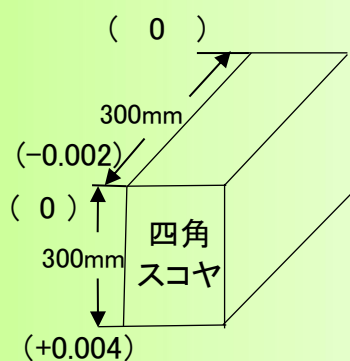


上面精度

※テーブルサイズ 1320 × 600

230mm

230mm

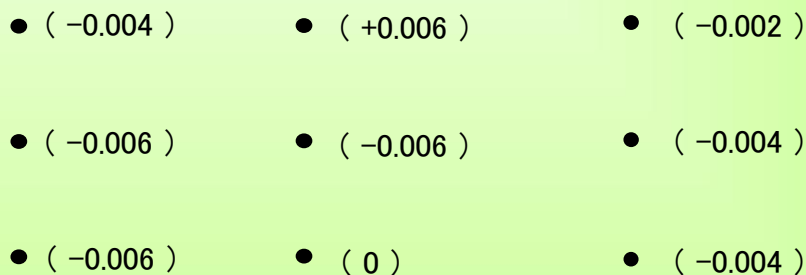

450mm

450mm

2025/9/24

EAST JAPAN MACHINE PLAZA