


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	ファナック	年式	2011	管理番号	P008660
型式	α -T14iFsa	測定者	野辺沼	アシスタント	

振り回し(200ピッチ)

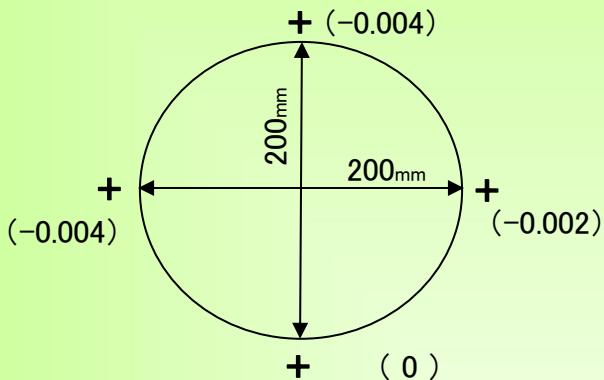


主軸振れ

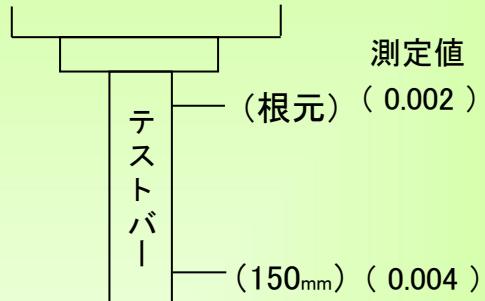


直角度


【YZ】測定値 (0.004)

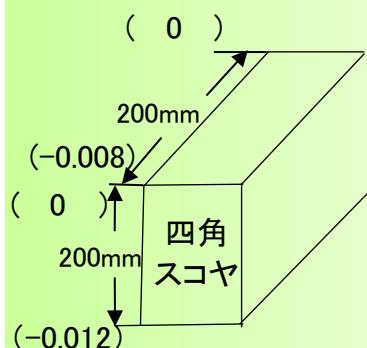

【XZ】測定値 (0.002)

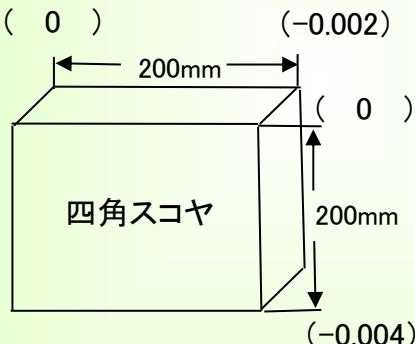


【XY】測定値 (0.004)

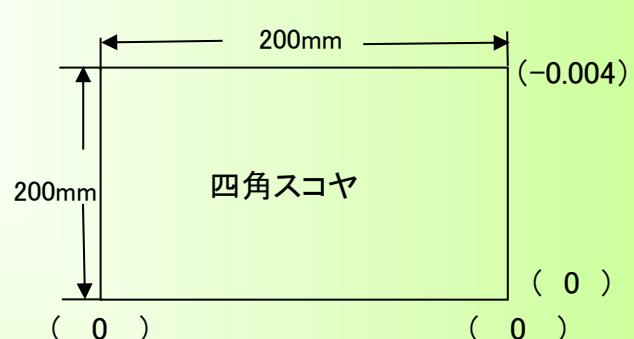

上面精度

※テーブルサイズ 630×330

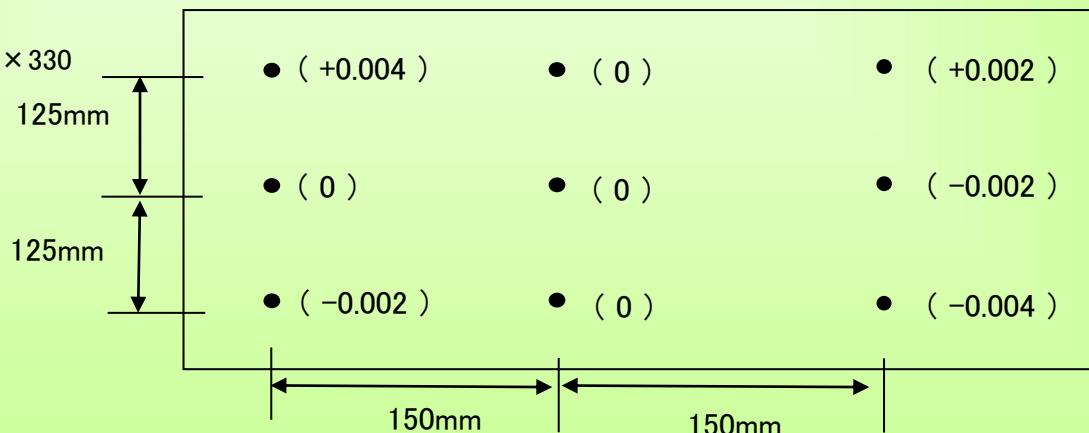

2025/10/14