


# 精度測定検査表


*Examination for precision list*

メーカー	ファナック	年式	2005	管理番号	P009063
型式	$\alpha$ -T14iE	測定者	金子	アシスタント	

## 振り回し(200ピッチ)

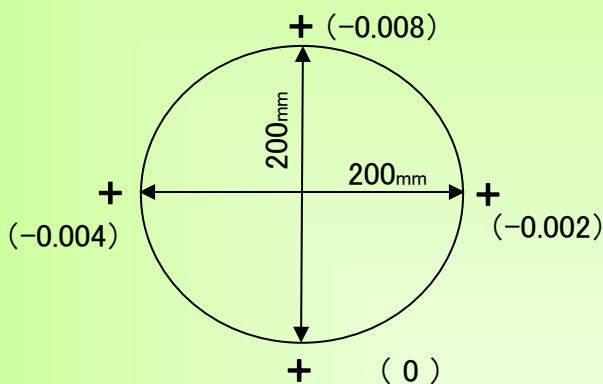


## 主軸振れ

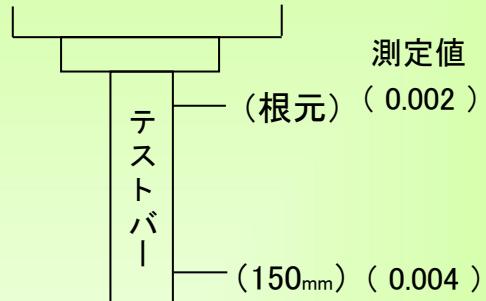


## 直角度


【YZ】測定値 (0.004)

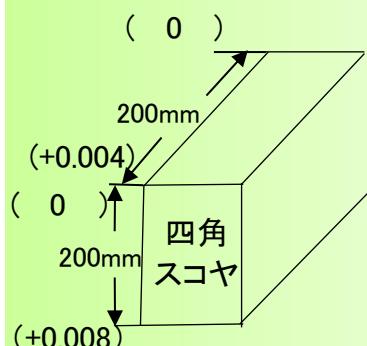

【XZ】測定値 (0.004)

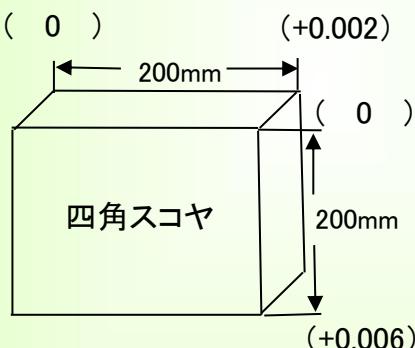


【XY】測定値 (0.002)

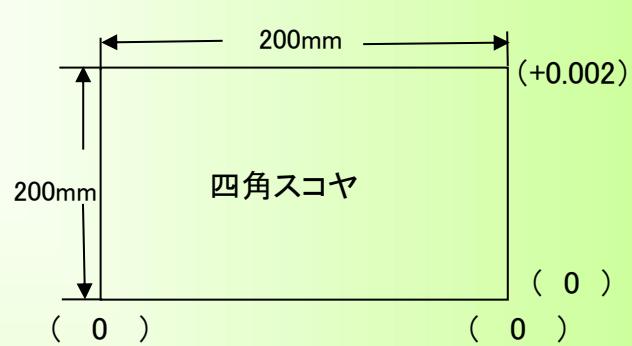

## 上面精度

※テーブルサイズ 650 × 400

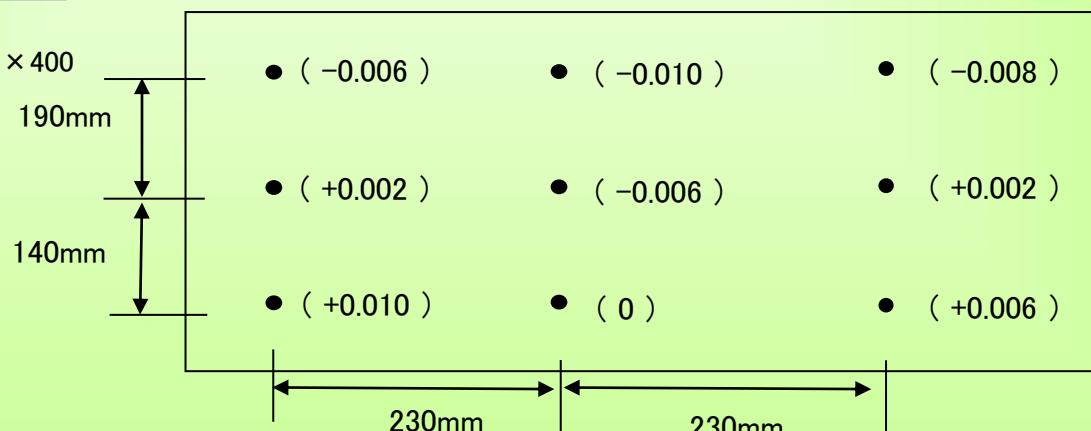

2025/10/15