


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	牧野フライス製作所	年式	2016	管理番号	P008893
型式	a40	測定者	金子	アシスタント	

Z軸方向の平行度

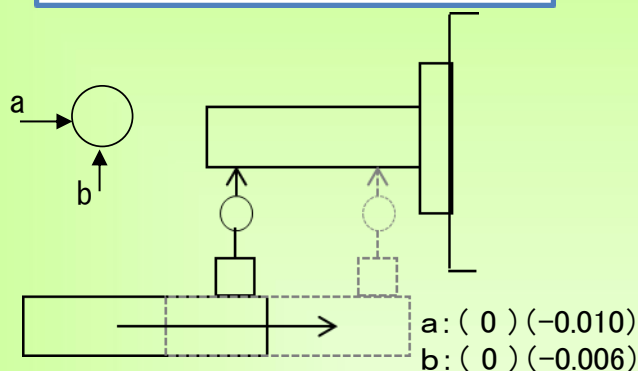


主軸振れ

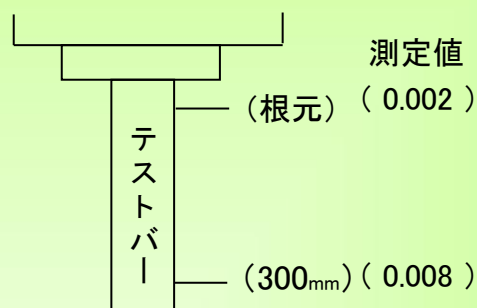


直角度


【XY】測定値 (0.002)

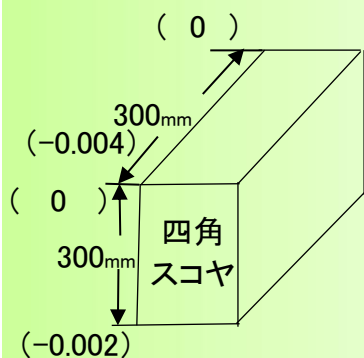

【ZY】測定値 (0.008)

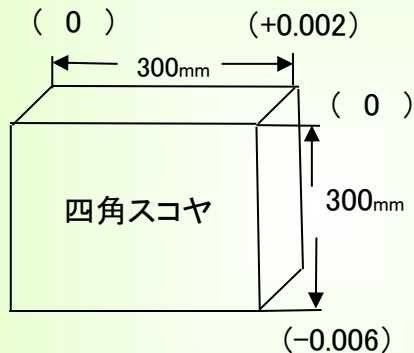


【ZX】測定値 (0.002)

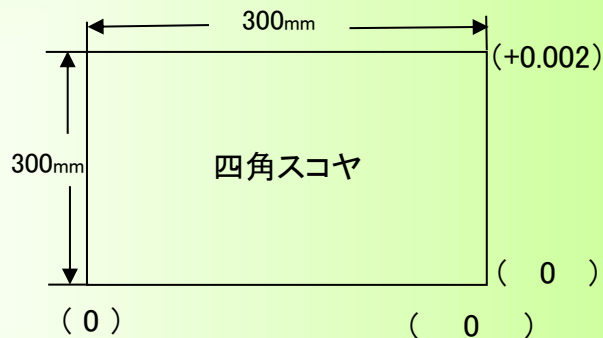

上面精度

テーブルサイズ: 400角
()パレット1
[]パレット2

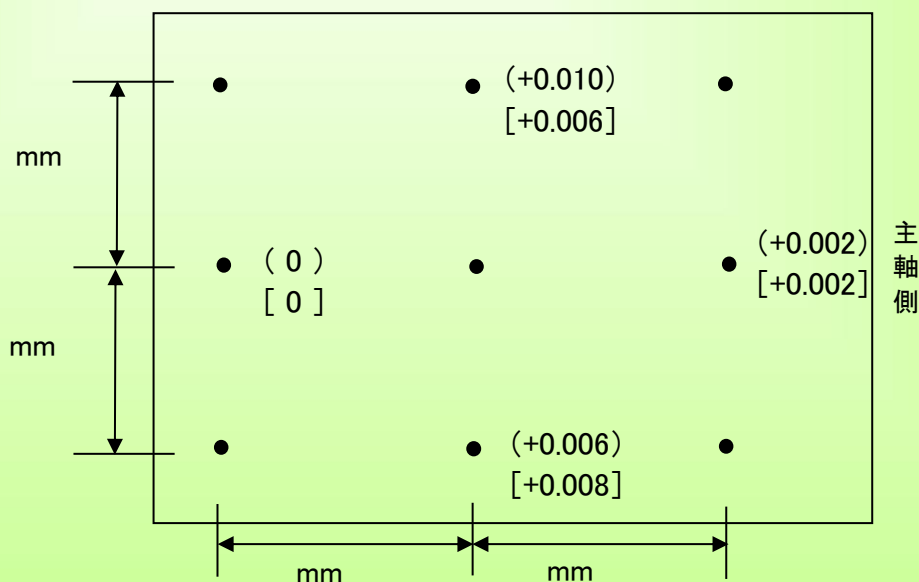

2025/10/3