


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	キラ	年式	2007	管理番号	P008681
型式	PC-30W	測定者	金子	アシスタント	

振り回し(200ピッチ)

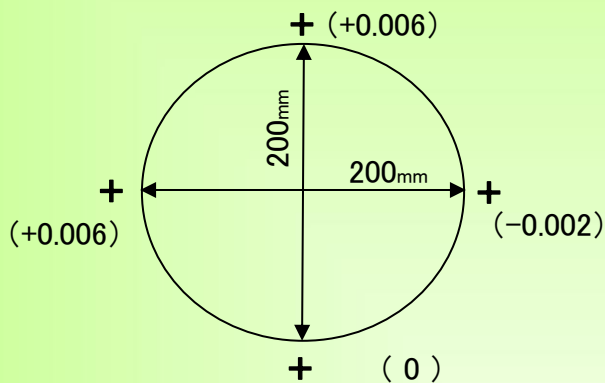

主軸振れ



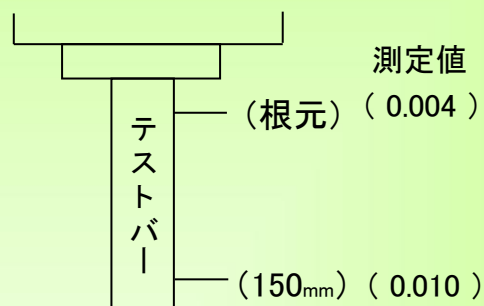


直角度

【YZ】測定値 (0.010)


【XZ】測定値 (0.008)

【X Y】測定値 (0.004)

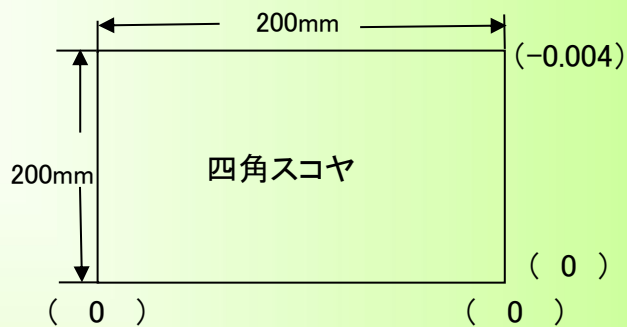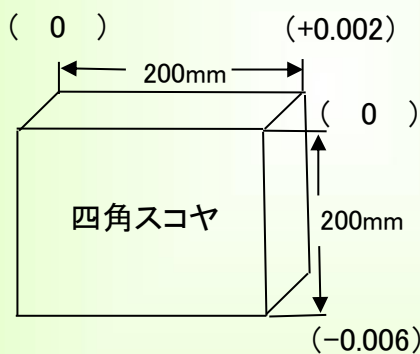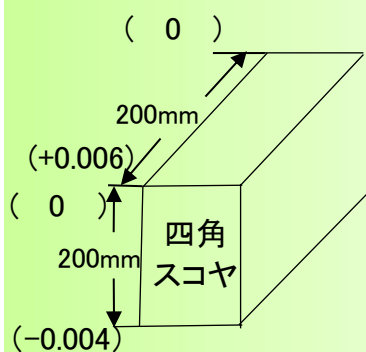

上面精度

※テーブルサイズ 500×350

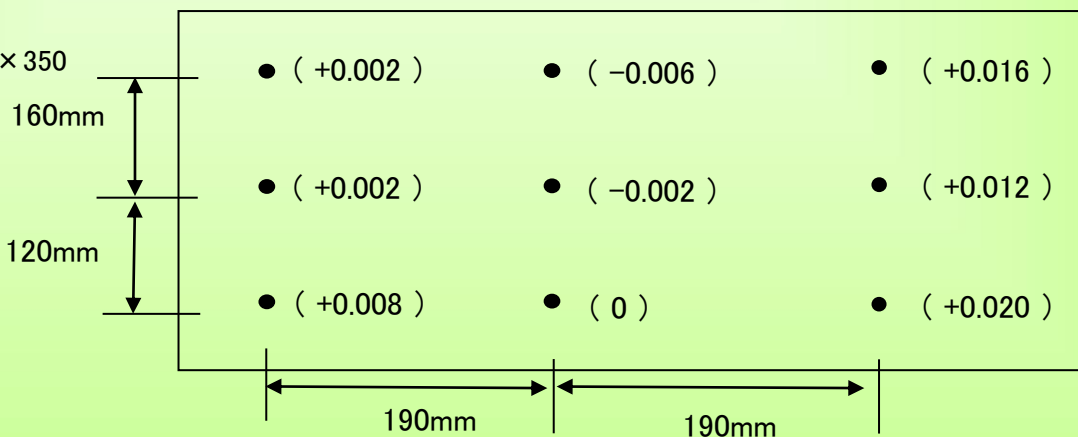

2025/10/16