


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	メクトロン	年式	2011.10	管理番号	P008760
型式	MTV-T351W	測定者	金子	アシスタント	

振り回し(200ピッチ)

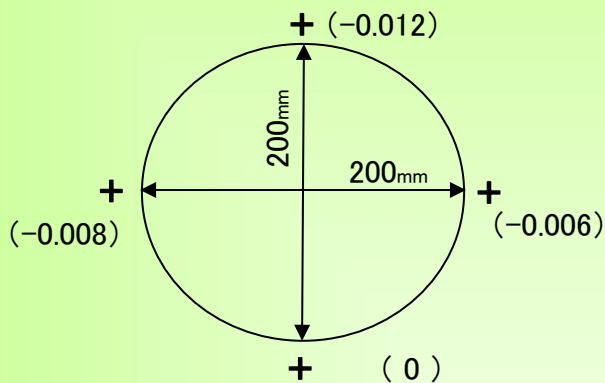

主軸振れ



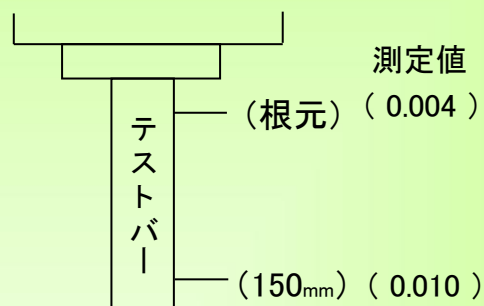


直角度

【YZ】測定値 (0.010)


【XZ】測定値 (0.006)

【X Y】測定値 (0.002)

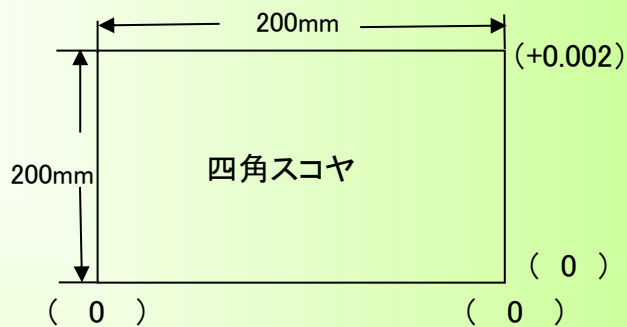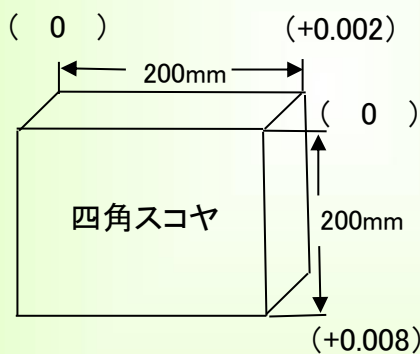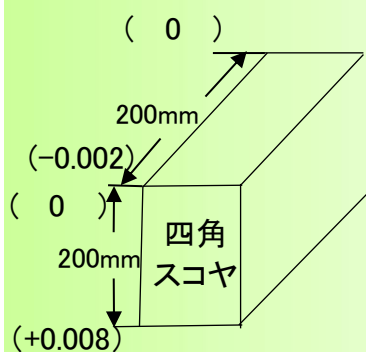

上面精度

※テーブルサイズ 810×380

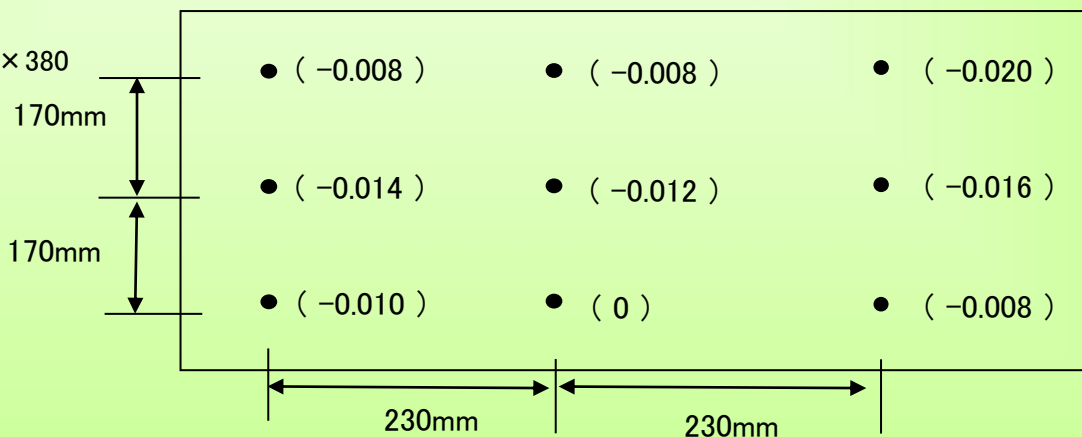

2025/10/22