


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	ヤマザキマザック	年式	2006	管理番号	P009033
型式	VARIAXIS 630-5X	測定者	金子	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

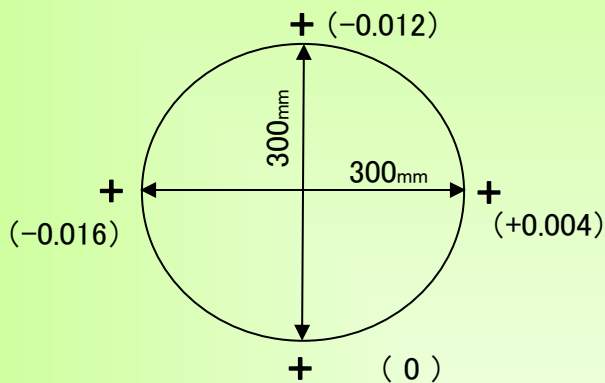

主軸振れ



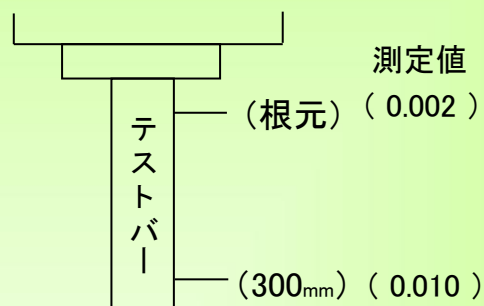


直角度

【YZ】測定値 (0.004)

【XZ】測定値 (0.018)


【X Y】測定値 (0.002)

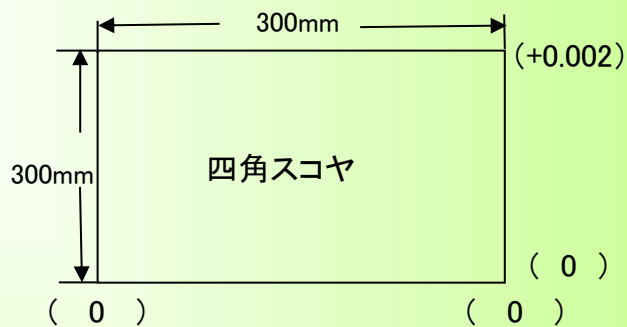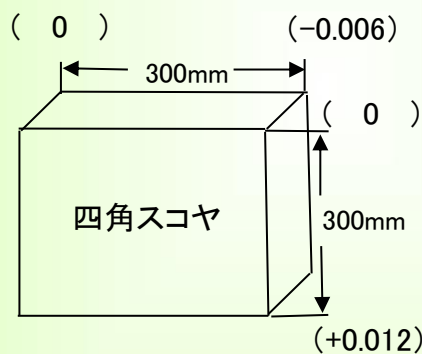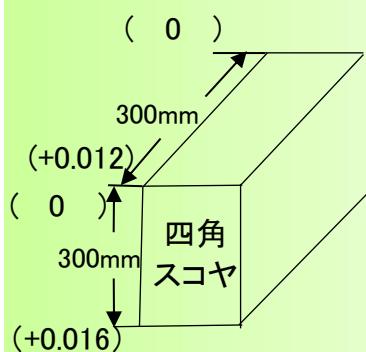

上面精度

※テーブルサイズ Φ500

[] → A軸-90°
の位置

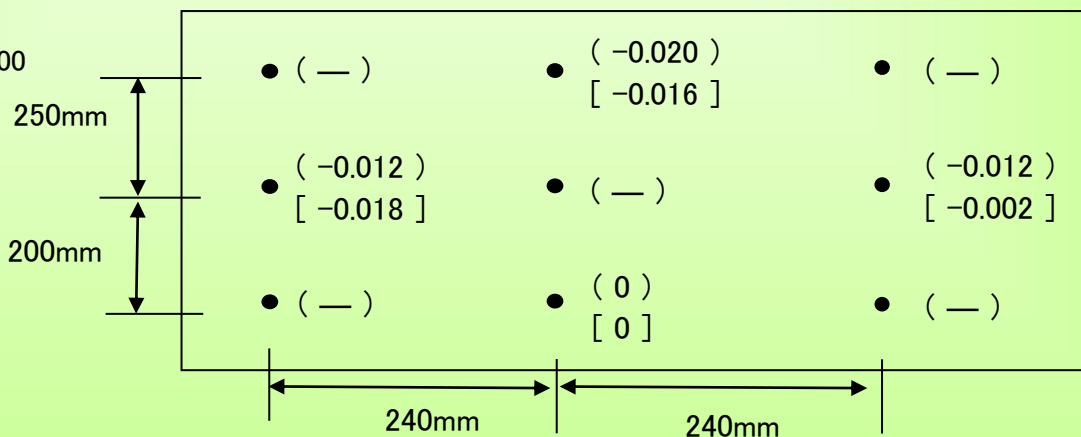

2025/10/20