


# 精度測定検査表


*Examination for precision list*

メーカー	ヤマザキマザック	年式	2005	管理番号	P008829
型式	VARIAXIS 630-5X	測定者	金子	アシスタント	

## 振り回し(300ピッチ)

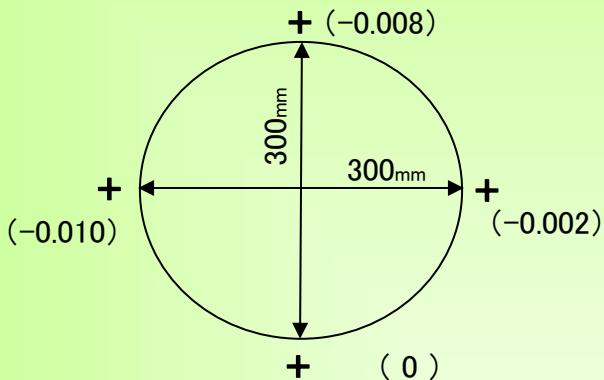


## 主軸振れ

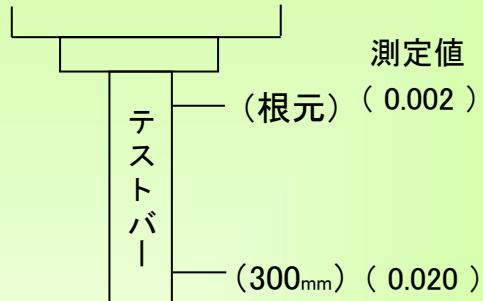


## 直角度


【YZ】測定値 (+0.018)

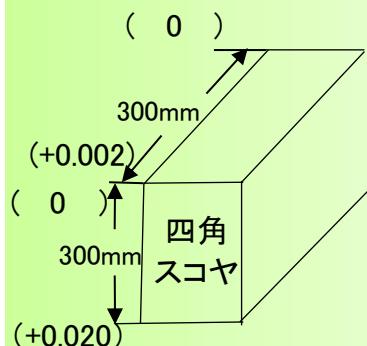

【XZ】測定値 (+0.006)

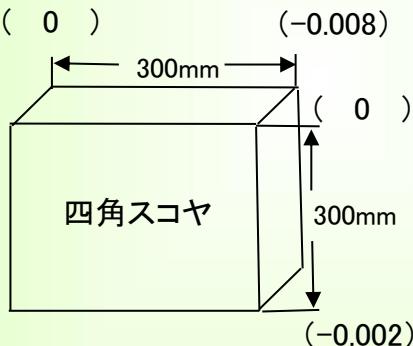


【XY】測定値 (+0.008)

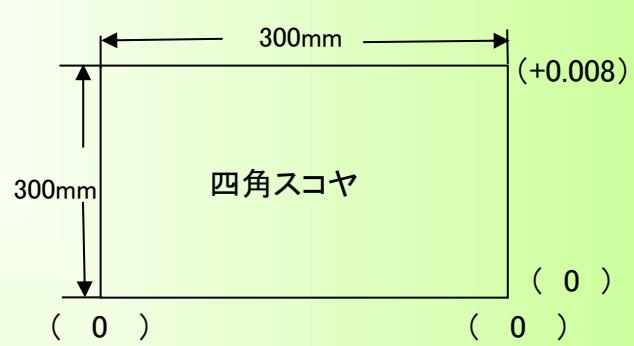

## 上面精度

※テーブルサイズ  $\phi 600 \times 500$

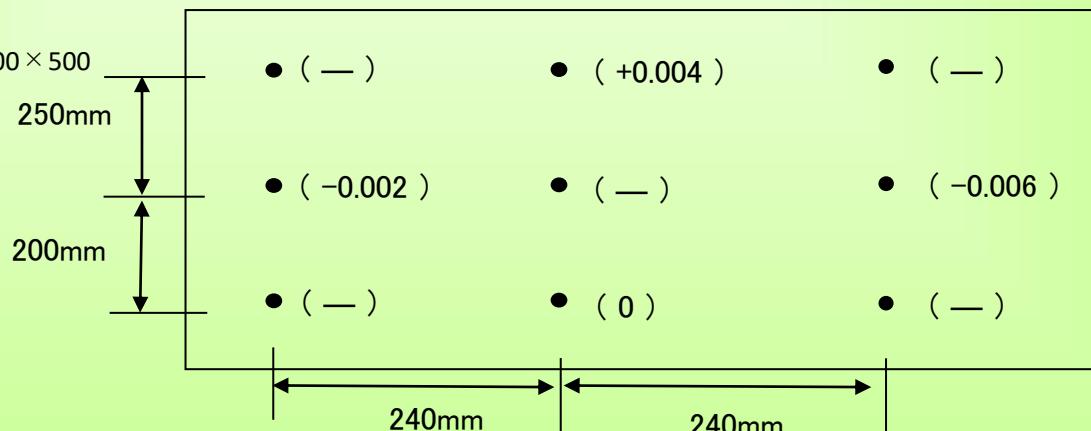

2025/11/11