



精度測定検査表

Examination for precision list

メーカー	キラ	年式	2006年製	管理番号	P006789
型式	PC-30E	測定者	奥澤	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

主軸振れ


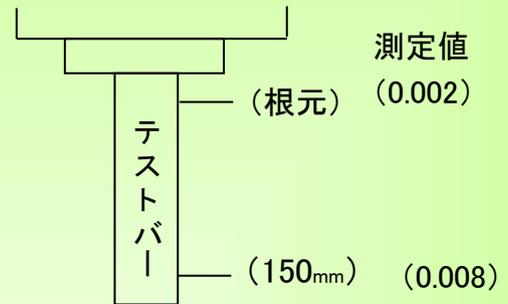
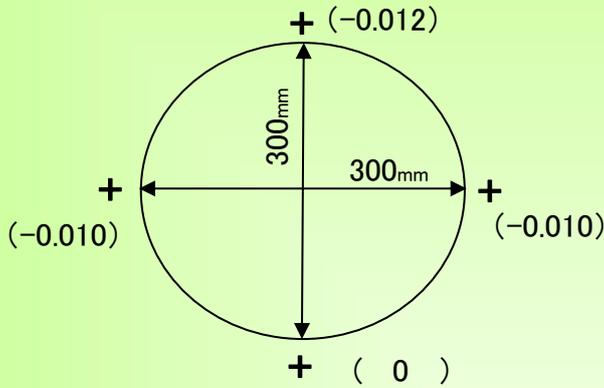


直角度

【Y Z】測定値 (0.008)

【X Z】測定値 (0.014)

【X Y】測定値 (0.004)

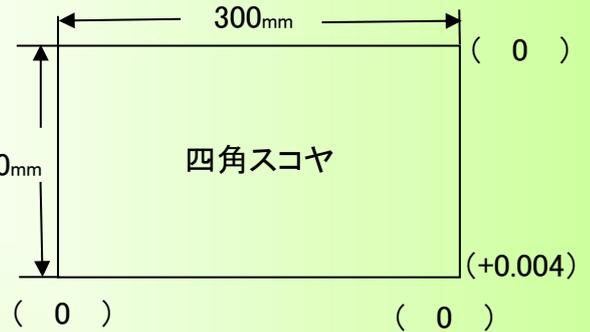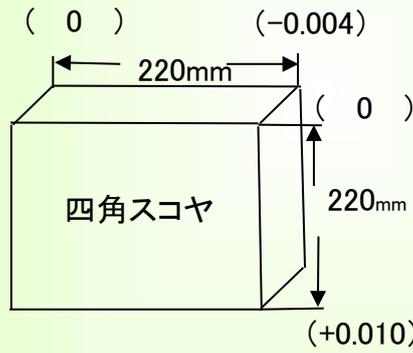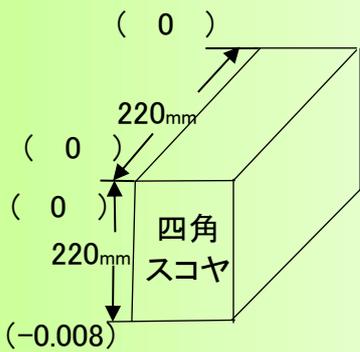

上面精度

※テーブルサイズ 500×350

