


# 精度測定検査表


*Examination for precision list*

メーカー	OKK	年式	2018	管理番号	H019582
型式	VM940R	測定者	仙田	アシスタント	長島

## 振り回し(500ピッチ)

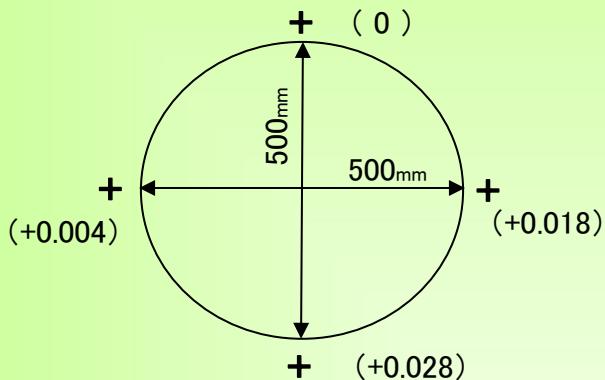


## 主軸振れ

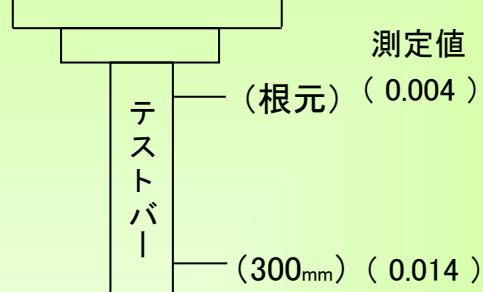


## 直角度

【YZ】測定値 (0.014)

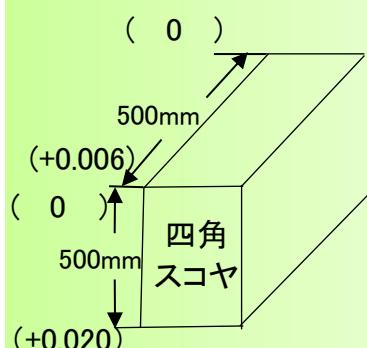

【XZ】測定値 (0.010)

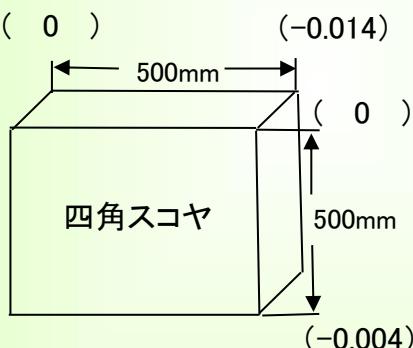


【XY】測定値 (0.014)



## 上面精度

※テーブルサイズ 940×2300

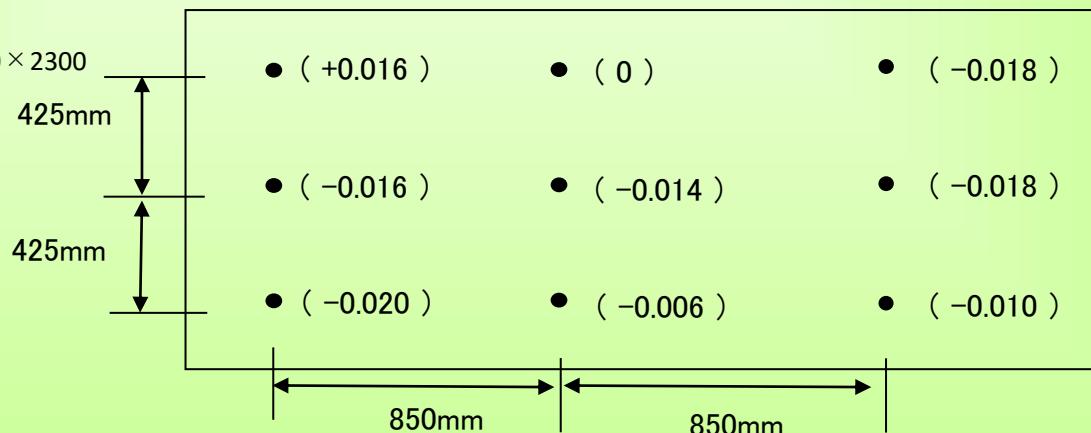

2025/11/25