


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	大隈豊和	年式	2006	管理番号	H019505
型式	MILLAC-1052V	測定者	仙田	アシスタント	長島

振り回し(300ピッチ)

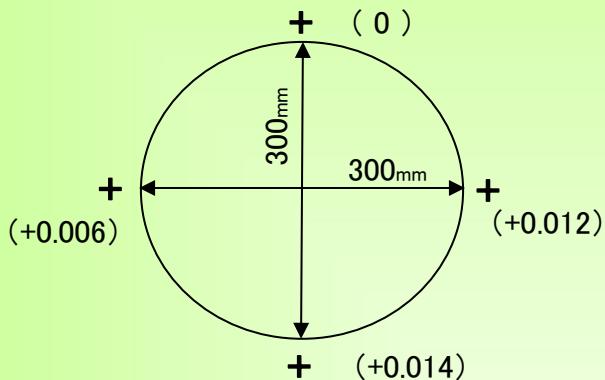


主軸振れ

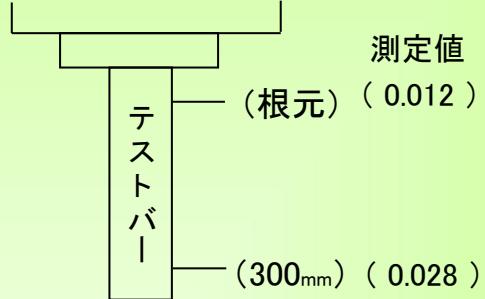


直角度


【YZ】測定値 (0.008)

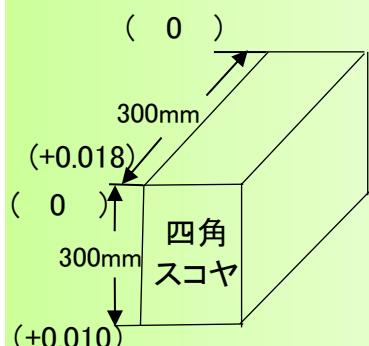

【XZ】測定値 (0.016)

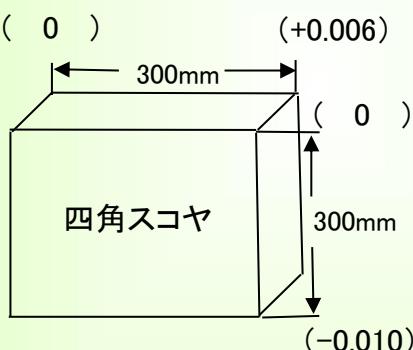


【XY】測定値 (0.016)

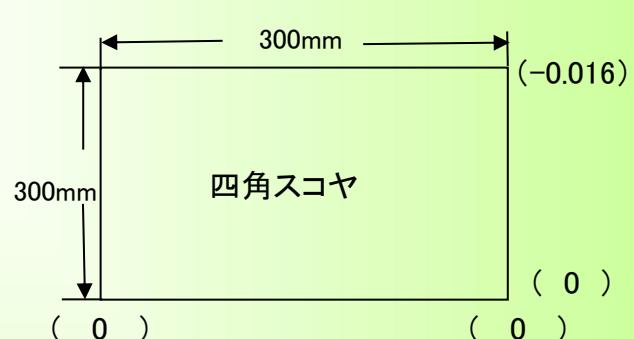

上面精度

※テーブルサイズ 1050×2200

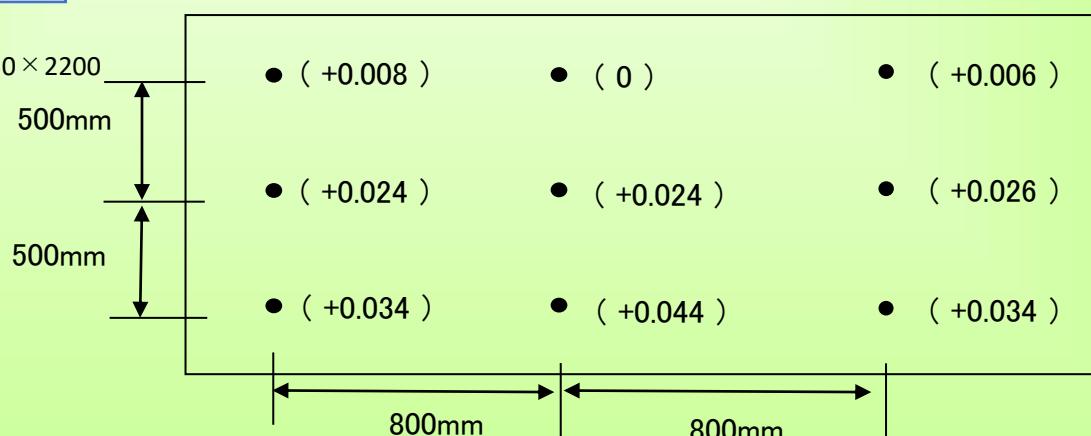

2025/11/26