


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	ブラザー	年式	2014.10	管理番号	P009092
型式	S500X1	測定者	金子	アシスタント	

振り回し(200ピッチ)

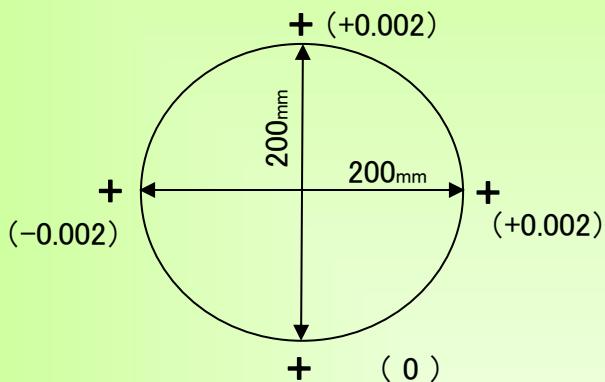


主軸振れ

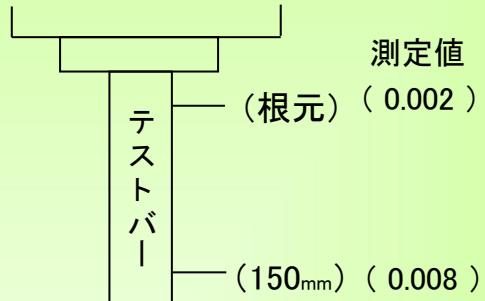


直角度


【YZ】測定値 (0.006)

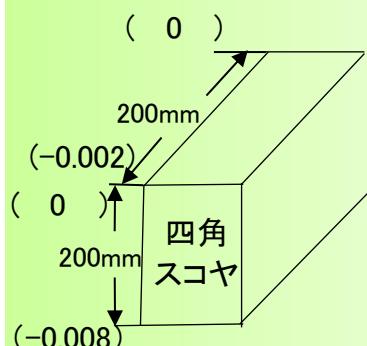

【XZ】測定値 (0.006)

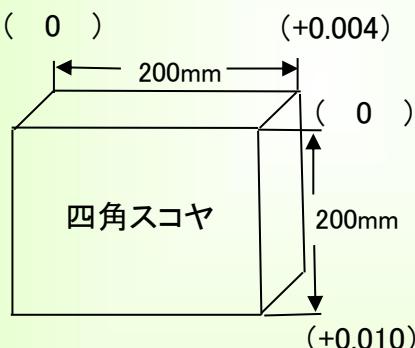


【XY】測定値 (0.004)

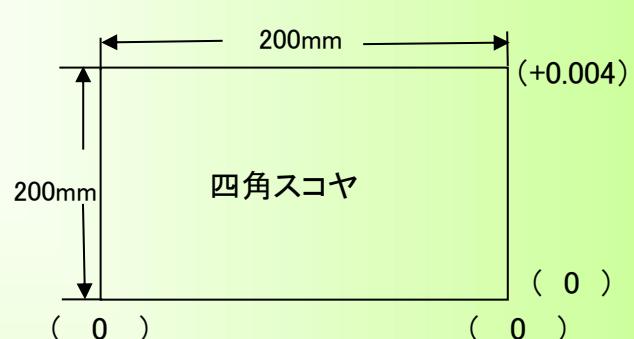

上面精度

※テーブルサイズ 600×400

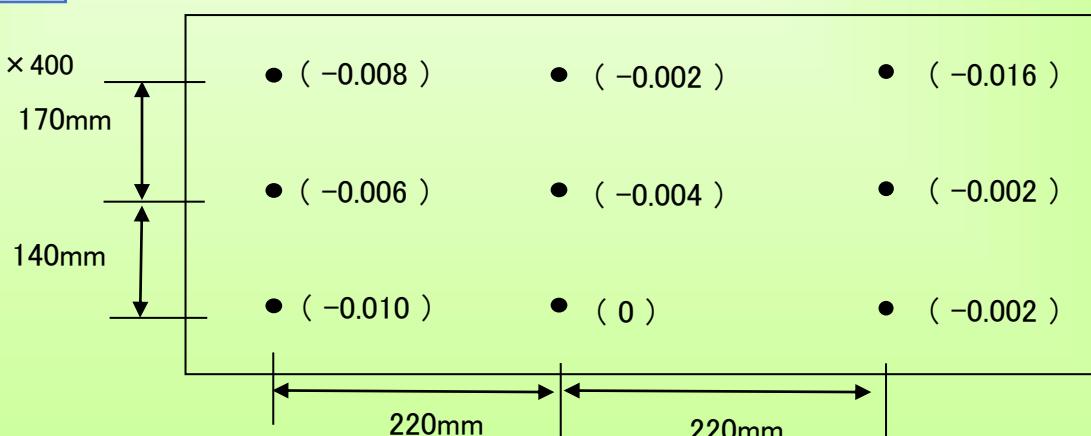

2025/12/3