


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	大隈豊和	年式	2002	管理番号	P008627
型式	MILLAC-415V	測定者	金子	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

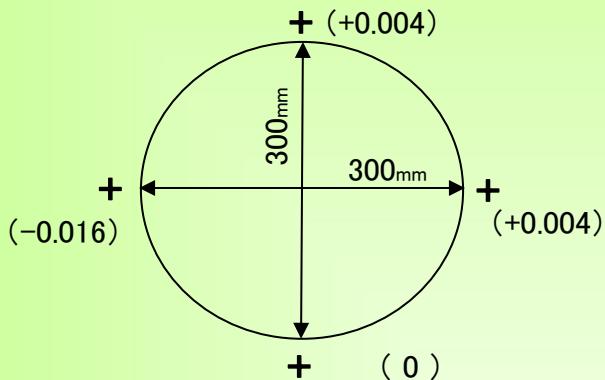


主軸振れ

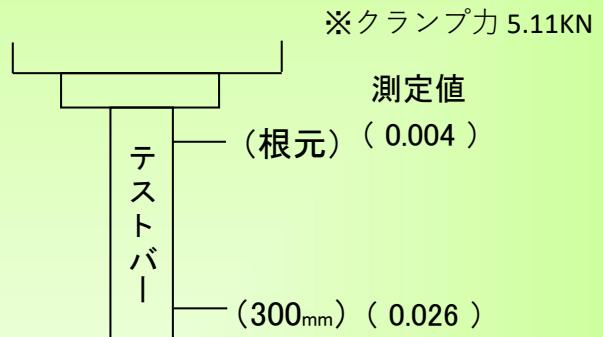


直角度


【YZ】測定値 (0.010)

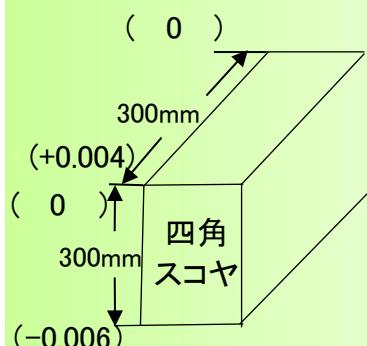

【XZ】測定値 (0.016)

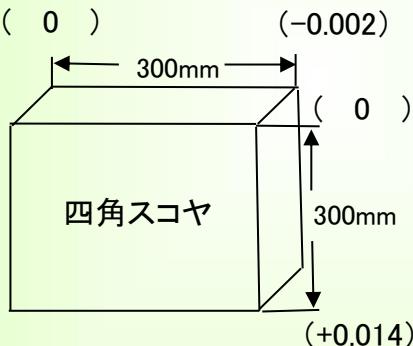


【XY】測定値 (0.010)

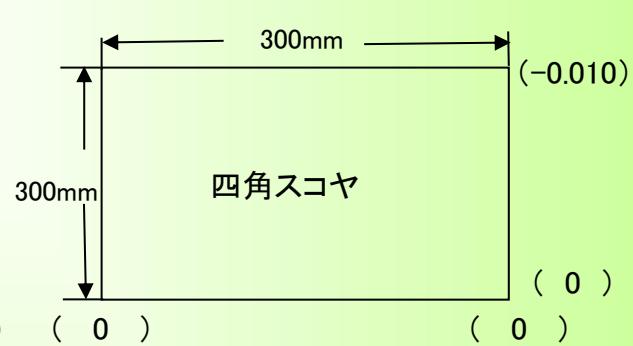

上面精度

※テーブルサイズ 700×400

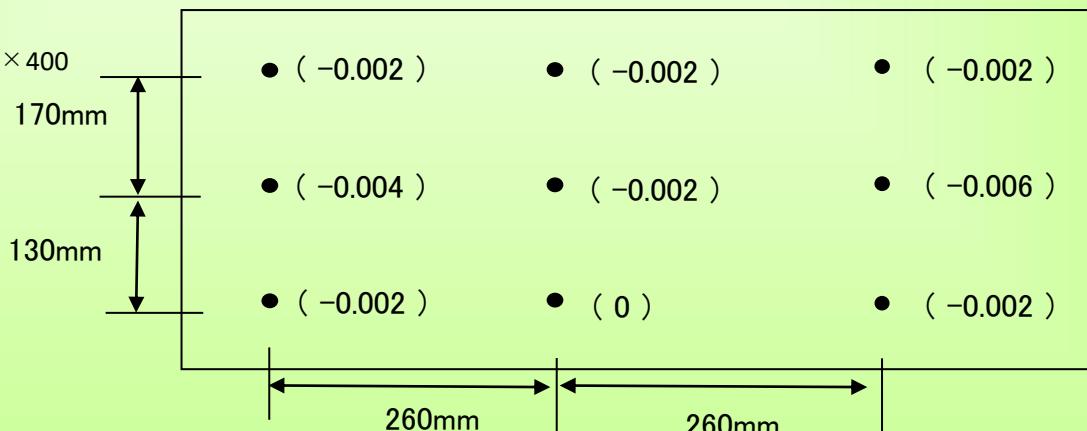

2025/12/2