


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	三井精機	年式	2008	管理番号	P009099
型式	Vertex 550-5X	測定者	金子	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

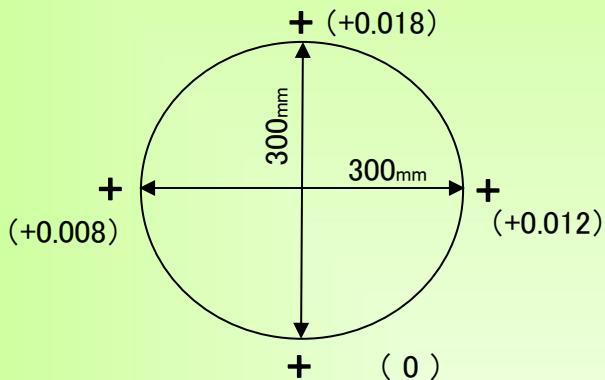


主軸振れ

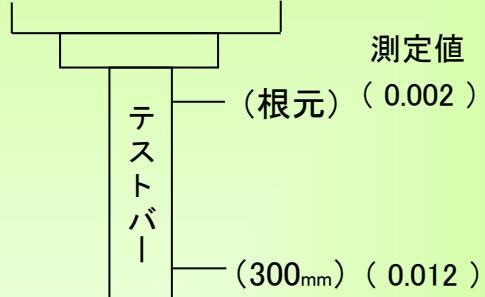


直角度


【YZ】測定値 (0.008)

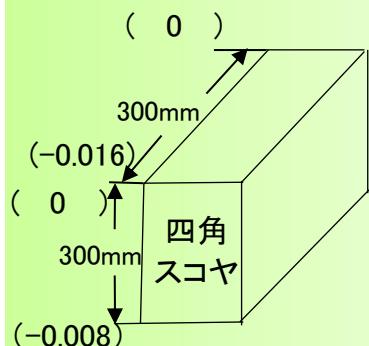

【XZ】測定値 (0.004)

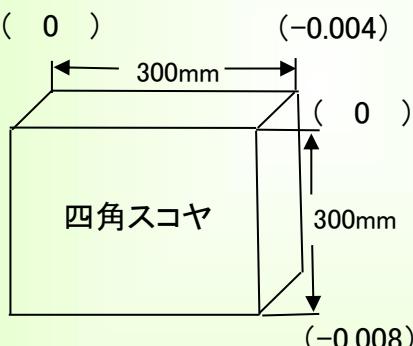


【XY】測定値 (0.004)

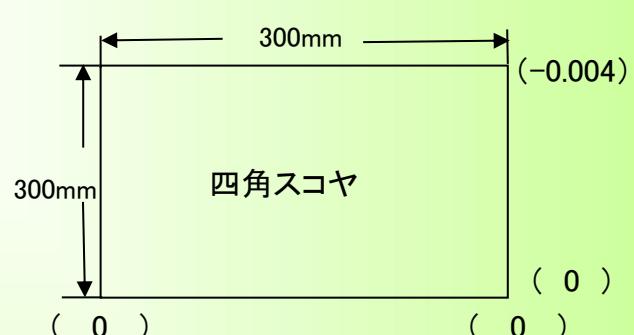

上面精度

() → A,C軸原点 [] → A軸-90° ,C軸原点

※テーブルサイズ Φ400

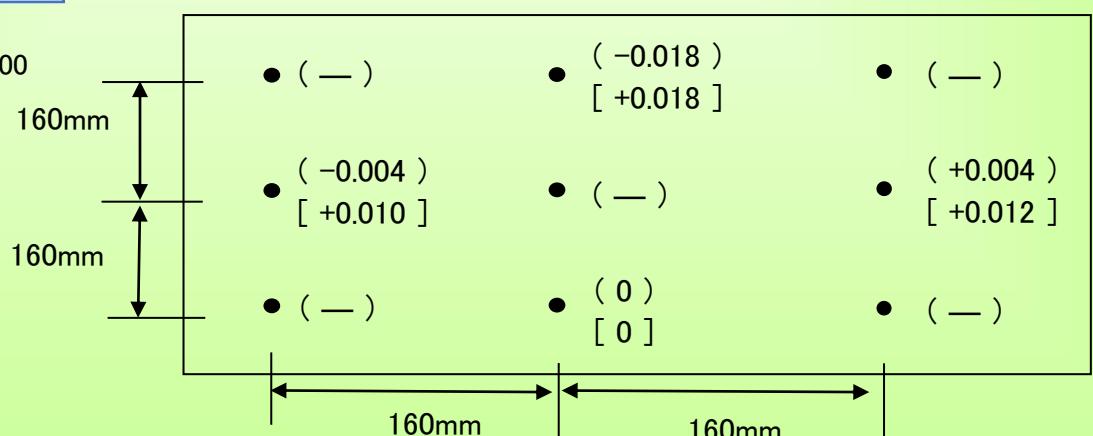

2025/12/4